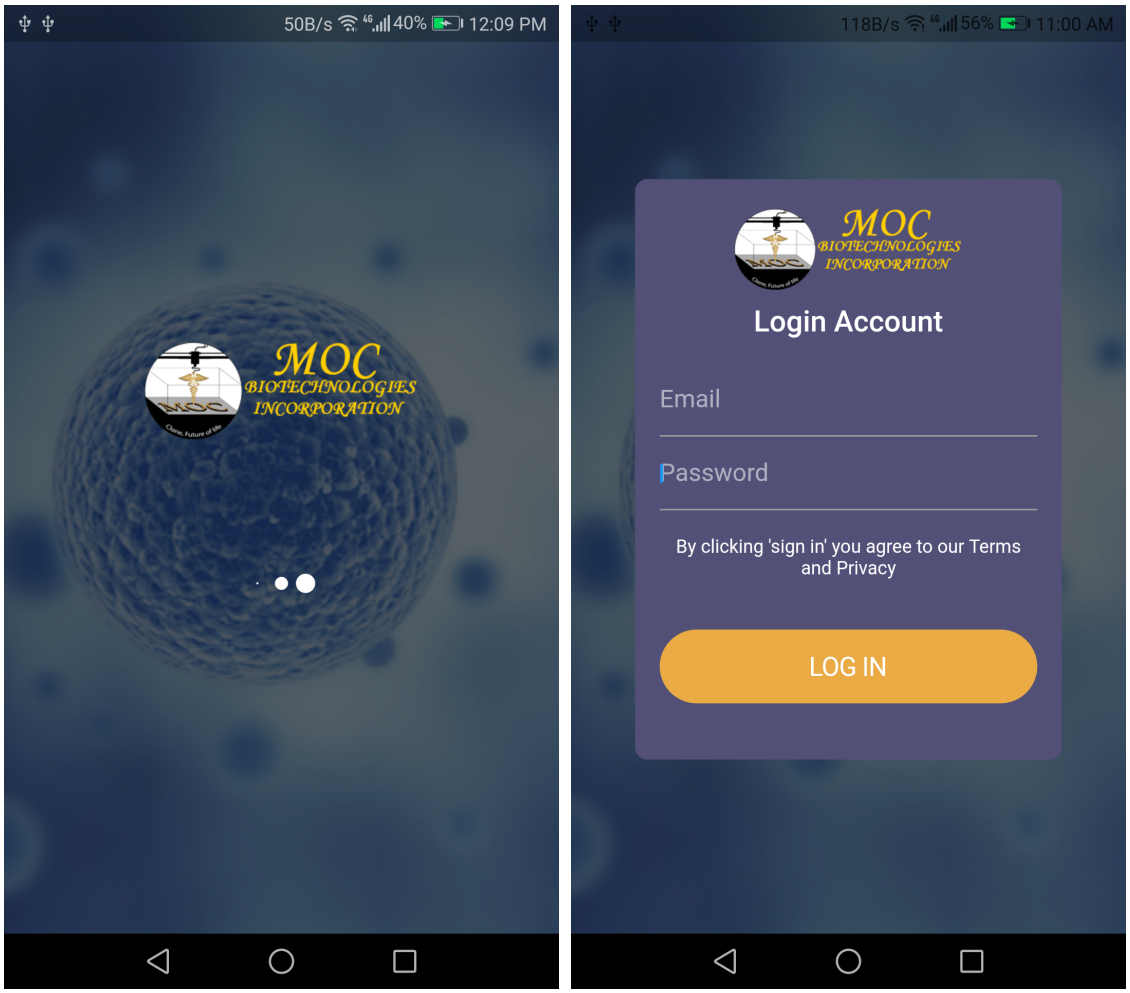
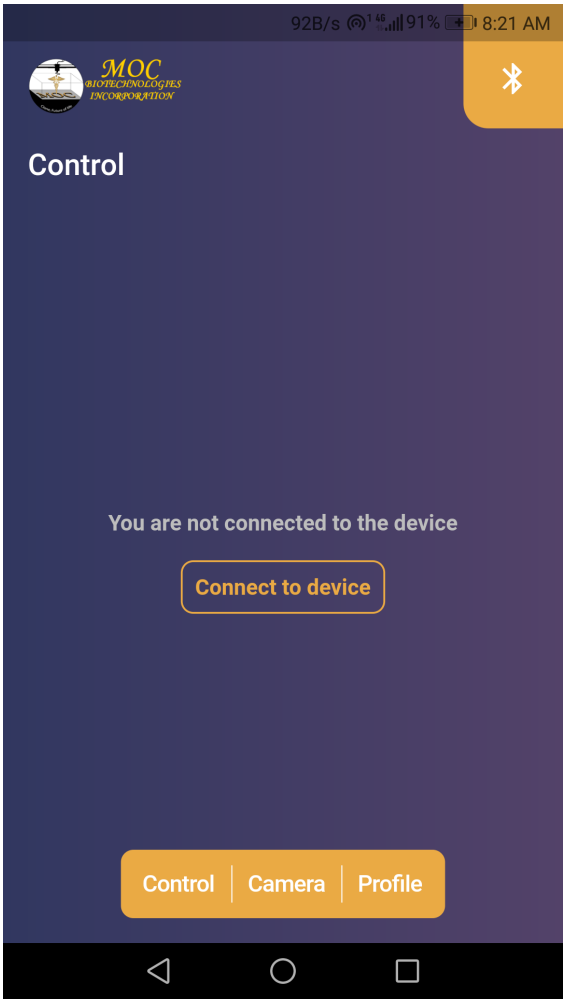
اموزش استفاده از اپلیکیشن moc

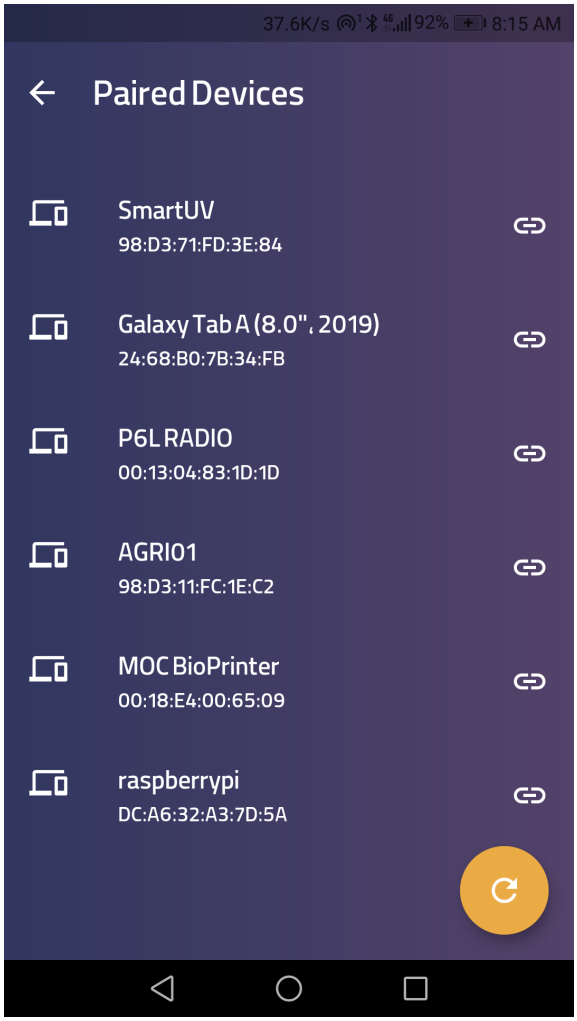
ابتدا اپلیکیشن را بر روی گوشی نصب میکنیم. با اجرای اپلیکیشن صفحه زیر نمایش داده میشود.



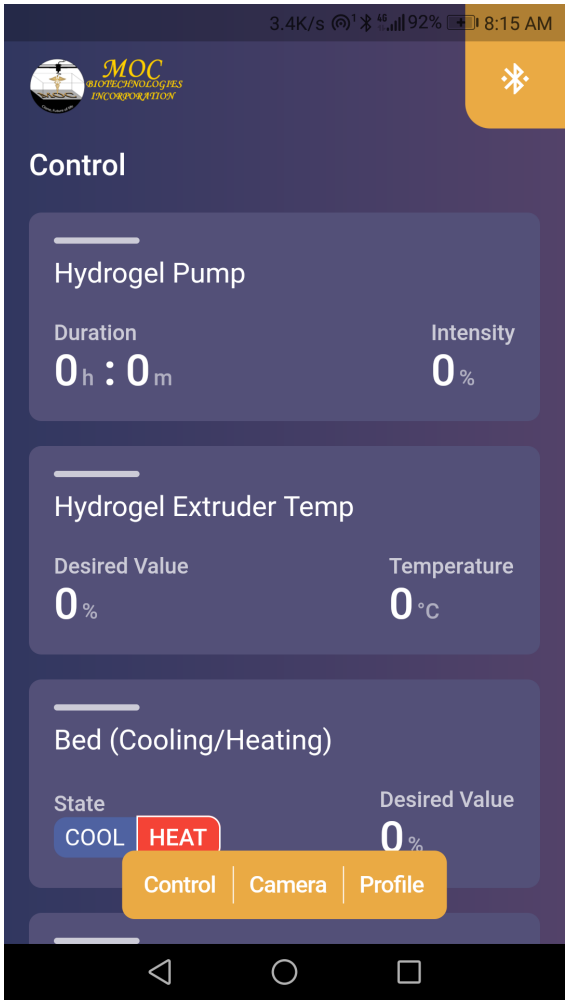
در این اطلاعات حساب خود را وارد کنید (ایمیل و رمز عبور) در صورت صحیح بودن اطلاعات حساب وارد صفحه اصلی اپلیکیشن میشوید.

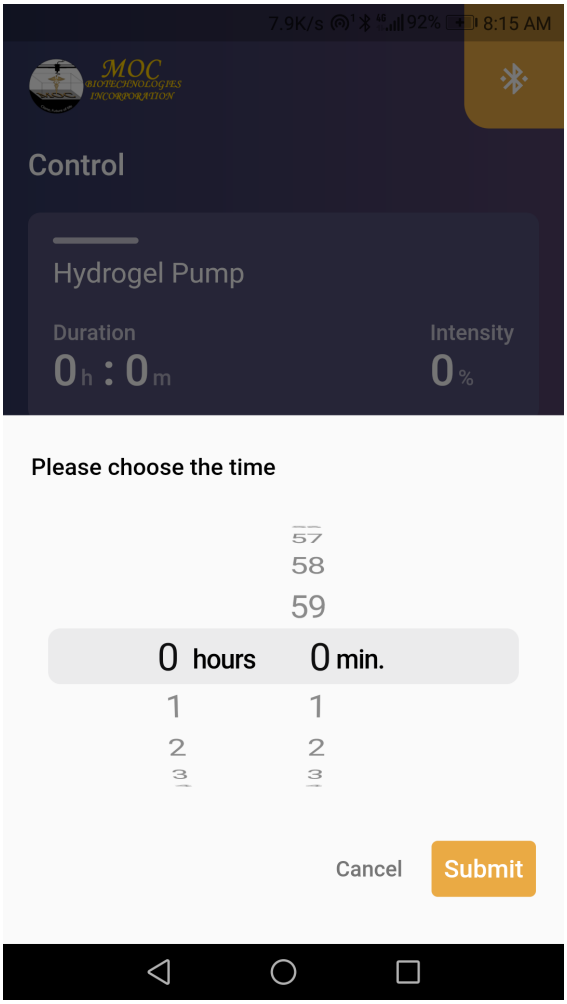
صفحه اصلی اپلیکیشن از سه بخش تشکیل شده است. بخش کنترل دستگاه، بخش نمایش دوربین درون دستگاه و بخش پروفایل کاربری.

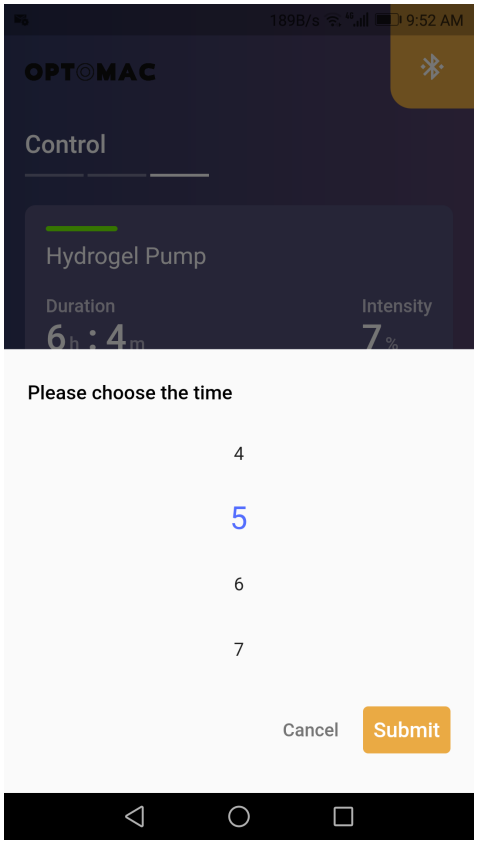




در بخش اول از شما میخواهد که به دستگاه moc متصل شوید. با کلیک بر روی دکمه connect to device صفحه بلوتوث های قابل اتصال نمایش داده می شود و با کلیک بر روی نام بلوتوث دستگاه، اپلیکیشن به دستگاه متصل میشود. لازم به ذکر است قبل از اتصال به دستگاه باحد بلوتوث گوشی را روشن کرده از قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی، به بلوتوث دستگاه pair شوید.


3.4K/s 92% 8:15 AM
MOC
BIOTECHNOLOGIES INCORPORATION
Control
Hydrogel Pump
Duration
0 h : 0 m
Intensity
0 %
Hydrogel Extruder Temp
Desired Value
0 %
Temperature
0 °C
Bed (Cooling/Heating)
State
COOL
HEAT
Desired Value
0 %
Control
Camera
Profile

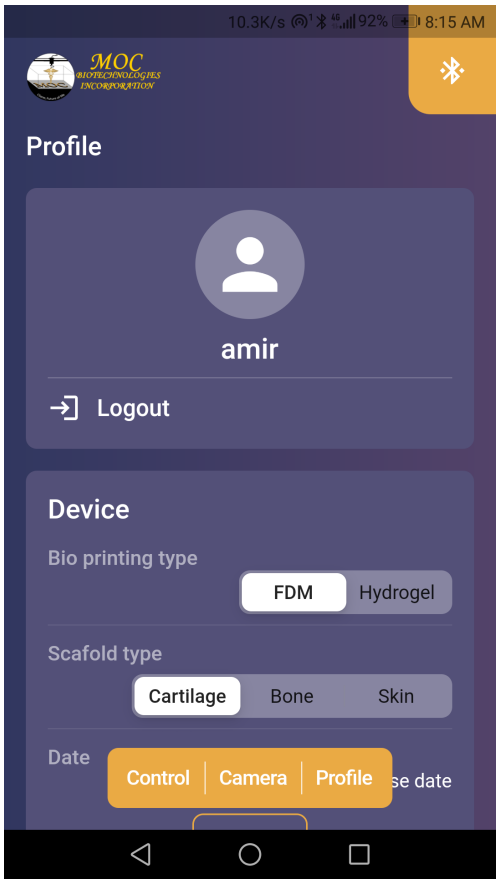

7.9K/s 92% 8:15 AM
MOC
BIOTECHNOLOGIES INCORPORATION
Control
Hydrogel Pump
Duration
0 h : 0 m
Intensity
0 %
Please choose the time
57
58
59
0 hours
0 min.
1
1
2
2
3
3
Cancel
Submit

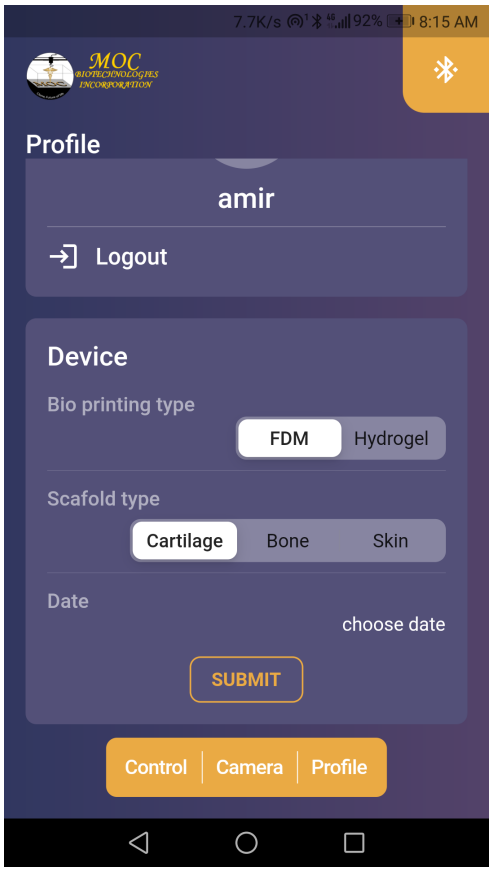

189B/s 9:52 AM
OPTOMAC
Control
Hydrogel Pump
Duration
6 h : 4 m
Intensity
7 %
Please choose the time
4
5
6
7
Cancel
Submit

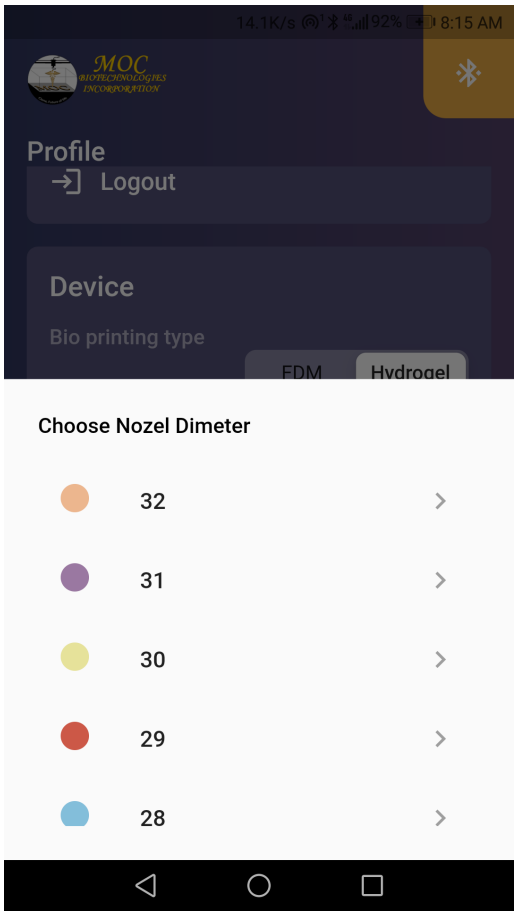
پس از اتصال به دستگاه پارامتر های کنترلی دستگاه نمایش داده میشوند، با تغییر ایتم هر پارامتر، مقدار پارامتر به دستگاه ارسال میشود.

در بالای صفحه دکمه بلوتوث قرار دارد که با کلیک بر روی این دکمه وضعیت اتصال به دستگاه را نمایش میدهد و در صورتی که اتصال به دستگاه قطع شد میتوانید با کلیک بر روی این دکمه مجددا به دستگاه متصل شوید.

در بخش دوم صفحه به اسم camera، تصویر دوربین قرار گرفته در درون دستگاه را میتوانید به صورت نمایش بی درنگ مشاهده کنید.


10.3K/s 92% 8:15 AM
MOC BIOTECHNOLOGIES INCORPORATION
Profile
amir
Logout
Device
Bio printing type
FDM
Hydrogel
Scafold type
Cartilage
Bone
Skin
Date
Control
Camera
Profile


7.7K/s 92% 8:15 AM
MOC BIOTECHNOLOGIES INCORPORATION
Profile
amir
Logout
Device
Bio printing type
FDM
Hydrogel
Scafold type
Cartilage
Bone
Skin
Date
choose date
SUBMIT
Control
Camera
Profile


14.1K/s 92% 8:15 AM
MOC BIOTECHNOLOGIES INCORPORATION
Profile
Logout
Device
Bio printing type
FDM
Hydrogel
Choose Nozel Dimeter
32
31
30
29
28

در بخش سوم صفحه اصلی پروفایل کاربر قرار دارد، در بالای این صفحه نام کاربر قرار دارد و با کلیک بر روی دکمه Logout از حساب کاربری خارج میشود.

در پایین صفحه اطلاعات مربوط به دستگاه را میتوانید مشخص کنید. اطلاعات مانند نوع دستگاه FDM, Hydrogel نوع scaffold و اندازه نازل قابل تظیم می باشد.