valid

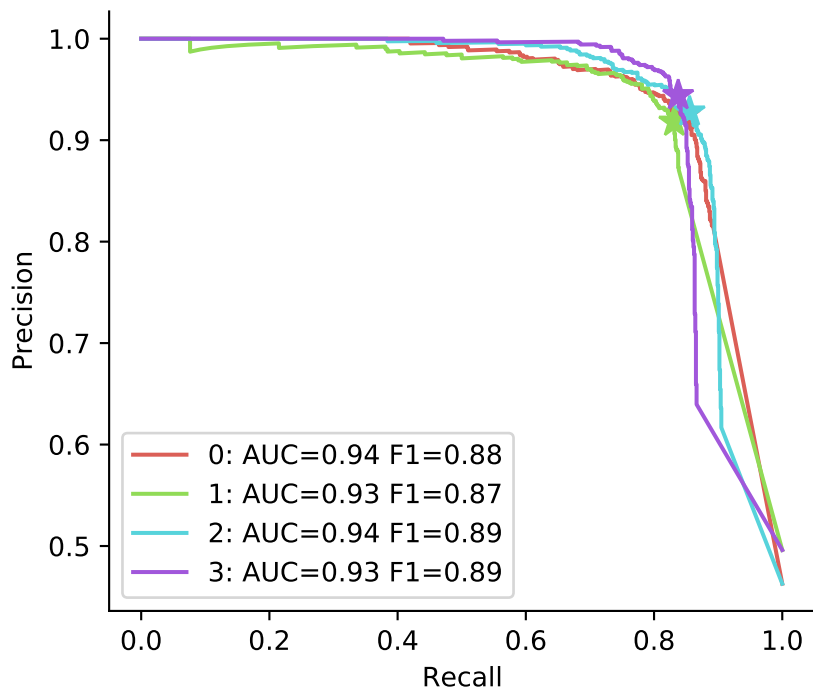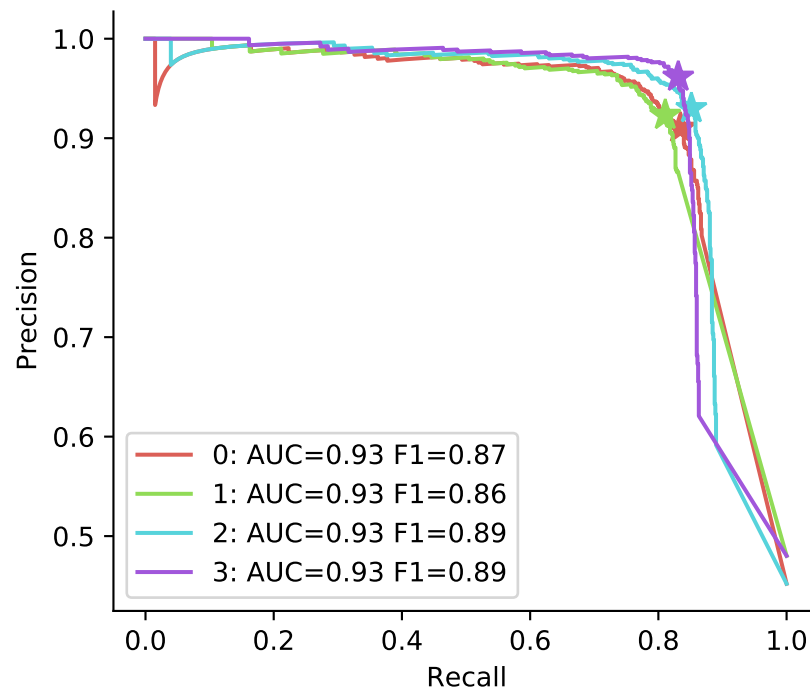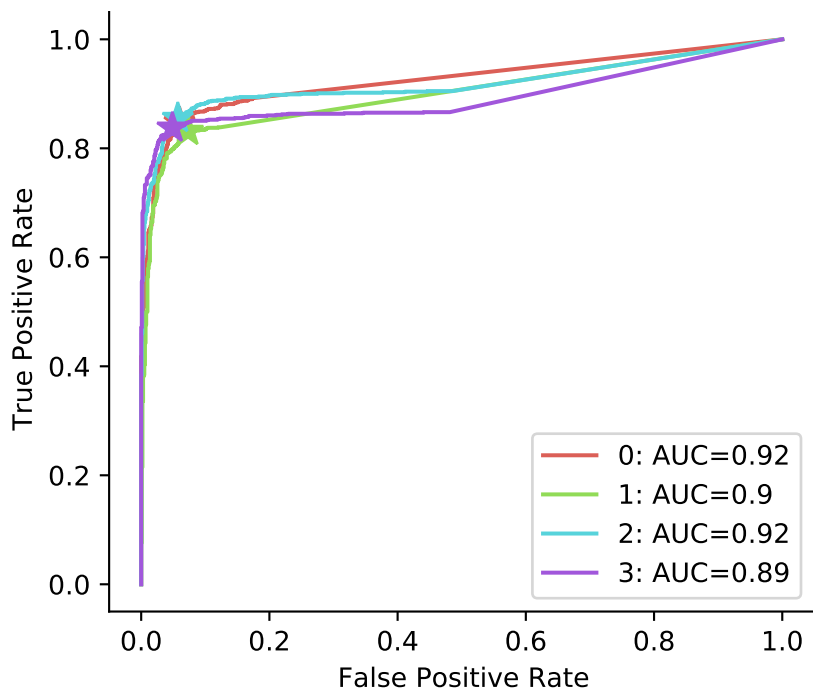**test**

Model:final
fit_clinicalbert.refsource.network
0: All: ClinicalBERT
1: All: PubMedBERT
2: Exact Only: ClinicalBERT
3: Exact Only: PubMedBERT

Top-left panel (valid, Precision vs Recall):
- 0: AUC=0.94 F1=0.88
- 1: AUC=0.93 F1=0.87
- 2: AUC=0.94 F1=0.89
- 3: AUC=0.93 F1=0.89

Top-right panel (test, Precision vs Recall):
- 0: AUC=0.93 F1=0.87
- 1: AUC=0.93 F1=0.86
- 2: AUC=0.93 F1=0.89
- 3: AUC=0.93 F1=0.89

Bottom-left panel (valid, True Positive Rate vs False Positive Rate):
- 0: AUC=0.92
- 1: AUC=0.9
- 2: AUC=0.92
- 3: AUC=0.89

Bottom-right panel (test, True Positive Rate vs False Positive Rate):
- 0: AUC=0.91
- 1: AUC=0.89
- 2: AUC=0.9
- 3: AUC=0.89