valid

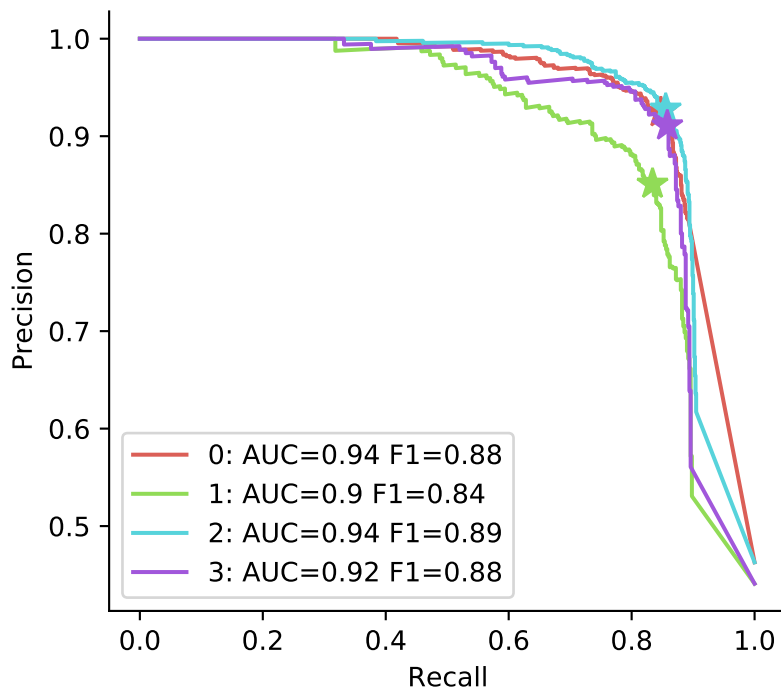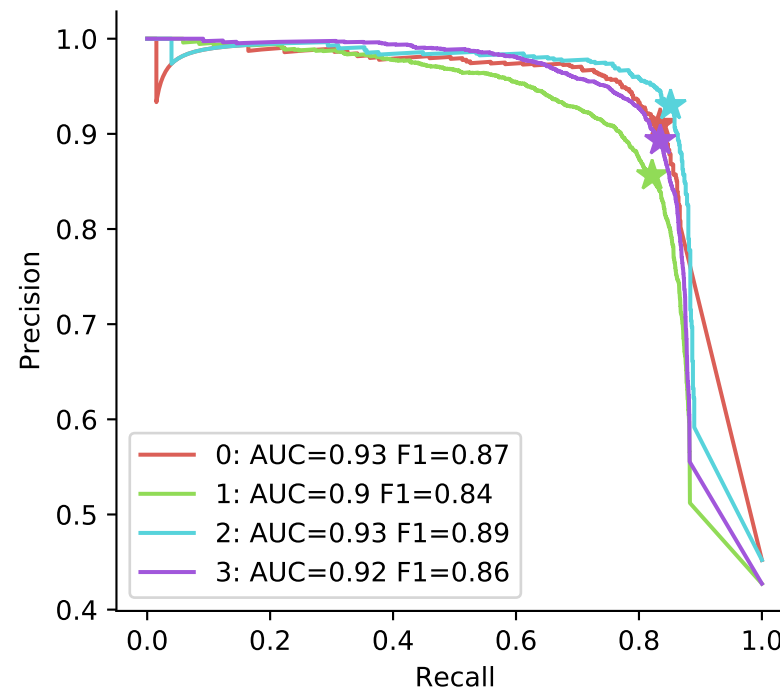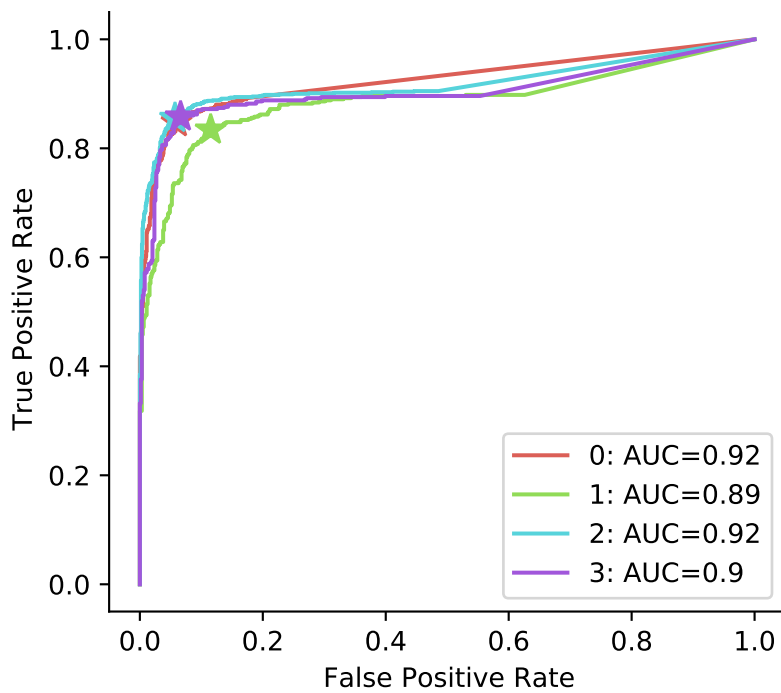**test**

Model:final
fit_clinicalbert.split-method.network
0: Default (80/10/10): CB
1: Default (80/10/10): PMB
2: TAC (45/5/50): CB
3: TAC (45/5/50): PBM

Top-left panel (valid, Precision vs Recall):
- 0: AUC=0.94 F1=0.88
- 1: AUC=0.9 F1=0.84
- 2: AUC=0.94 F1=0.89
- 3: AUC=0.92 F1=0.88

Top-right panel (test, Precision vs Recall):
- 0: AUC=0.93 F1=0.87
- 1: AUC=0.9 F1=0.84
- 2: AUC=0.93 F1=0.89
- 3: AUC=0.92 F1=0.86

Bottom-left panel (valid, True Positive Rate vs False Positive Rate):
- 0: AUC=0.92
- 1: AUC=0.89
- 2: AUC=0.92
- 3: AUC=0.9

Bottom-right panel (test, True Positive Rate vs False Positive Rate):
- 0: AUC=0.91
- 1: AUC=0.88
- 2: AUC=0.9
- 3: AUC=0.89