


Informe de mantención de membranas de la planta de agua de diálisis

El se procedió a realizar un lavado químico de todas las membranas, como parte de este procedimiento se mide y observa cada membrana por separado. En el siguiente esquema se puede apreciar la configuración de las membranas de la ósmosis reversa de la planta de agua.

Configuración de las membranas de la Osmosis Reversa 1

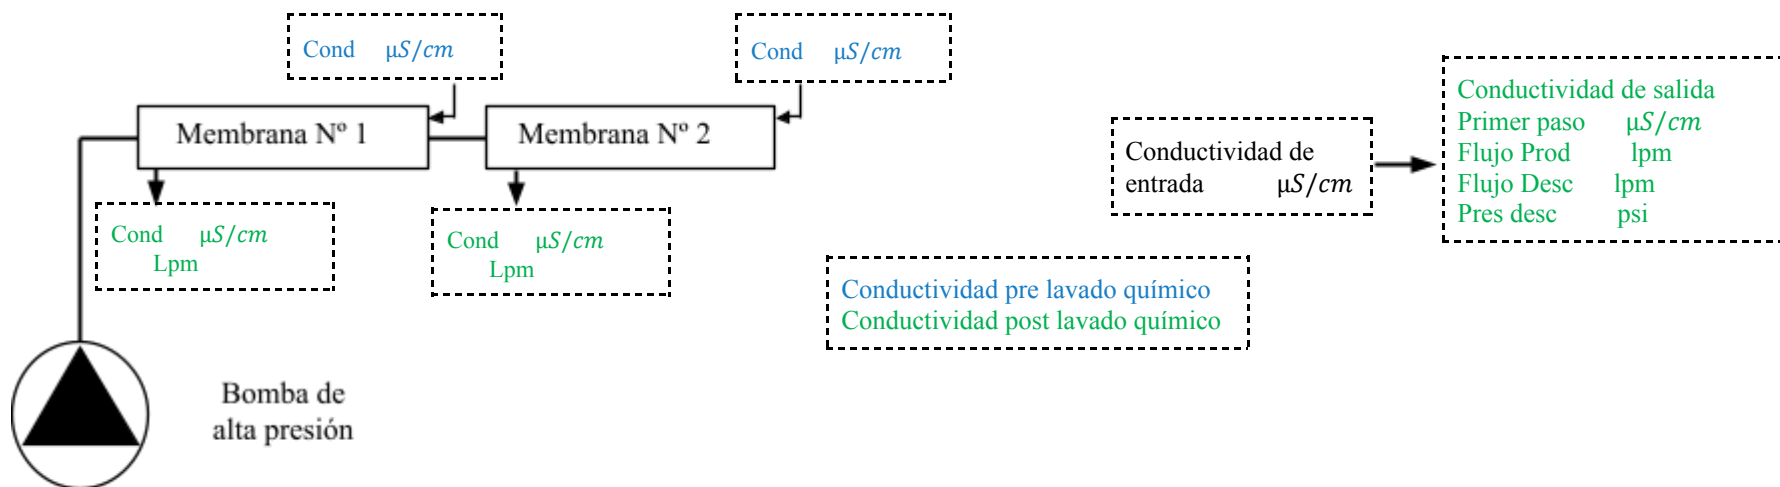

Después del procedimiento de lavado químico (ac. cítrico como desincrustante y ac. peracético como desinfectante), la conductividad de salida quedó en $\mu S/cm$, con lo cual estamos en una RR cercana al . También se verificaron los flujos normales (normal 3-5 lts. por membrana). La presión de rechazo quedó en psi y lpm de flujo de permeado. Se vuelve a configuración para trabajar como ósmosis en línea.

Servicio técnico
SIAC Ingeniería SPA