CAPTURE (hors Multipli)

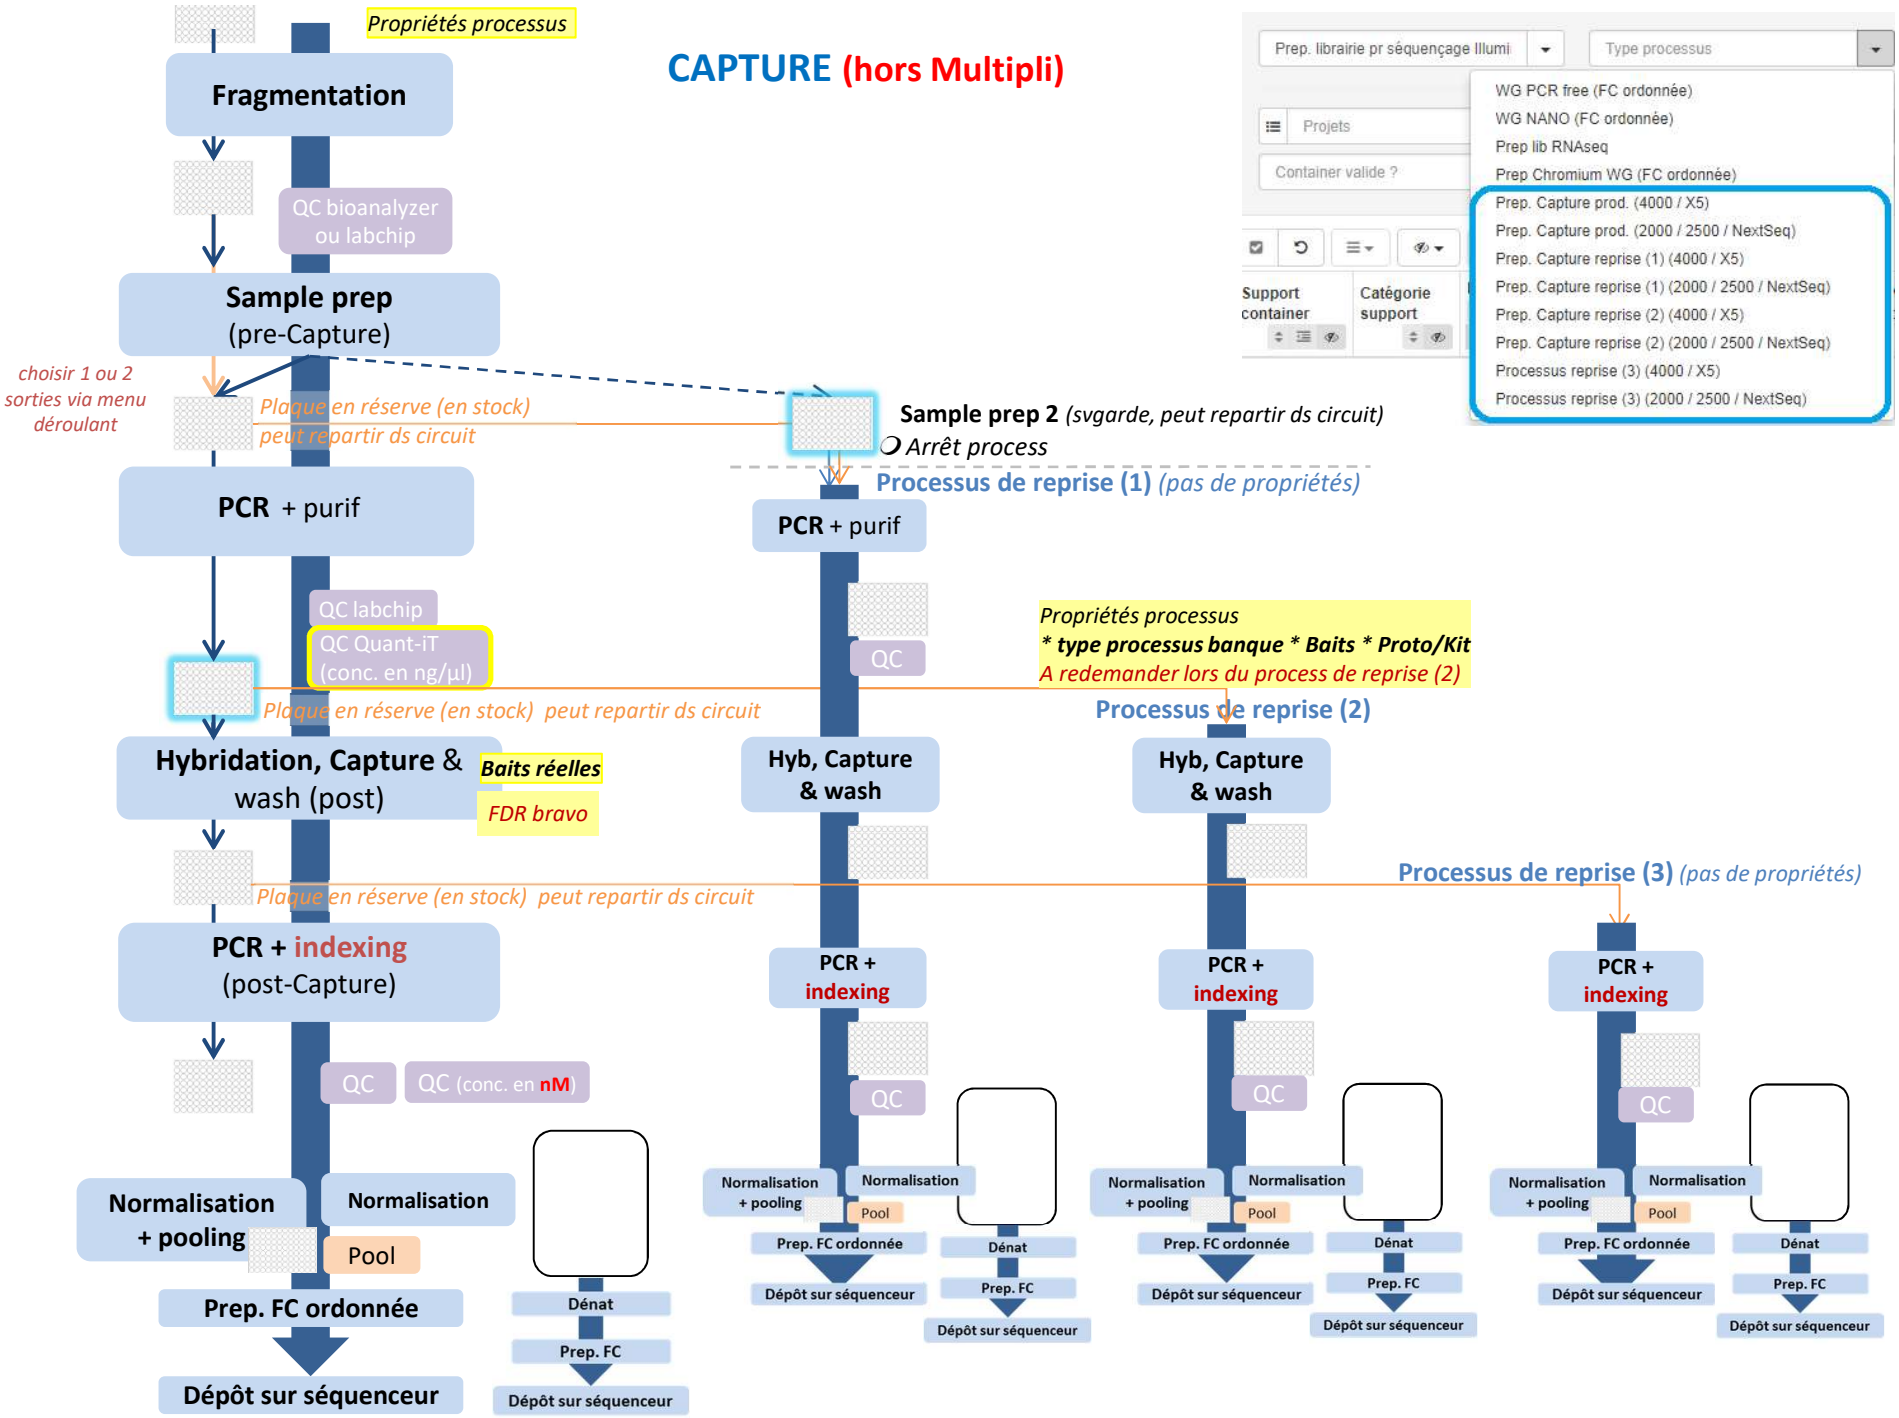

CAPTURE Multipli

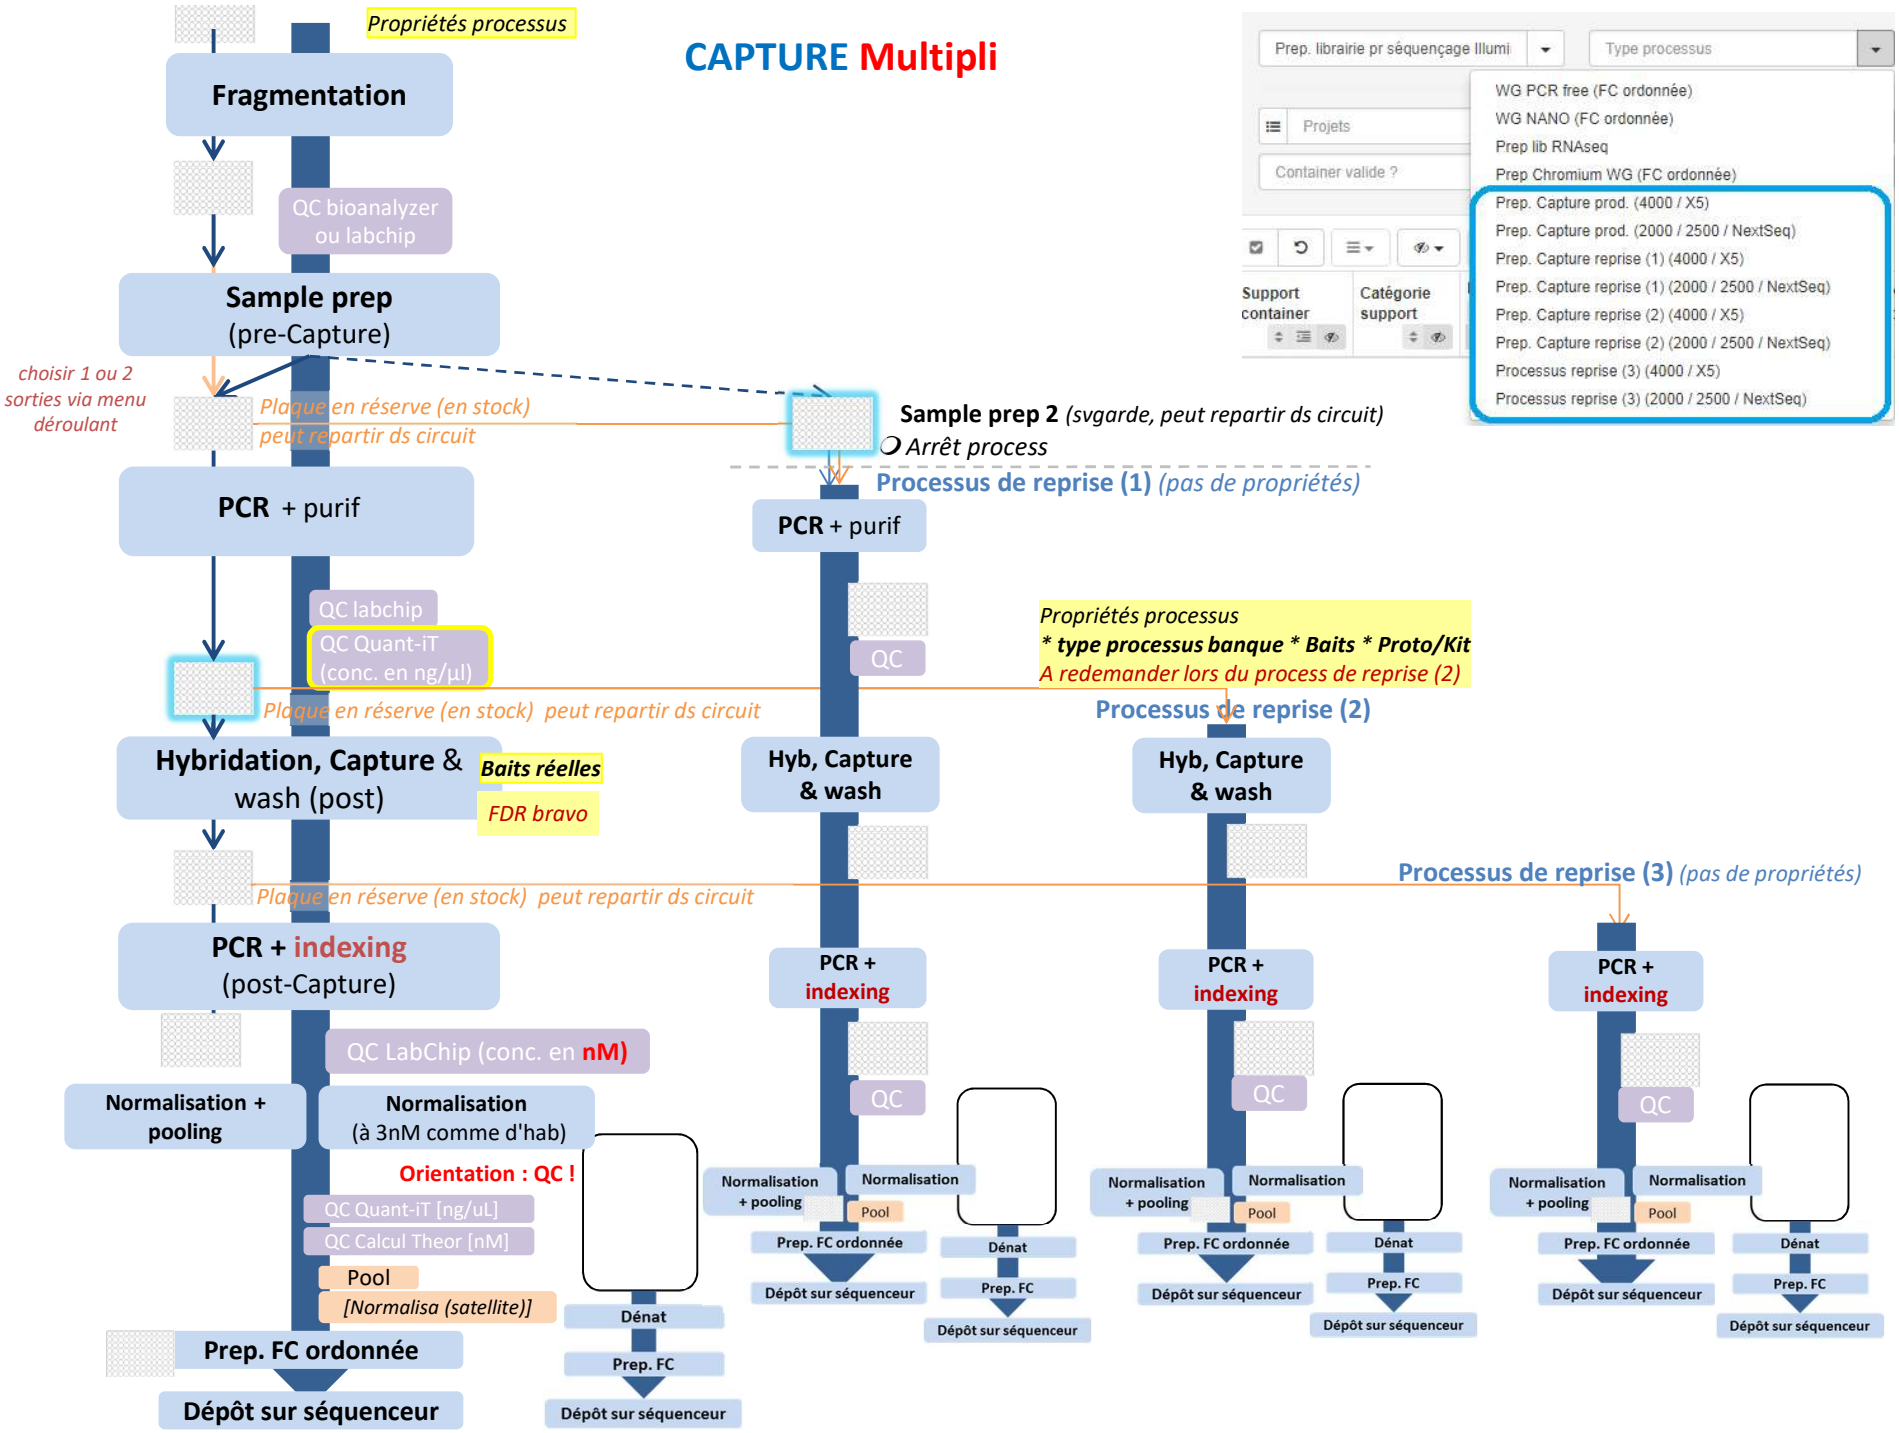

10/07/17

SOP pr chaque étape :
1_DNA_A_2_SOP_AGIL_Capture_Sciclone

Fragmentation

/ covaris (inactiver cov 1)

+ purif / robot à tracer : Sciclone NGSX : NGS-1, NGS-2, NGS-3

LHD : covaris + sciclone ; LMPD : uniquement covaris (pas de purif)

16/11/17 : ajout type Bravo WorkStation

QC

One to many
1 => N supports
(N à choisir : 1 ou 2)

Sample prep
(pre-Capture)

/ robot à tracer :
NGS-1, NGS-2, NGS-3 8/11/17 : ajout type Bravo WorkStation et instrument 3

Sample prep 2
❍ Arrêt process

POP UP ORIENTATION
grouper par support

(PCR-AND-PURIFICATION existante)

PCR + purif

THERMO Mastercycler1 (EP-Gradient) et Mastercycler2 (EP-Gradient)
+ purif / robot à tracer Zephyr, Bravo WS 1 et Bravo WS 2

QC labchip

QC Quant-iT
(conc. en ng/µl)

Trame fichier import résultat
à nous renvoyer si change

Volume final : valeur par défaut
plaque post-PCR et pre_Capture = 30 µl

Baits (sondes) utilisées (réel)
(calcul vol engagé pr qté souhaitée, ex. : 750ng)

Hybridation, Capture & wash (post)

Bravo Working Station 1 (LHD) et
Bravo Working Station 2 (LMPD)

8/11/17 : ajout type Bravo WorkStation + MasterCycler EP-Gradient

SCHEMA index PRE-DEFINI (plaque)
(définir colonne de départ)

PCR + indexing
(post-Capture)

THERMO Mastercycler4 (EP-Gradient) et Nexus SX1 machine 5
+ Purif / Bravo 1 et Bravo 2

Volume final : valeur par défaut
plaque post-PCR et post_Capture = 30 µl

QC (labchip)

QC (qPCR)

Normalisation + pooling

Normalisation

Pool

Prep. FC ordonnée

Dépôt sur séquenceur

	A	B	C	D
1	SourceBC	SourceWell	DestinationWell	Volume
2	SamplePlateXYZ	A1	A1	5.35
3	SamplePlateXYZ	B1	B1	4.28
4	SamplePlateXYZ	C1	C1	4.76
5	SamplePlateXYZ	D1	D1	5.19
6	SamplePlateXYZ	E1	E1	5.49
7	SamplePlateXYZ	F1	F1	4.86
8	SamplePlateXYZ	G1	G1	5.05
9	SamplePlateXYZ	H1	H1	4.37
10	SamplePlateXYZ	A2	A2	0

Exp de transfert (pool, tf en plq...)

Exp de transformation (obl. ds un processus)

Purification

QC