Guide d'utilisation

NGL-Reagents > Réception réactifs (« réception de LOTS »)

Table des matières


A. Déclarer des réceptions de réactifs et les rechercher, voire les éditer 2

B. SI MISE A JOUR CATALOGUE à postériori… blocage dans certains cas : 8

C. Partie NGL-SQ traçabilité dans les expériences 9

A. Déclarer des réceptions de réactifs et les rechercher, voire les éditer

1. Se connecter à NGL-Reagents : http://ngl-reagents.genoscope.cns.fr/
2. Aller dans le menu **Réception Réactifs**
3. Aller dans le sous-menu **Création (via un import fichier)**
4. **Choisir un fichier à importer**

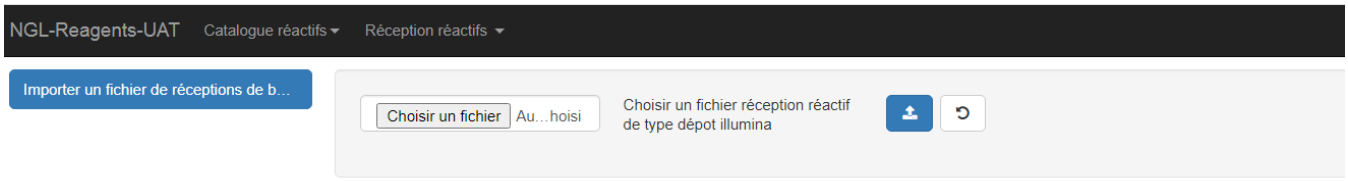


Pour le moment seul 1 type d'import est géré : Réception réactif de type dépôt illumina

Pour les réactifs de type *"type réactif dépôt illumina"*

A terme, plusieurs types d'import seront gérés (par atelier par exemple) et il y aura un menu déroulant proposant les différents types d'import par fichier (déclaration en masse)

Il y aura aussi un menu de déclaration de réception réactif « individuels », via l'interface (à utiliser pour la réception FC nanopore par exemple)

5. Récupérer le fichier (trame en lecture seule) « Fichier Réception_Réactifs illumina_masse_v2» qui se situe ici : Bureautique (K:) ▸ atelier ▸ COMMUN HD ▸ LIMS et NGL ▸ NGL-Réactifs

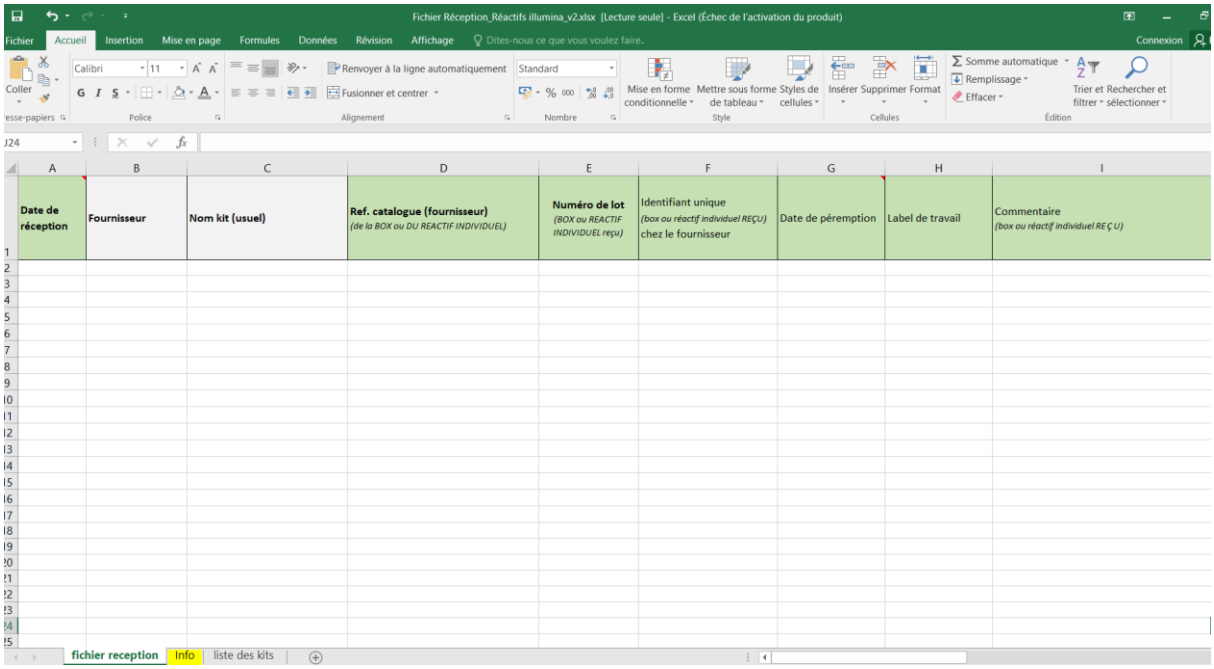

6. Remplir le fichier

a. Date de réception (à renseigner au format JJ/MM/AAAA)

b. Fournisseur (attention, actuellement, pas de vérification dans NGL de minuscule, majuscule, bonne orthographe ou nom des fournisseurs saisis. Menu déroulant mis dans l'excel pour faciliter une saisie homogène.

JG : revue CATALOGUE faite sur noms fournisseurs pour homogénéiser - fait avant MEP Alexandre pour ne pas avoir des noms erronés en réception - FAIT sur ~ 20 kits Illumina (corrigé en ILLUMINA) (NB : au moins 2 kits n'avaient pas de boite déclarée alors que c'est nécessaire j'ai donc dupliqué nom et ref dans boite).

i. Erreur si orthographe diffère de celle mise dans catalogue : « No catalog found for name : Kit Miseq 600 cycles v3 and provider : illumina »

c. **Nom kit (usuel)** [comme il apparaît dans recherche catalogue]

i. **Si erreur nom kit usuel, rejet fichier** « Error - row 2: No catalog found for name : MiSeq Reagent kit v3(600-cycles) and provider : ILLUMINA »

d. **Ref. catalogue (fournisseur)** *(de la BOX ou DU REACTIF INDIVIDUEL)* [comme elle apparaît dans recherche catalogue]

i. Si erreur ref catalogue fournisseur : Import reagent-reception: cannot find catalog for Reference '11111', provider 'Illumina' and kitCatalog name 'RiboZero'

ii. Si erreur car ref du KIT (et pas de la boite ou du reactif) : Import reagent-reception: cannot find catalog for Reference 'RZH1046', provider 'Illumina' and kitCatalog name 'RiboZero'

e. Contrôle sur la combinaison :

Fournisseur – Nom kit (usuel) – Ref catalogue (fournisseur) du reagent reçu

Au CNS on peut avoir une même ref fournisseur de boite déclarée dans plusieurs kits, dans le catalogue.

f. Numéro lot ***du reagent reçu*** *(BOX ou REACTIF INDIVIDUEL reçu)* : chiffre ou texte


g. Identifiant unique *(BOX ou REACTIF INDIVIDUEL reçu)* chez le fournisseur *(non obligatoire) (pas de contrôle d'unicité ou autre)*

h. Date de péremption (à renseigner au format JJ/MM/AAAA) *(non obligatoire)*

i. Label de travail (nom « raccourci » propre à chaque atelier, noté sur les boites pour se repérer plus facilement en les rangeant) *(non obligatoire)*

j. Commentaire *(BOX ou REACTIF INDIVIDUEL reçu)*

Fichier (lecture seule) disponible dans dossier commun :

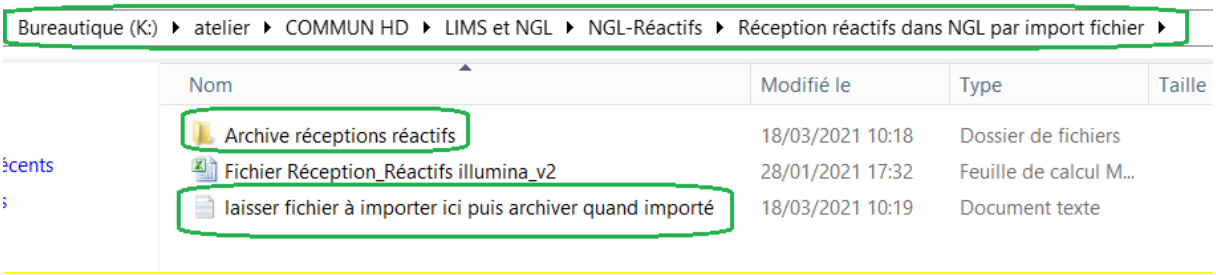


BONNE PRATIQUE :


- Laisser le fichier à importer dans le répertoire (qu'on puisse y aller facilement si on a besoin de vous aider)
- Et quand il a été importé avec succès, le déplacer dans "archive"

7. Importer le fichier dans NGL

a. Import réussi

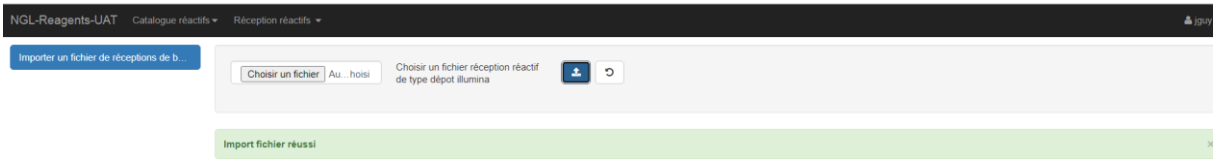


b. Echec

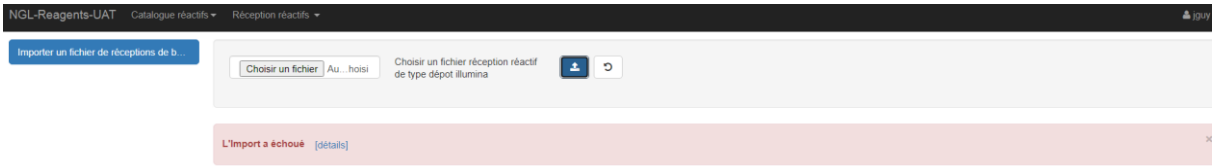

Cliquer sur [Détails] pour en savoir plus :

- **Liste des cas d'erreurs** *(cités plus haut)*

BONNE PRATIQUE : quand il a été importé avec succès, le déplacer dans "archive"

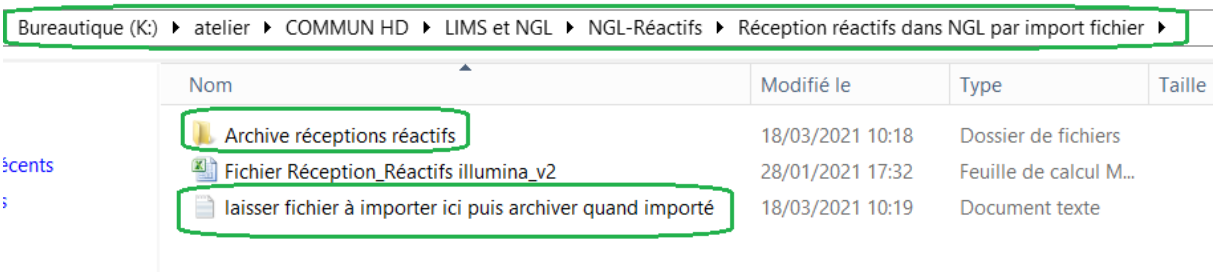

Etats possibles des réactifs reçus et créés dans NGL (dans la version actuelle) :

- **En cours (par défaut à la réception)**
- **Terminé**

(Prévu en mars avril 2021) : ajout de 2 états :


- Déclaré (deviendra l'état par défaut à la réception)
- Abandonné

Définitions :

- "Déclaré" = reçu, réceptionné, mais pas encore utilisé
- "En cours" = en cours d'utilisation
- "Terminé" = ne peut plus être utilisé dans les expériences (utilisé jusqu'à son nombre max d'utilisations, ou…)
- "Abandonné" = à ne pas utiliser ; problème dès la réception (arrivé endommagé, vide, ...)
  - *Quid d'un réactif arrêté après avoir démarré son utilisation (info fournisseur d'un lot défectueux par exemple) ? => Terminé ou abandonné ?*
  - *Quid d'un réactif pas utilisé à temps et arrivé à date de péremption ?*


Avoir un historique d'état pour la traçabilité.

8. Rechercher les réactifs reçus

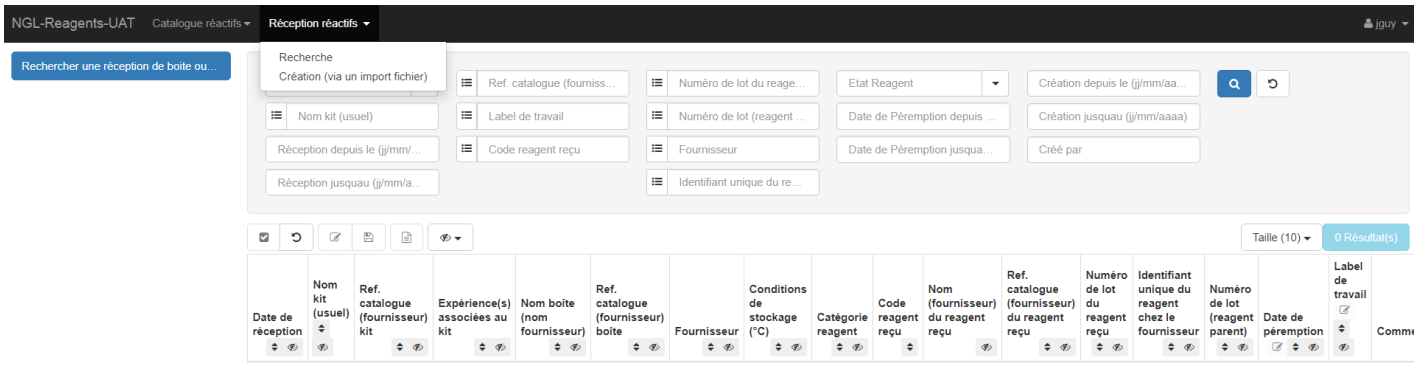

																Filtre : OK *Tri : bizarre*									
En dur	En dur Maj dans catalogue bloqué e	Dynamiq ue ok	**Afficher label? AP : nécessite refactoring donc à estimer** dynamique	dynamiq ue	Maj dans catalogue bloquée	En dur Maj dans catalogue bloquée	Dyna mique ok	En dur	En dur	Dynamiq ue ok	En dur Maj dans catalogue bloquée	En dur	En dur		En dur	En dur	En dur		En dur	En dur				
Date de récepti on	**Nom kit (usuel)**	**Ref. catalogu e (fourniss eur) kit**	**Expérience (s) associées au kit**	~~**Nom boîte**~~ **Nom reagent parent (nom fourniss eur)**	**Ref. catalogu e (fourniss eur) du reagent parent**	**Fourniss eur**	**Condi tions de stock age (°C) De la BOITE**	**Catégor ie reagent**	**Code reagent reçu (code unique NGL)**	**Nom (fourniss eur) du reagent reçu**	**Ref. catalogue (fournisseu r) du reagent reçu**	**Numéro de lot du reagent reçu** *pas éditable pr le moment*	**Identifiant unique du reagent chez le fournisseur** *pas éditable pr le moment*	~~**Num lot parent n'a plus de sens !**~~	**Date de pére mpti on**	**Label de travail**	**Comm entaire s**	**Nouveau Comme ntaire**	**Etat Reag ent**	**Date de début d'utilisati on** *Proposer calendrier + tard ?*	**Date de fin d'utilisati on** *Proposer calendrier + tard ?*	**Créé par**	**Date de créa tion**	**Mod ifié par**	**Date de modi ficati on**
22/12/2 020	RiboZe ro	RZH1046 kit	nanopore-library			Illumina		Box	614F19Y4 Q	RiboZero Box	RZH1046	22222	RGT33333	~~**ne peut pas fcter !**~~	05/0 6/20 21	JG_01	test JG		En cours			jguy	04/0 1/20 21		
01/01/2 002	RiboZe ro	RZH1046 kit	nanopore-library			Illumina		Box	614F1VZ8 2	RiboZero Box	RZH1046	texte	RGT33333		05/0 6/20 21	JG_03	test JG		En cours			jguy	04/0 1/20 21		

9. Trier, exporter, cacher, EDITER, filtrer

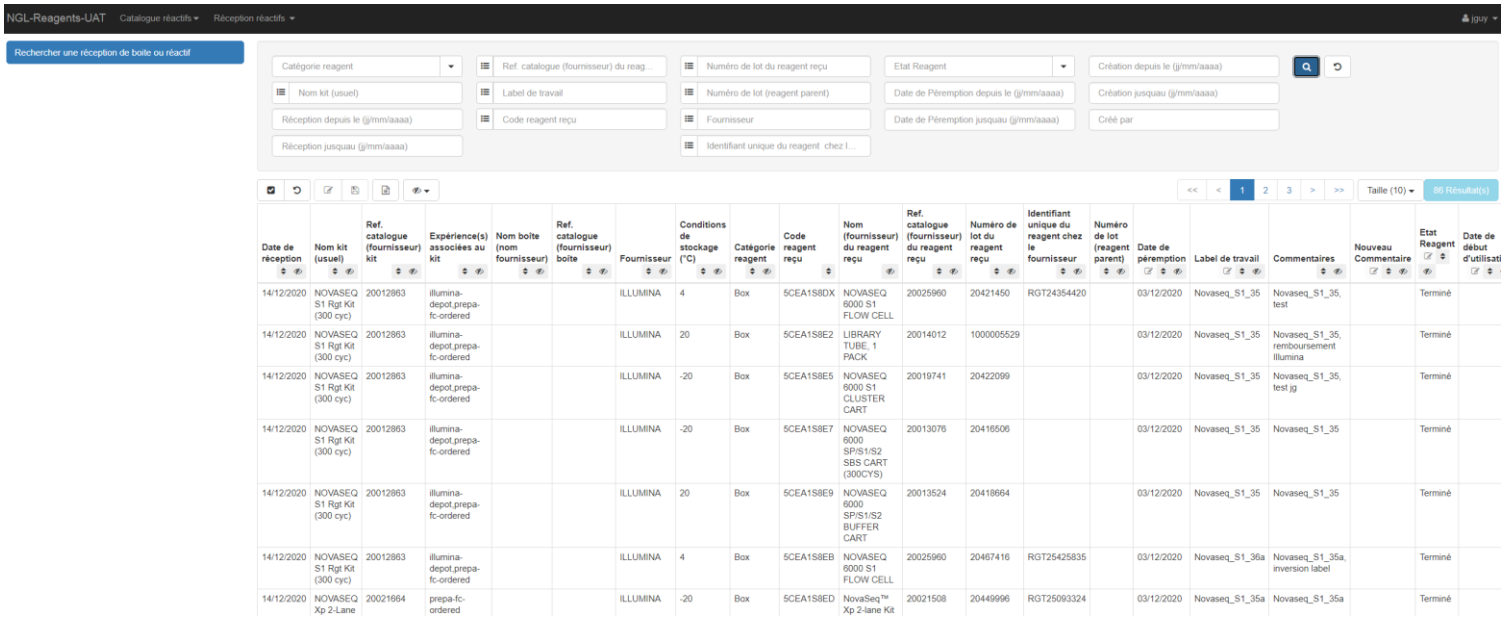

Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom boîte (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) boîte	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur	Numéro de lot (reagent parent)	Date de péremption	Label de travail	Commentaires	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisati
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	4	Box	5CEA1S8DX	NOVASEQ 6000 S1 FLOW CELL	20025960	20421450	RGT24354420		03/12/2020	Novaseq_S1_35	Novaseq_S1_35, test		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	5CEA1S8E2	LIBRARY TUBE, 1 PACK	20014012	1000005529			03/12/2020	Novaseq_S1_35	Novaseq_S1_35, remboursement Illumina		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	5CEA1S8E5	NOVASEQ 6000 S1 CLUSTER CART	20019741	20422099			03/12/2020	Novaseq_S1_35	Novaseq_S1_35, test jg		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	5CEA1S8E7	NOVASEQ 6000 SP/S1/S2 SBS CART (300CYS)	20013076	20416506			03/12/2020	Novaseq_S1_35	Novaseq_S1_35		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	5CEA1S8E9	NOVASEQ 6000 SP/S1/S2 BUFFER CART	20013524	20418664			03/12/2020	Novaseq_S1_35	Novaseq_S1_35		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ S1 Rgt Kit (300 cyc)	20012863	illumina-depot_prepa-fc-ordered			ILLUMINA	4	Box	5CEA1S8EB	NOVASEQ 6000 S1 FLOW CELL	20025960	20467416	RGT25425835		03/12/2020	Novaseq_S1_36a	Novaseq_S1_35a, inversion label		Terminé	
14/12/2020	NOVASEQ Xp 2-Lane	20021664	prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	5CEA1S8ED	NovaSeq™ Xp 2-lane Kit	20021508	20449996	RGT25093324		03/12/2020	Novaseq_S1_35a	Novaseq_S1_35a		Terminé	

Champs éditables : avec logo « édition » (crayon)

B. SI MISE A JOUR CATALOGUE à postériori… blocage dans certains cas :

a. **Nom kit usuel**
b. **Fournisseur (majuscule / minuscule près)**
c. **ref fournisseur de la box ou reagent**

label dans reception reactifs	code dans reception reactifs	code dans catalogue reactifs
Nom kit (usuel)	"kitCatalogName"	= name dans catalogue
Fournisseur	"providerCode"	= providerCode dans catalogue
Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	"catalogRefCode"	= catalogRefCode pour category = box ou reagent dans catalogue

Quand l'utilisateur édite le catalogue et qu'il enregistre,
on regarde si la valeur de nom kit usuel OU la valeur de fournisseur (majuscule / minuscule près) OU la valeur de ref fournisseur de la box ou reagent a changé
ET SI il y a des reception reactifs associées :

- **Si toutes ces conditions sont remplies** => msg d'erreur à la svgarde "vous ne pouvez pas modifier ces champs catalogue car des réactifs reçus y sont associés" (qq chose comme ça) **Sauvegarde echouée** : Modification impossible. Des réceptions de réactifs utilisent la valeur de ce champ
- Si l'une des conditions n'est pas remplie (pas de reactifs reçus associés OU réactifs associés mais pas de changement de valeur sur l'un des 3 champs) => svgarde autorisée.

- message d'erreur création nom kit (usuel) dans KitCatalogue
- oui si nom kit usuel doublon avec un déjà utilisé et associé à des réceptions
  Création impossible. Des réceptions de réactifs utilisent un autre catalogue avec le même nom.
  Sauvegarde echouée

- name
  - Création impossible. Des réceptions de réactifs utilisent un autre catalogue avec le même nom.

C. Partie NGL-SQ traçabilité dans les expériences

Seuls les réactifs en cours et avec label apparaissent dans le menu déroulant (raccourci)

Sélectionner le label et cliquer sur + pour qu'il s'injecte dans le tableau de suivi des réactifs (avec toutes les infos de ref, num lot, ID unique, renseignées automatiquement) (n'ont plus besoin d'être saisies à la main).

NB : si un label correspond à N réactifs, les N réactifs sont injectés dans le tableau.

Présentation power point à disposition pour visualiser les vues interface