DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

www.cea.fr

NGL – REAGENTS

http://ngl-reagents.genoscope.cns.fr/

Julie GUY

APPLICATION EN LIEN AVEC NGL-SQ

Projects

- Diversity of project types
- Specific traceability for large projects, such as TARA, Wheat, French Exome…




NGL-P

Bank of Samples

- Diversity of sample types
- Automation
- Robot integration



NGL-SQ

NGL-Reagents

Sequencing Experiments

- Diversity of library types
- Automation and robot integration
- Ever-evolving sequencing technologies




Researchers

NGL-SUB

EMBL-EBI

Data Submission

- Easy way to select data that must be submitted.
- Edit study and sample information

NGL-BI

Bioinformatic Analyses

- Easy way to see all post-sequencing data on the same interface
- Problem analysis and multi -cause traceability
- Possibility to assess readsets by hundreds



Les anciens LIMS restent maîtres pour la création de projet. Les projets s'importent automatiquement dans NGL-Projects.

Tout s'effectue dans NGL – plus besoin des anciens lims,.



NGL-REAGENTS

MENU CATALOGUE

RÉSUMÉ DÉVELOPPEMENTS

Phase 1 du développement / EN PROD



- L'utilisateur déclare un CATALOGUE de réactifs dans l'application NGL-Reagents (noms de kit, références chez le fournisseur, noms des boîtes et tubes de réactifs contenus à l'intérieur, info des types d'expériences (dans SQ) dans lesquelles ces réactifs peuvent être utilisés) [à déclarer 1 fois pour toutes]



- Dans NGL-SQ, **au moment de la déclaration des expériences**, l'utilisateur trace les réactifs utilisés dans le tableau reagents en bas de page (menu déroulant avec les NOMS des kits proposés, puis l'utilisateur saisit à la main les n° de lot et ID unique). Ces informations sont utilisées pour le reporting réactifs. On peut également rechercher les expériences effectuées avec tel ou tel n° de lot (ou n°ID / RGT) si un lot est incriminé par le fournisseur.

- **NB** : aucune info n'est tracée à la RECEPTION des lots de réactifs dans NGL. Les dates de péremption ne sont pas tracées non plus dans NGL.

Phase 2 du développement / EN PROD (fev 21)

- Tracer dans NGL-Reagents **la réception des lots de réactifs (avec DATE péremption, n° lot, ID / RGT …)** (nouveau menu dans NGL-Reagents)
- Ainsi, dans NGL-SQ, **au moment de la déclaration des expériences**, l'utilisateur choisit le réactif utilisé et n'a plus à saisir d'infos à la main. Le reporting réactifs continue de fonctionner.

« SCHÉMATISATION DES NIVEAUX DE REACTIFS»







3 niveaux de traçabilité :

→ Niveau 1 => « kit » : ensemble de boites, sachets…

→ Niveau 2 => élément du kit : boite, sachet…

→ Niveau 3 (non obligatoire) => tubes dans boites par exemple

INFORMATIONS « GÉNÉRALES » ASSOCIÉES À UNE « RÉFÉRENCE CATALOGUE »

Nom, référence fournisseur, types expériences dans lesquels il est utilisé, conditions de stockage (T°C), utilisé ou non…







3 niveaux de traçabilité :

- Niveau 1 => « kit » : ensemble de boites, sachets…
- Niveau 2 => élément du kit : boite, sachet…
- Niveau 3 (non obligatoire) => tubes dans boites par exemple

Actuellement tracé dans menu CATALOGUE dans NGL-Reagents

INFORMATIONS « SPÉCIFIQUES » ASSOCIÉES À UNE « RÉCEPTION DE LOTS »

N°LOT, date de péremption, CB unique …








Initialement tracées dans SQ dans l'expérience, dans le tableau reagents en bas de page.
(depuis phase 2/ tracées dans un menu dédié dans NGL-Reagents)

VUE INTERFACE / NGL-REAGENTS : CRÉATION REF. CATALOGUE

- Aller dans NGL-REAGENTS, puis dans le menu Catalogue > Créer.
- Renseigner les informations aux différents niveaux : **kit, boîte (obligatoire)**, réactif (non obligatoire).
- *(propriétés à adapter en fonction de vos besoins)*

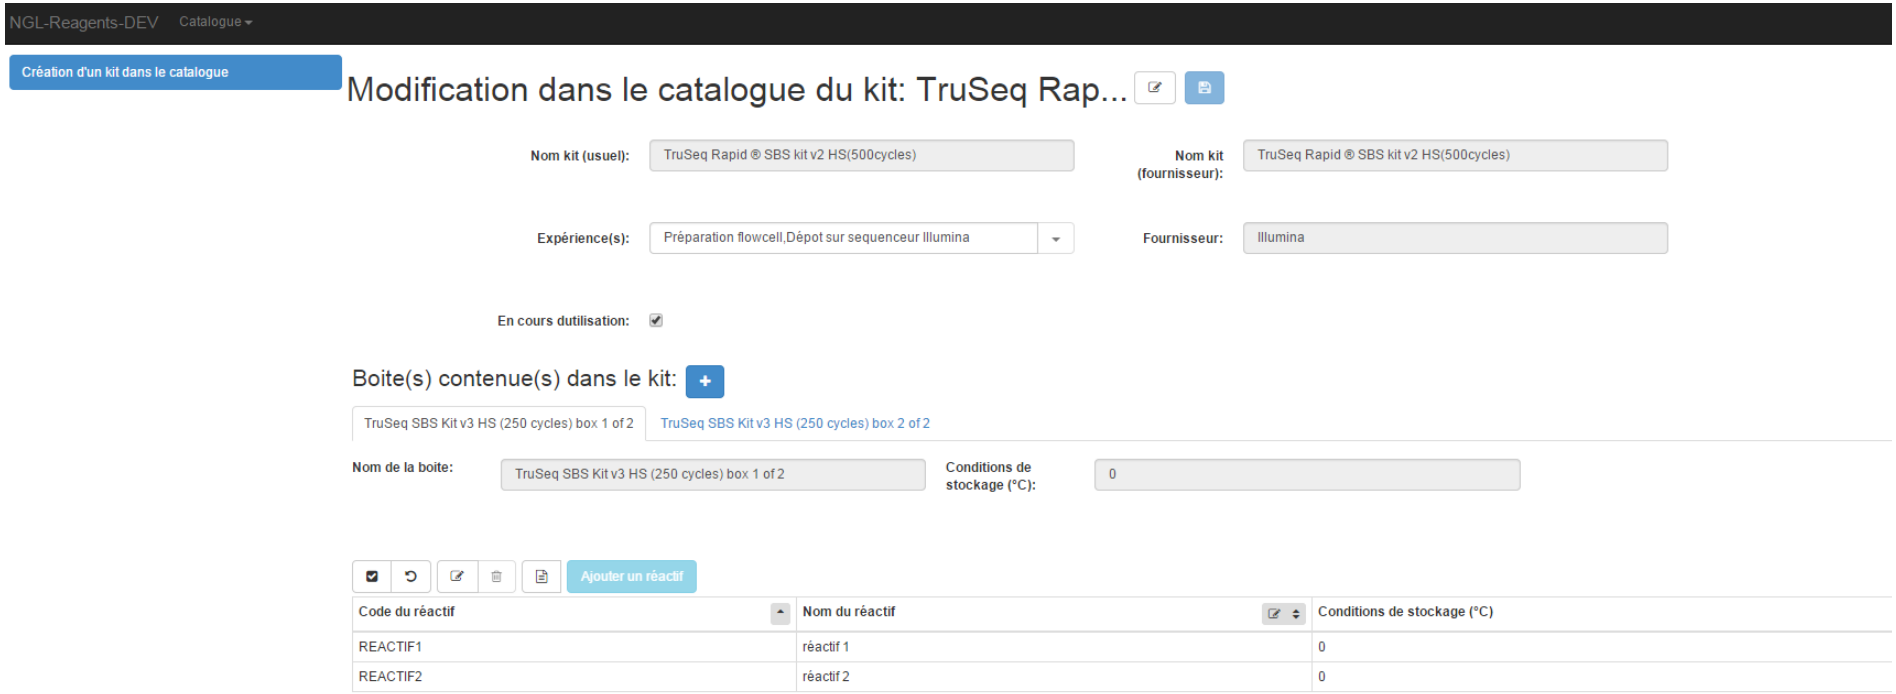

VUE INTERFACE - EXEMPLE

NOVASEQ SP Rgt Kit (500 cycles)

Nom kit (usuel) : NOVASEQ SP Rgt Kit (500 cycles)

Fournisseur : ILLUMINA

Nom kit (fournisseur) : NovaSeq 6000 SP Reagent Kit (500 cycles)

Expérience(s) : Prep. flowcell ordonnée,Depot Illumina

Ref. catalogue (fournisseur) : 20029137

Code : 44B936O9O

En cours d'utilisation : ☑

Boîte(s) contenue(s) dans le kit : +

NOVASEQ 6000 SP CLUSTER CART | NOVASEQ 6000 SP/S1/S2 BUFFER CART | NovaSeq 6000 SP SBS CART (500 CYS) | NOVASEQ 6000 SP FLOW CELL | LIBRARY TUBE, 1 PACK

Nom boîte : NOVASEQ 6000 SP CLUSTER CART

Conditions de stockage (°C) : -20

Ref. catalogue (fournisseur) : 20027556

Nombre d'utilisations : 1

Code : 44B936P9Z

En cours d'utilisation : ☑


Ajouter un réactif

2 Résultat(s)

Nom du réactif	Ref. catalogue (fournisseur)	Conditions de stockage (°C)	Nombre d'utilisations	Code


VUE INTERFACE / NGL-REAGENTS : RECHERCHE UNE REF. CATALOGUE

❑ **Visualisation des détails d'un kit.**

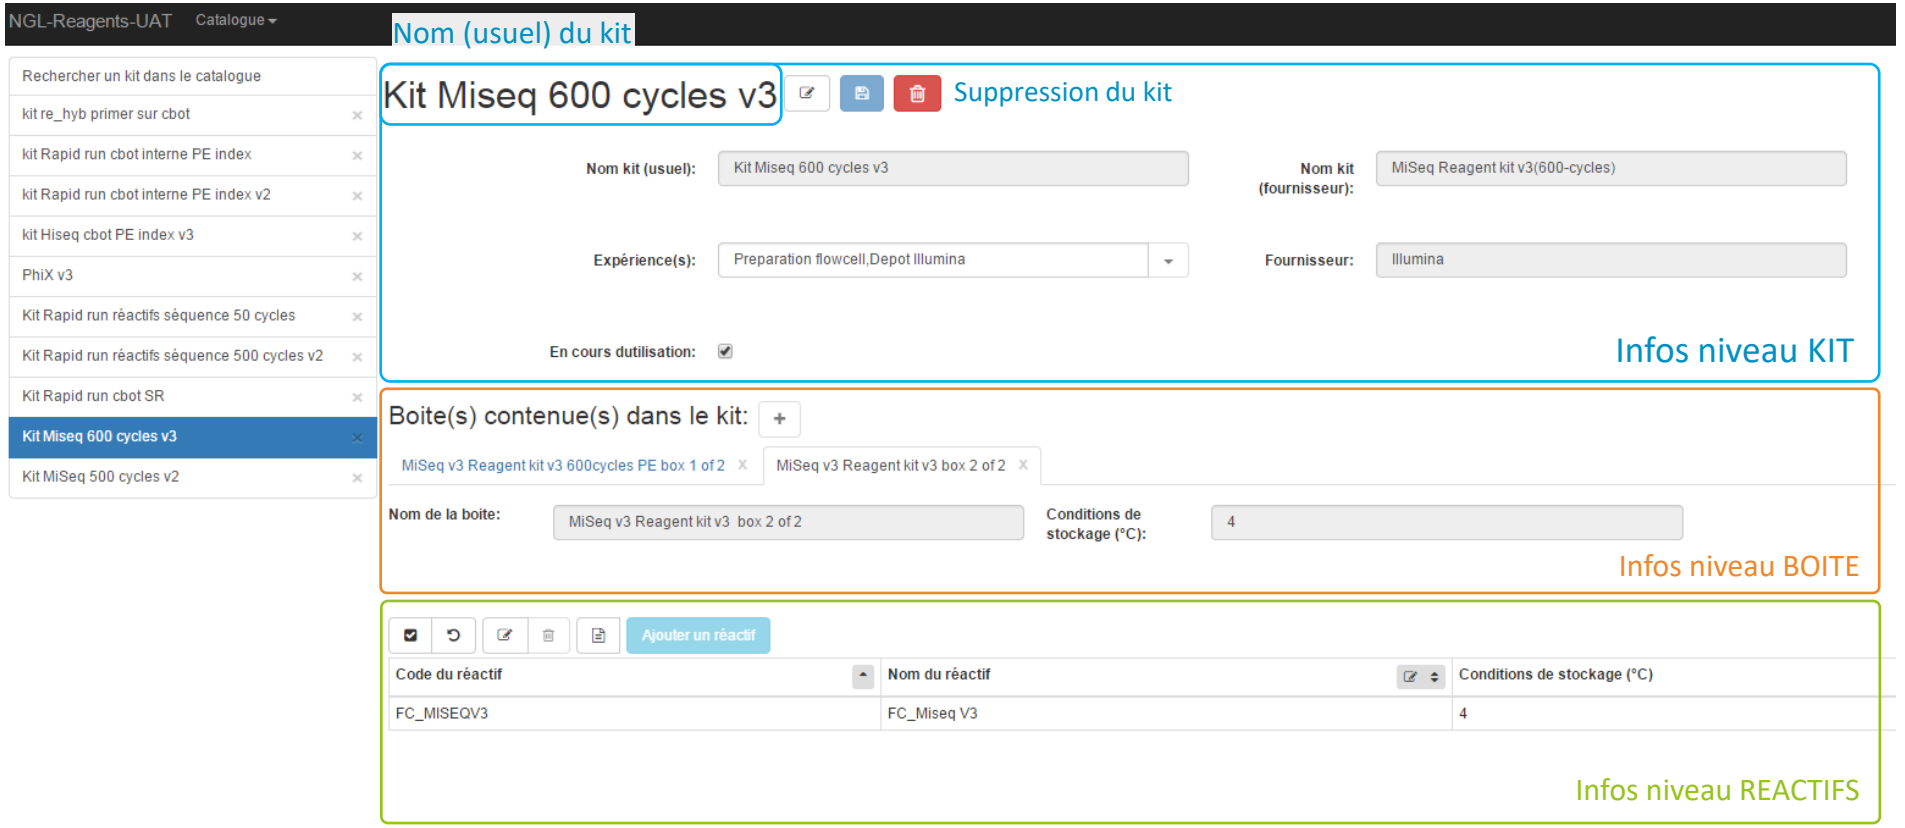


VUE INTERFACE / NGL-SQ : TRAÇABILITÉ DANS LES EXPÉRIENCES des informations spécifiques (n° lot, CB unique…)

- Dans **NGL-SQ lors de la déclaration expérience**. La liste des noms usuels des kits apparaît dans le tableau reagents en bas de page.
- On peut alors tracer les CB des boites et/ou réactifs, associé à un kit, que l'on utilise dans une expérience.

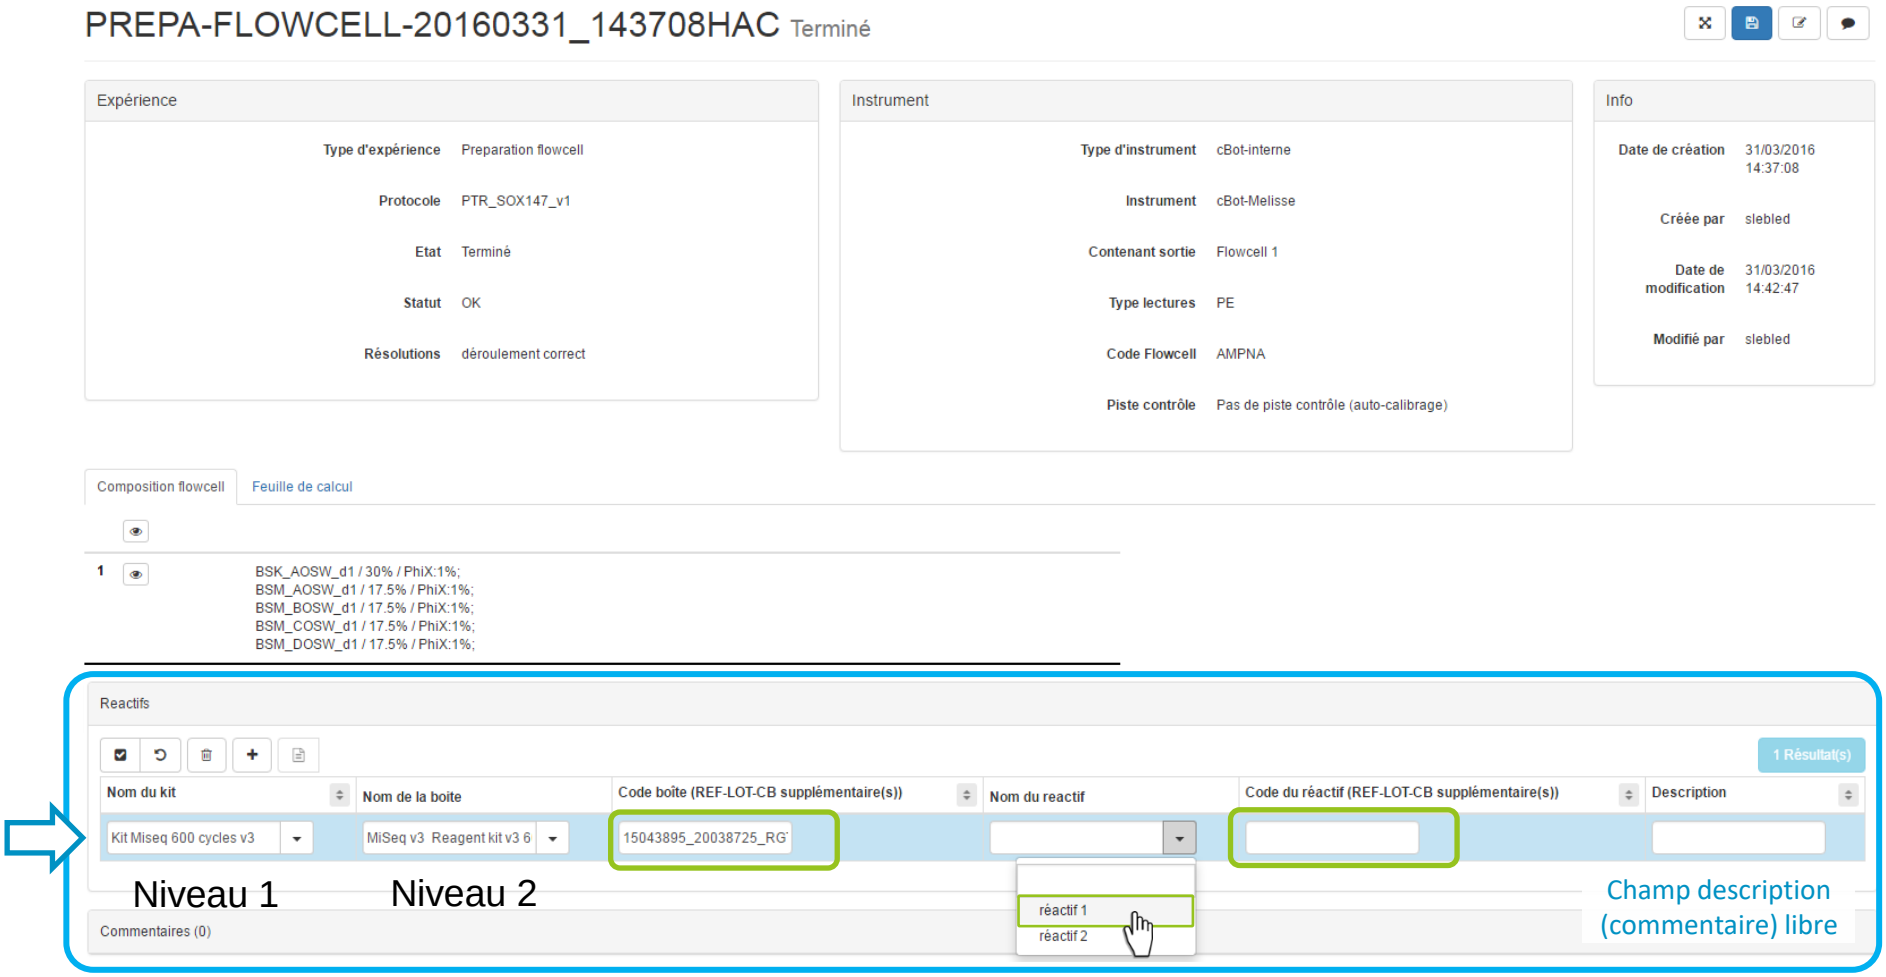


Si besoin, aller jusqu'au niveau 3 et saisie des informations du niveau 3

VUE INTERFACE / NGL-SQ : TRAÇABILITÉ DANS LES EXPÉRIENCES des informations spécifiques (n° lot, CB unique…)

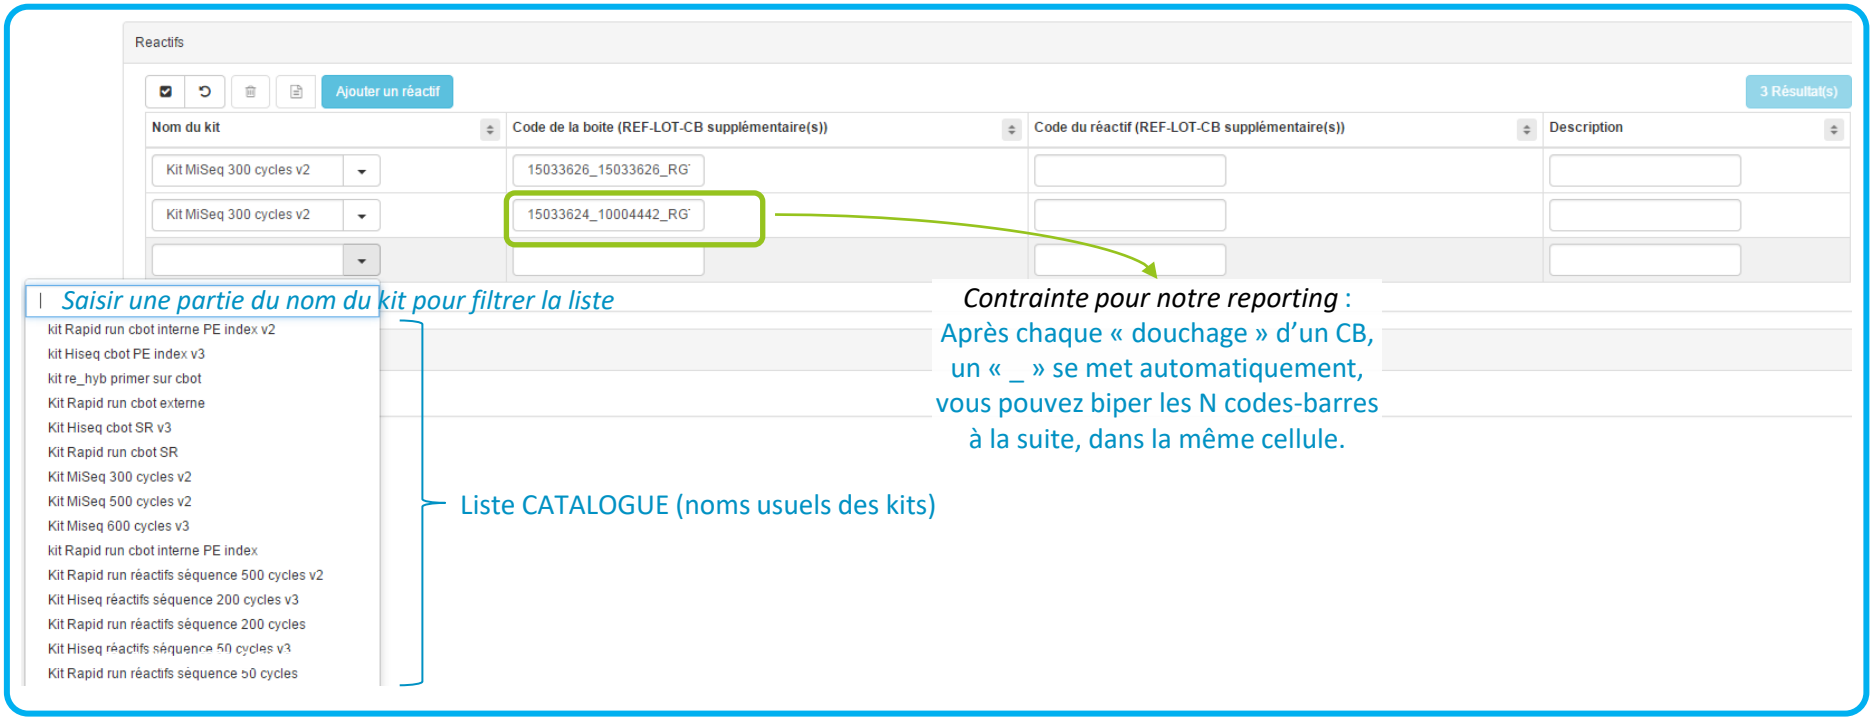


VUE INTERFACE / NGL-SQ : TRAÇABILITÉ DANS LES EXPÉRIENCES des informations spécifiques (n° lot, CB unique…)

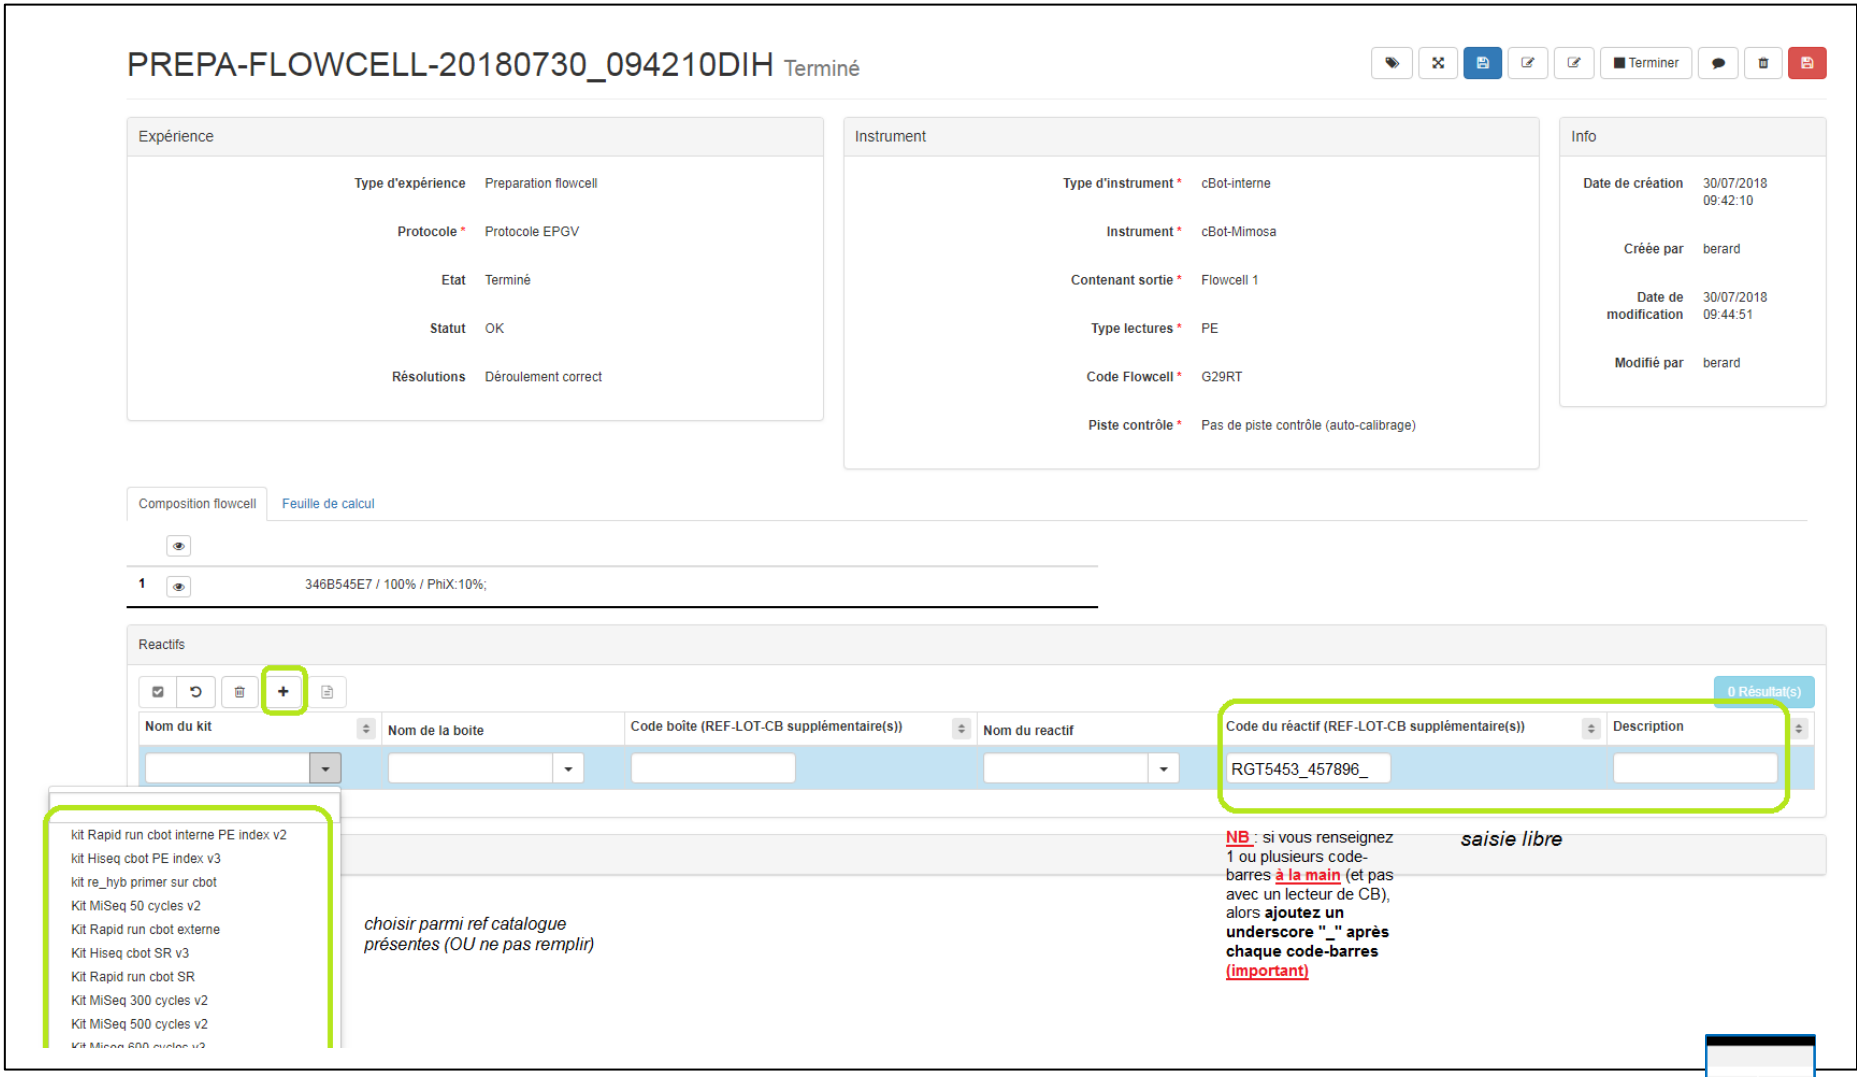


REPORTING DANS NGL-SQ / POSSIBILITÉ DE RECHERCHER DES EXPÉRIENCES À PARTIR D'UN CODE-BARRES RÉACTIFS OU N° LOT INCRIMINÉ

Aller dans le **Menu Expérience > Recherche.**

Renseigner le filtre de recherche **« CB boîte ou réactif »**

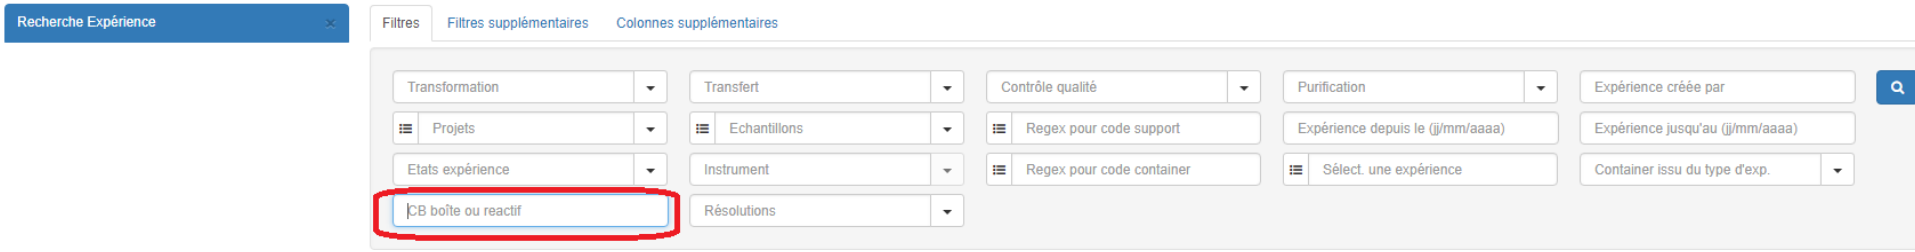

Lancer la recherche.

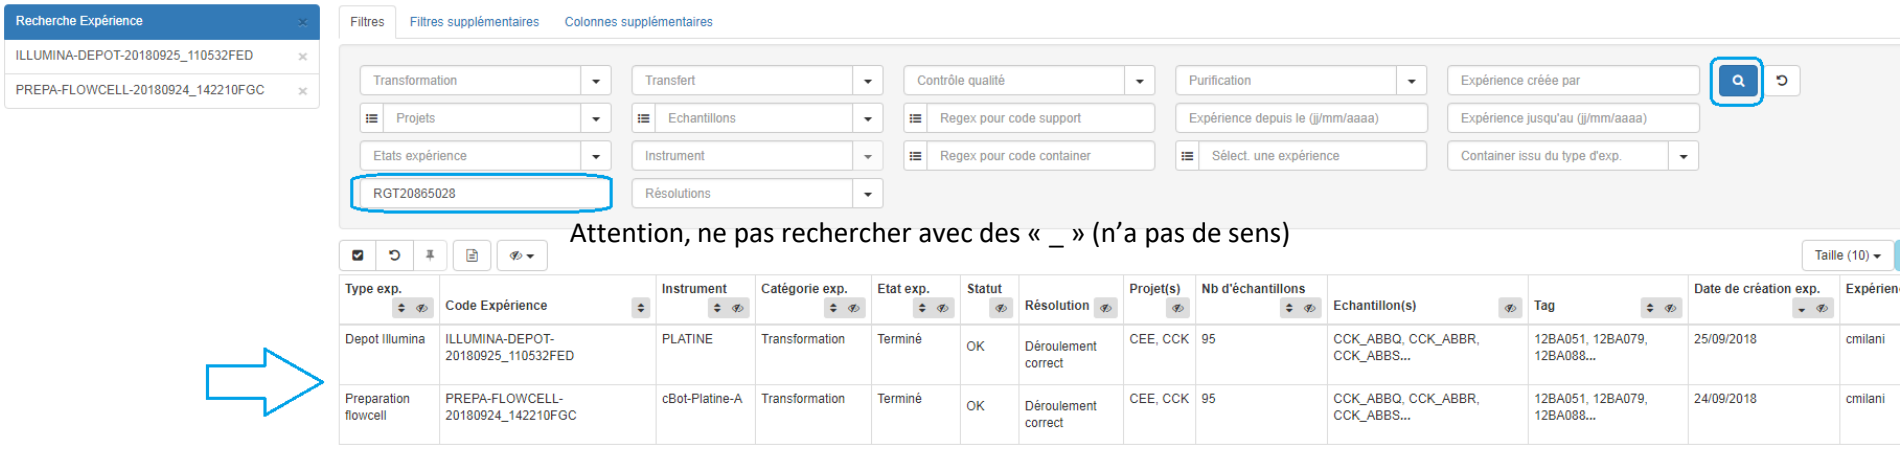

Attention, ne pas rechercher avec des « _ » (n'a pas de sens)

Résultats = expériences qui contiennent une boîte ou un réactif dont 1 des codes-barres est celui recherché *(dans notre exemple : RGT20865028)*

[contrainte technique : recherche de CB entre « _ » (plus précisément suivi d'«_»)]

explication

REPORTING / POSSIBILITÉ DE RECHERCHER DES EXPÉRIENCES À PARTIR D'UN CODE-BARRES RÉACTIFS OU N° LOT INCRIMINÉ

PREPA-FLOWCELL-20180924_142210FGC Terminé

Terminer

Expérience

Type d'expérience	Preparation flowcell
Protocole *	CBot_rapid_run_2500_Illumina
Etat	Terminé
Statut	OK
Résolutions	Déroulement correct

Instrument

Type d'instrument *	cBot-interne
Instrument *	cBot-Platine-A
Contenant sortie *	Flowcell 2
Type lectures *	PE
Code Flowcell *	HKNTTBCX2
Piste contrôle *	Pas de piste contrôle (auto-calibrage)

Info

Date de création	24/09/2018 14:22:10
Créée par	cmilani
Date de modification	05/10/2018 15:17:29
Modifié par	cmilani

Run(s)
180925_PLATINE_HKNTTBCX2

Composition flowcell | Feuille de calcul

1		39EB4O61W / 100% / PhiX:1%;
2		39EB4O61W / 100% / PhiX:1%;

Reactifs


4 Résultat(s)

Nom du kit	Nom de la boite	Code boite (REF-LOT-CB supplémentaire(s))	Nom du reactif	Code du réactif (REF-LOT-CB supplémentaire(s))	Description
kit Rapid run cbot interne PE index v2	FC PE Hiseq 2500 FLOWCELL grafted v2	15053059_HKNTTBCX2_HKNTTBCX2_			
PhiX v3	PhiX control v3	15017666_20216636_RGT1650377_			Lot Florent
kit Rapid run cbot interne PE index v2	TruSeq ® Rapid PE Cluster kit HS v2	15056108_20270101_RGT20865028_			
PhiX v3	PhiX control v3	15017666_20216636_RGT1650377_		20202985	Lot Florent

RGT20865028


BILAN PLUS GÉNÉRAL VIA LE MENU EXPÉRIENCE > REPORTING RÉACTIFS (pour avoir un état des lieux complet de tous les réactifs tracés dans les expériences choisies via les filtres de recherche)

Aller dans le **Menu Expérience > Reporting Réactifs.**

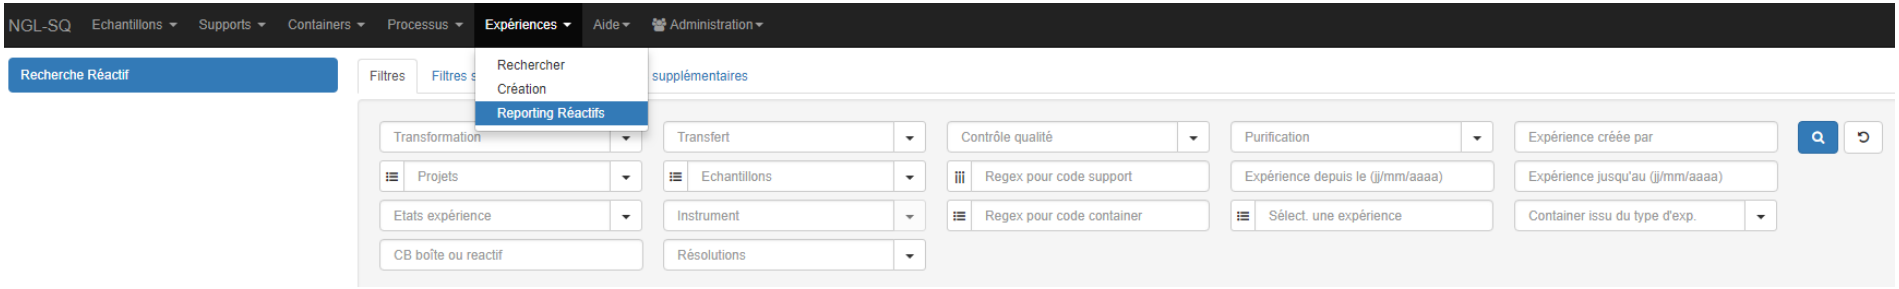


Renseigner les filtres de recherche pour cibler les expériences dont il faut visualiser les réactifs.

- *Exemple 1 : type expérience (prep FC ou prep FC ord ou Dépôt) + date de création depuis, jusqu'au.*

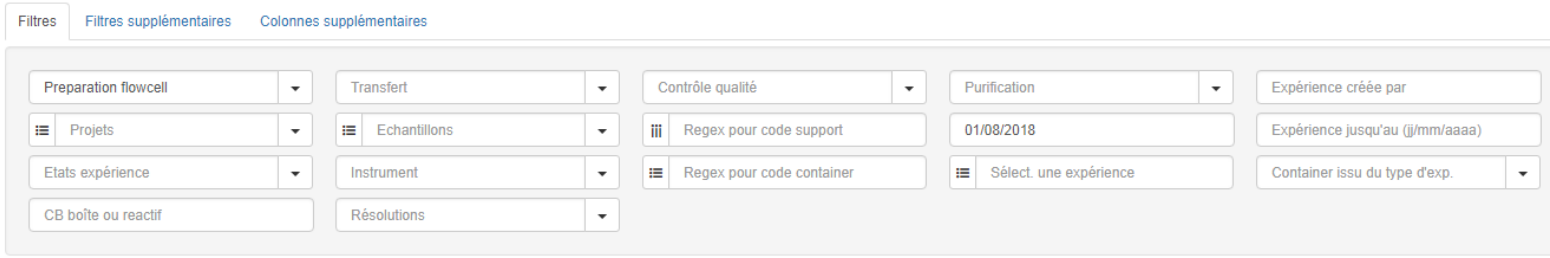

- *Exemple 2 : coller une liste de codes flowcell (exportées depuis BI par exemple) et la coller dans la zone de texte code support*



BILAN > REPORTING RÉACTIFS

Après avoir renseigné les filtres, lancer la recherche.

Résultats = une ligne par réactif enregistré dans l'expérience.

C'est pourquoi **le même code d'expérience peut-être répété sur N lignes.**

herche Réactif

Filtres | Filtres supplémentaires | Colonnes supplémentaires

Transformation | Transfert | Contrôle qualité | Purification | Expérience créée par

Projets | Echantillons | Regex pour code support | Expérience depuis le (jj/mm/aaaa) | Expérience jusqu'au (jj/mm/aaaa)

Etats expérience | Instrument | Regex pour code container | Sélect. une expérience | Container issu du type d'exp.

CB boîte ou reactif | Résolutions

Exporter en csv.

<< < 1 2 3 > >>

Type exp.	Code Expérience	Instrument	Projet(s)	Echantillon(s)	Date de création exp.	Expérience créée par	Nom du kit	Nom de la boite	Code boîte (REF-LOT-CB supplémentaire(s))	Nom du reactif	Code du r CB supplé
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180807_110157GFI	PLATINE	CEB, CEE, CED...	CCU_AEKR, CCU_AEKQ, CCU_AEKN ...	07/08/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 1 of 2	15059960_20253871_RGT20523557_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180807_110157GFI	PLATINE	CEB, CEE, CED...	CCU_AEKR, CCU_AEKQ, CCU_AEKN ...	07/08/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 2 of 2	15059903_RGT20697990_RGT20697990_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180807_110157GFI	PLATINE	CEB, CEE, CED...	CCU_AEKR, CCU_AEKQ, CCU_AEKN ...	07/08/2018	cmilani	kit Rapid run cbot interne PE index v2	TruSeq ® Rapid PE Cluster kit HS v2	15056108_RGT20865109_RGT20865109_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180925_110532FED	PLATINE	CEE, CCK	CCK_ABBQ, CCK_ABBR, CCK_ABBS ...	25/09/2018	cmilani	kit Rapid run cbot interne PE index v2	TruSeq ® Rapid PE Cluster kit HS v2	15056108_RGT20865028_RGT20865028_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180925_110532FED	PLATINE	CEE, CCK	CCK_ABBQ, CCK_ABBR, CCK_ABBS ...	25/09/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 1 of 2	15059960_20266143_RGT20740637_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180925_110532FED	PLATINE	CEE, CCK	CCK_ABBQ, CCK_ABBR, CCK_ABBS ...	25/09/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 2 of 2	15059903_RGT20976602_RGT20976602_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180911_104143AGF	FLUOR	CEB, CEE, CED...	CEB_NO, CEB_NP, CEB_NQ...	11/09/2018	cmilani	kit Rapid run cbot interne PE index v2	TruSeq ® Rapid PE Cluster kit HS v2	15056108_20270101_RGT20865138_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180911_104143AGF	FLUOR	CEB, CEE, CED...	CEB_NO, CEB_NP, CEB_NQ...	11/09/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 1 of 2	15059960_RGT20740625_RGT20740625_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180911_104143AGF	FLUOR	CEB, CEE, CED...	CEB_NO, CEB_NP, CEB_NQ...	11/09/2018	cmilani	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 2 of 2	15059903_20277212_RGT20976589_		
Depot Illumina	ILLUMINA-DEPOT-20180904_111132GCJ	FLUOR	CEB, CEE, CED...	CCU_AETZ, CCU_AELU, CCU_AELT...	04/09/2018	slebled	Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 1 of 2	15059960_20266143_RGT20740618_		

explication

BILAN > REPORTING RÉACTIFS

ILLUMINA-DEPOT-20180807_110157GFI Terminé

Feuille de route | Terminer

Expérience

Type d'expérience	Depot Illumina
Protocole *	HiSeq2500_fast_Illumina
Etat	Terminé
Statut	OK
Résolutions	Déroulement correct
schéma de manips	
Date réelle de dépôt *	07/08/2018
Activation NGS-RG *	☑

Instrument

Type d'instrument *	HISEQ2500
Instrument *	PLATINE
Mode run *	rapide
Piste contrôle *	Pas de piste contrôle (auto-calibrage)
Position *	A
Type lectures *	PE
Nb cycles Read1 *	251
Nb cycles Read Index1 *	12
Nb cycles Read Index2 *	0
Nb cycles Read2 *	251

Info

Date de création	07/08/201 11:01:57
Créée par	cmilani
Date de modification	08/08/201 10:40:55
Modifié par	cmilani

Container(s) en entrée(s)

Support container	Catégorie Support	Code Container	Projet(s)	Echantillon(s)	Etat	Issu du type d'expérience
HKNTLBCX2	flowcell-2	HKNTLBCX2_1	CEB, CEE, CED...	CCU_ABZD, CCU_ABZC, CEB_JM...	En stock	Preparation flowcell
HKNTLBCX2	flowcell-2	HKNTLBCX2_2	CEB, CEE, CED...	CCU_AEKR, CCU_AEKQ, CCU_AEGP...	En stock	Preparation flowcell

Reactifs


Nom du kit	Nom de la boite	Code boite (REF-LOT-CB supplémentaire(s))	Nom du reactif	Code du réactif (REF-LOT-CB supplémentaire(s))	Description
Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 1 of 2	15059960_20253871_RGT20523557_			
Kit Rapid run réactifs séquence 500 cycles v2	TruSeq SBS Kit v2 HS (500 cycles) box 2 of 2	15059903_RGT20697990_RGT20697990_			
kit Rapid run cbot interne PE index v2	TruSeq ® Rapid PE Cluster kit HS v2	15056108_RGT20865109_RGT20865109_			


Affiché dans REPORTING réactifs




MENU RÉCEPTION RÉACTIFS

RÉCEPTION RÉACTIFS

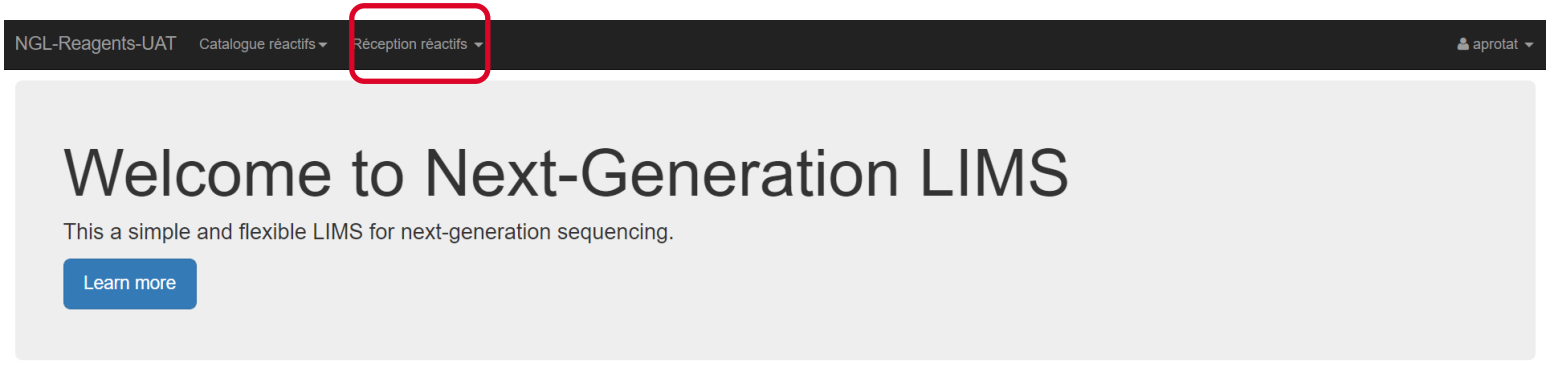


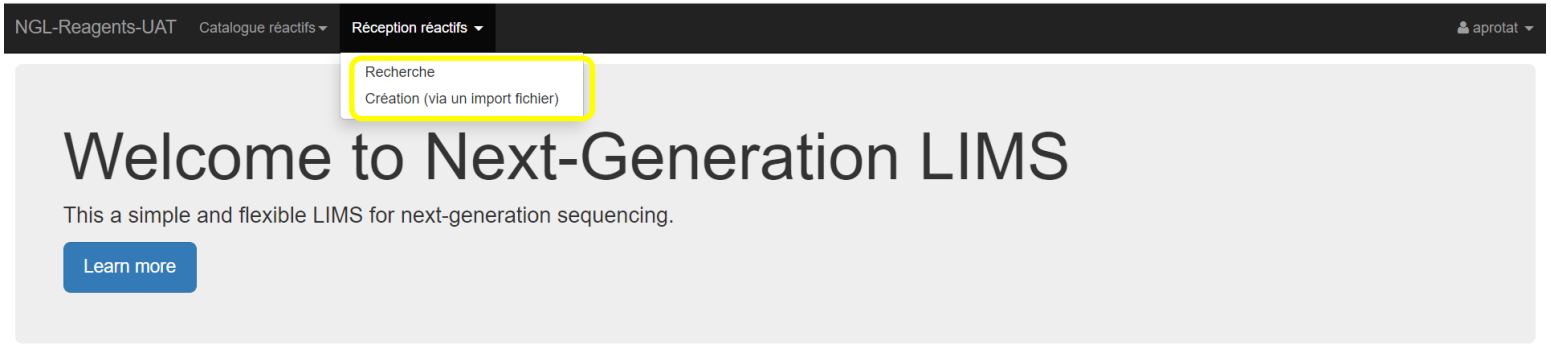


RÉCEPTION RÉACTIFS – IMPORT FICHIER

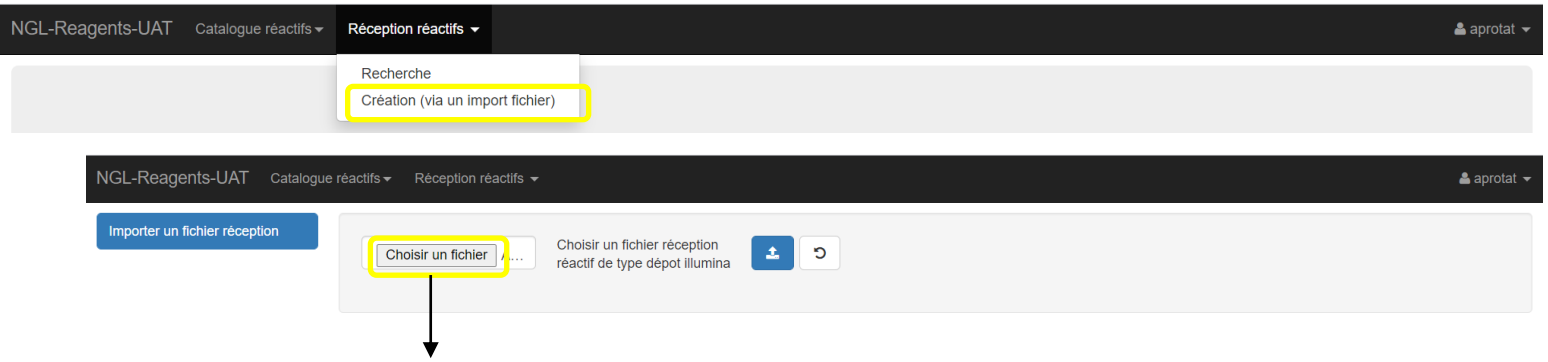


Colonnes obligatoires

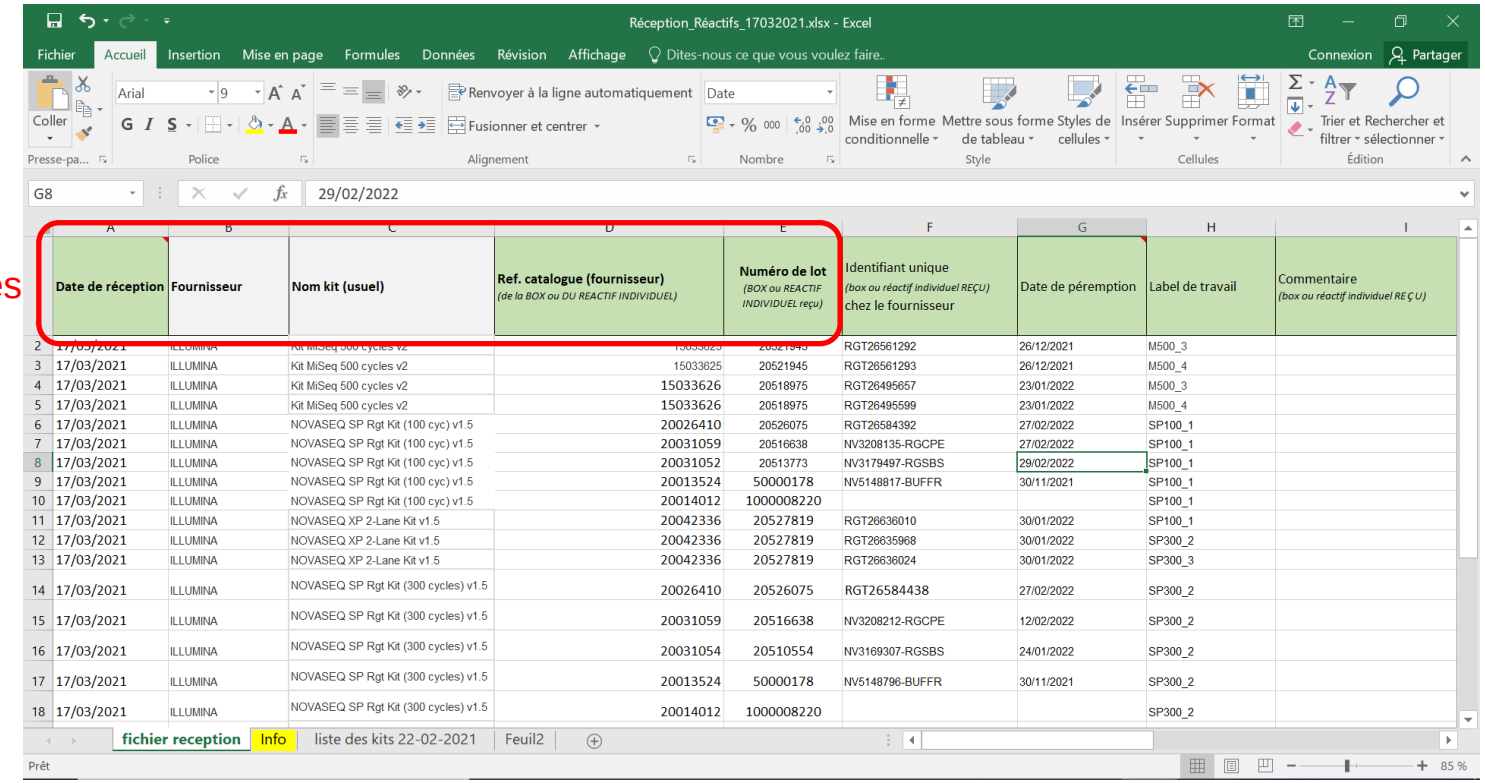

RÉCEPTION RÉACTIFS – IMPORT FICHIER

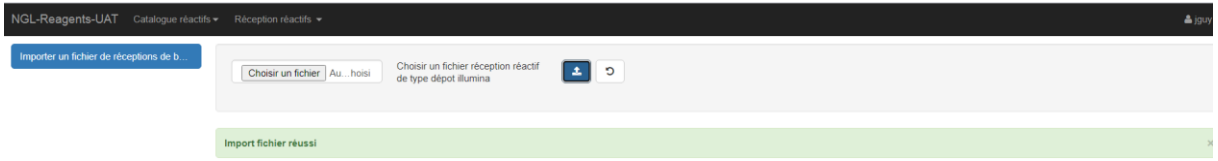

OU

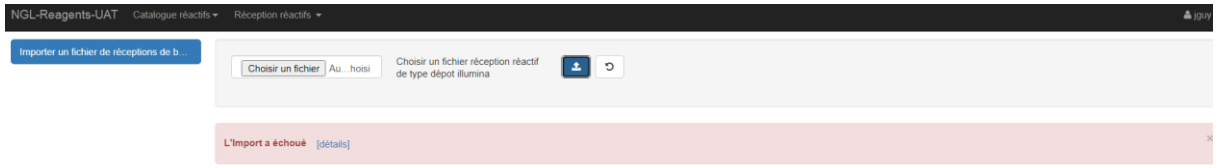

Au CNS on peut avoir une même ref fournisseur de boite déclarée dans plusieurs kits, dans le catalogue.


- Si erreur, fichier rejeté au complet.
- Contrôle des formats (date, string, number…).
- Contrôle des champs **obligatoires.**
- Contrôle sur la combinaison **Fournisseur – Nom kit (usuel) – Ref catalogue (fournisseur) du reagent reçu**
  - Erreur si l'orthographe diffère de celle mise dans catalogue :
    « No catalog found for name : Kit Miseq 600 cycles v3 and provider : illumina »
  - Si erreur nom kit usuel, rejet fichier :
    « *Error - row 2: No catalog found for name : MiSeq Reagent kit v3(600-cycles) and provider : ILLUMINA »*
  - Ref. catalogue (fournisseur) *(de la BOX ou DU REACTIF INDIVIDUEL)* **:**
    - Si erreur ref catalogue fournisseur *: Import reagent-reception: cannot find catalog for Reference 'XYZ', provider 'Illumina' and kitCatalog name 'RiboZero'*
    - Si erreur car ref du KIT (et pas de la boite ou du reactif) : *Import reagent-reception: cannot find catalog for Reference 'RZH1046', provider 'Illumina' and kitCatalog name 'RiboZero'*

RÉCEPTION RÉACTIFS – IMPORT FICHIER


Etats possibles (dans la version actuelle de NGL-Reagents > réception réactifs) :

- En cours (par défaut à la réception)
- Terminé

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS

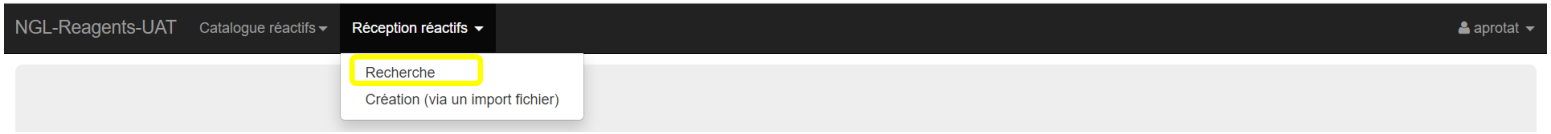


Recherche par : date de réception / création / péremption, Créé par,
Fournisseur, nom kit,
Num LOT, ref fournisseur, CB unique (fournisseur),
Label de travail…

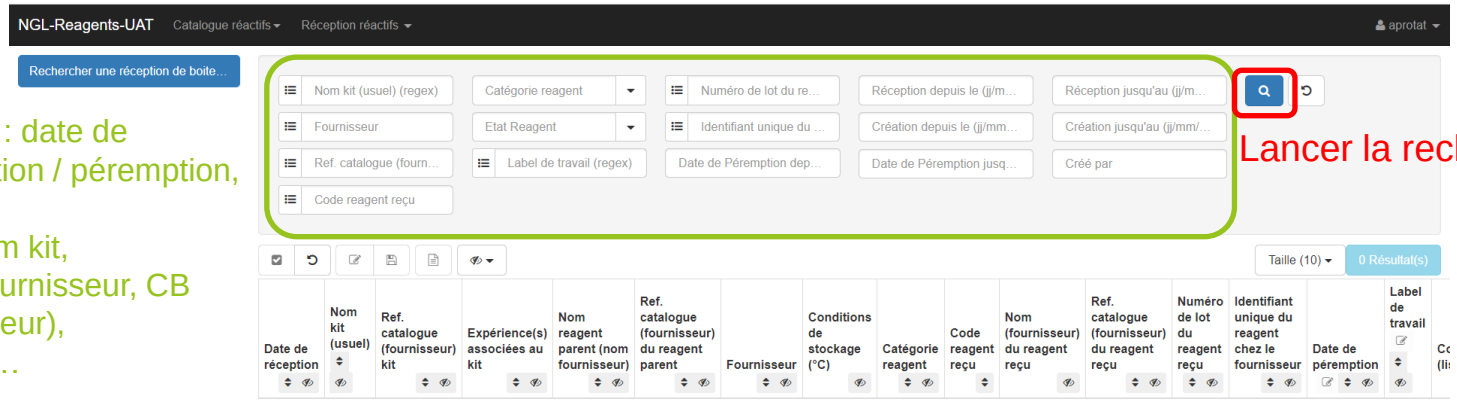

Lancer la recherche

Exemple de recherche sur code unique (NGL) du réactif dans notre base

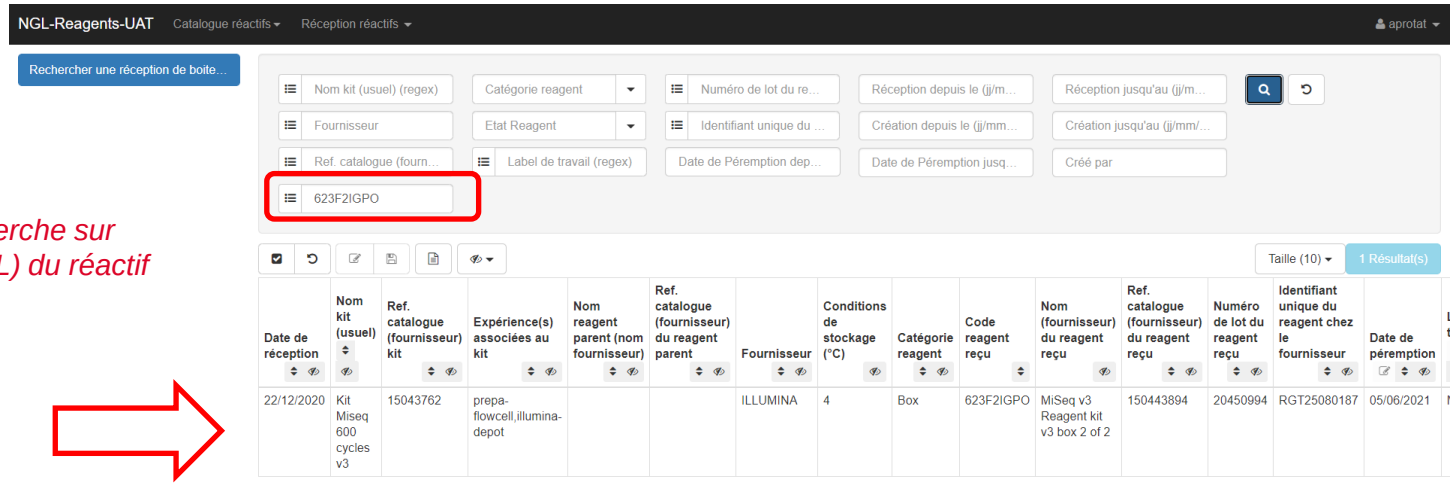

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS – DONNÉES AFFICHÉES

Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur
06/11/2020	Kit quantif qPCR	07960140001	qpcr-quantification			Roche	-20	Box	62IF40SF7	KAPA Library Quantification Kit - Illumina	7960140001	113468	
22/02/2021	Kit MiSeq 500 cycles v2	15033411	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	62MC1396F	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20508603	RGT26230699
22/03/2021	NOVASEQ S4 Rgt Kit (300 cyc) v1.5	20028312	illumina-depot,prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	63MF1CHHM	LIBRARY TUBE, 1 PACK	20014012	1000008220	
22/03/2021	NOVASEQ Xp 4-Lane Kit V1.5	20043131	prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	63MF1CHHV	NovaSeq™ Xp 4-lane Kit V1.5	20042337	20523270	RGT26570370

Infos du « niveau 2 » si on a importé un « niveau 3 »

Données saisies dans le fichier excel

Date de péremption	Label de travail	Commentaires (liste)	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Créé par	Date de création	Modifié par	Date de modification
04/02/2023	qpcr_5	aliquoté		Terminé			slebled	18/02/2021	bordelai	04/03/2021
20/12/2021	M500_1			Terminé			cmilani	22/02/2021	slebled	19/03/2021
	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		
26/01/2022	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS – DONNÉES AFFICHÉES

Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur
06/11/2020	Kit quantif qPCR	07960140001	qpcr-quantification			Roche	-20	Box	62IF40SF7	KAPA Library Quantification Kit - Illumina	7960140001	113468	
22/02/2021	Kit MiSeq 500 cycles v2	15033411	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	62MC1396F	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20508603	RGT26230699
22/03/2021	NOVASEQ S4 Rgt Kit (300 cyc) v1.5	20028312	illumina-depot,prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	63MF1CHHM	LIBRARY TUBE, 1 PACK	20014012	1000008220	
22/03/2021	NOVASEQ Xp 4-Lane Kit V1.5	20043131	prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	63MF1CHHV	NovaSeq™ Xp 4-lane Kit V1.5	20042337	20523270	RGT26570370

Infos du « niveau 2 » si on a importé un « niveau 3 »

Données saisies dans le fichier excel

Données récupérées du catalogue et affichées dynamiquement par NGL (si mise à jour catalogue à postériori)

Date de péremption	Label de travail	Commentaires (liste)	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Créé par	Date de création	Modifié par	Date de modification
04/02/2023	qpcr_5	aliquoté		Terminé			slebled	18/02/2021	bordelai	04/03/2021
20/12/2021	M500_1			Terminé			cmilani	22/02/2021	slebled	19/03/2021
	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		
26/01/2022	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS – DONNÉES AFFICHÉES

Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur
06/11/2020	Kit quantif qPCR	07960140001	qpcr-quantification			Roche	-20	Box	62IF40SF7	KAPA Library Quantification Kit - Illumina	7960140001	113468	
22/02/2021	Kit MiSeq 500 cycles v2	15033411	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	62MC1396F	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20508603	RGT26230699
22/03/2021	NOVASEQ S4 Rgt Kit (300 cyc) v1.5	20028312	illumina-depot,prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	63MF1CHHM	LIBRARY TUBE, 1 PACK	20014012	1000008220	
22/03/2021	NOVASEQ Xp 4-Lane Kit V1.5	20043131	prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	63MF1CHHV	NovaSeq™ Xp 4-lane Kit V1.5	20042337	20523270	RGT26570370

Infos du « niveau 2 » si on a importé un « niveau 3 »

Données saisies dans le fichier excel

Données récupérées du catalogue et affichées dynamiquement par NGL (si mise à jour catalogue à postériori)

Données récupérées du catalogue *(ou utilisées pour contrôle)* et bloquées si mise à jour catalogue à postériori

Date de péremption	Label de travail	Commentaires (liste)	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Créé par	Date de création	Modifié par	Date de modification
04/02/2023	qpcr_5	aliquoté		Terminé			slebled	18/02/2021	bordelai	04/03/2021
20/12/2021	M500_1			Terminé			cmilani	22/02/2021	slebled	19/03/2021
	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		
26/01/2022	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS – DONNÉES AFFICHÉES

Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur
06/11/2020	Kit quantif qPCR	07960140001	qpcr-quantification			Roche	-20	Box	62IF40SF7	KAPA Library Quantification Kit - Illumina	7960140001	113468	
22/02/2021	Kit MiSeq 500 cycles v2	15033411	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	62MC1396F	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20508603	RGT26230699
22/03/2021	NOVASEQ S4 Rgt Kit (300 cyc) v1.5	20028312	illumina-depot,prepa-fc-ordered			ILLUMINA	20	Box	63MF1CHHM	LIBRARY TUBE, 1 PACK	20014012	1000008220	
22/03/2021	NOVASEQ Xp 4-Lane Kit V1.5	20043131	prepa-fc-ordered			ILLUMINA	-20	Box	63MF1CHHV	NovaSeq™ Xp 4-lane Kit V1.5	20042337	20523270	RGT26570370

Infos du « niveau 2 » si on a importé un « niveau 3 »

Données saisies dans le fichier excel

Données récupérées du catalogue et affichées dynamiquement par NGL (si mise à jour catalogue à postériori)


Données récupérées du catalogue *(ou utilisées pour contrôle)* et bloquées si mise à jour catalogue à postériori

Infos supplémentaires affichées

Date de péremption	Label de travail	Commentaires (liste)	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Créé par	Trace information: Date de création	Trace information: Modifié par	Trace information: Date de modification
04/02/2023	qpcr_5	aliquoté		Terminé			slebled	18/02/2021	bordelai	04/03/2021
20/12/2021	M500_1			Terminé			cmilani	22/02/2021	slebled	19/03/2021
	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		
26/01/2022	S4 300_4			En cours			cmilani	22/03/2021		

RECHERCHER LES RÉACTIFS REÇUS


Données remontées des catalogues:

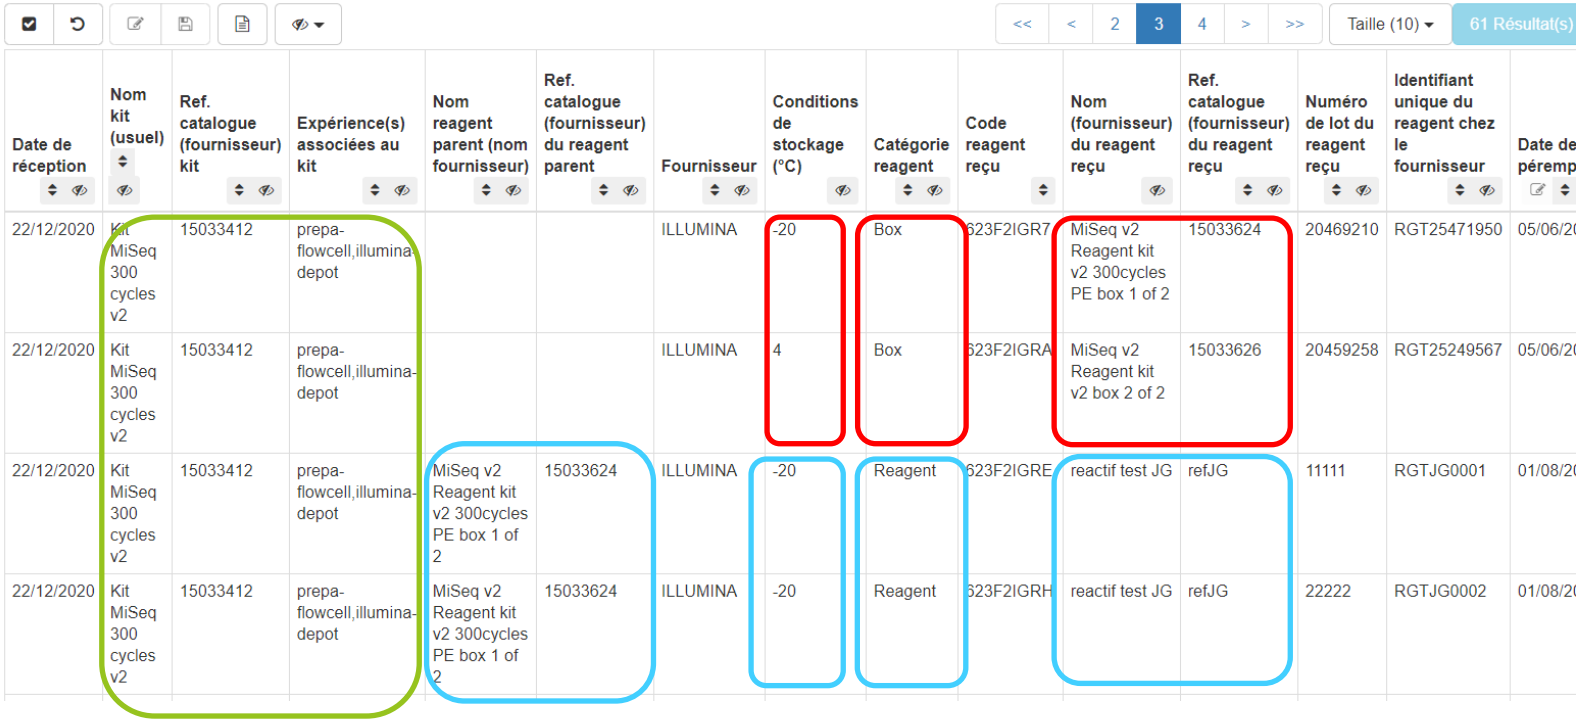


Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur	Date de péremp
22/12/2020	Kit MiSeq 300 cycles v2	15033412	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	-20	Box	623F2IGR7	MiSeq v2 Reagent kit v2 300cycles PE box 1 of 2	15033624	20469210	RGT25471950	05/06/2(
22/12/2020	Kit MiSeq 300 cycles v2	15033412	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	623F2IGRA	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20459258	RGT25249567	05/06/2(
22/12/2020	Kit MiSeq 300 cycles v2	15033412	prepa-flowcell,illumina-depot	MiSeq v2 Reagent kit v2 300cycles PE box 1 of 2	15033624	ILLUMINA	-20	Reagent	623F2IGRE	reactif test JG	refJG	11111	RGTJG0001	01/08/2(
22/12/2020	Kit MiSeq 300 cycles v2	15033412	prepa-flowcell,illumina-depot	MiSeq v2 Reagent kit v2 300cycles PE box 1 of 2	15033624	ILLUMINA	-20	Reagent	623F2IGRH	reactif test JG	refJG	22222	RGTJG0002	01/08/2(

Code couleur indépendant de la slide précédente

RECHERCHE DES RÉACTIFS REÇUS - CHAMPS ÉDITABLES

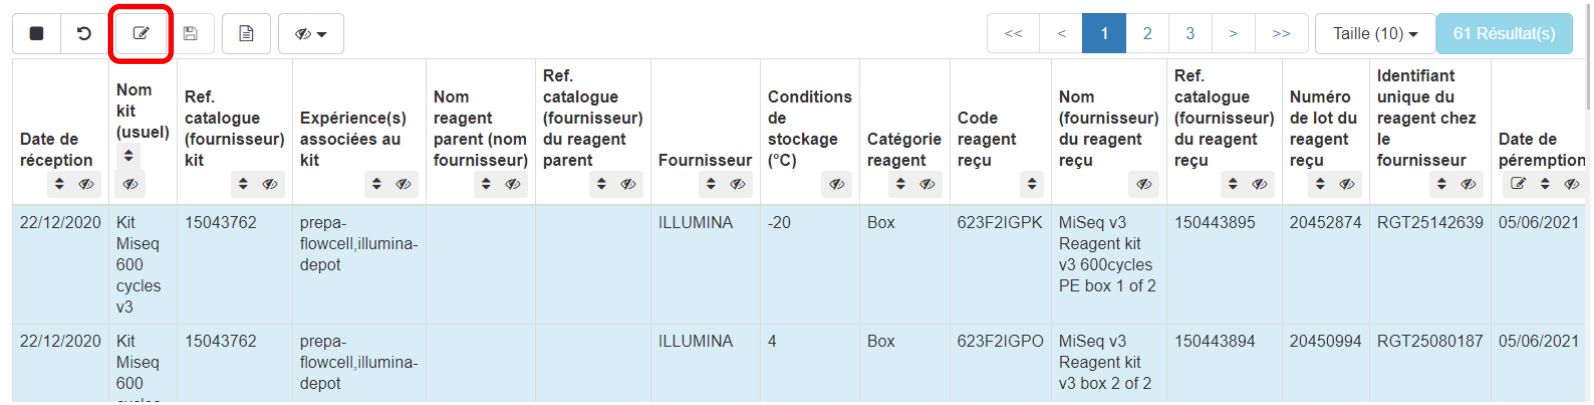


Date de réception	Nom kit (usuel)	Ref. catalogue (fournisseur) kit	Expérience(s) associées au kit	Nom reagent parent (nom fournisseur)	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent parent	Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur	Date de péremption
22/12/2020	Kit Miseq 600 cycles v3	15043762	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	-20	Box	623F2IGPK	MiSeq v3 Reagent kit v3 600cycles PE box 1 of 2	150443895	20452874	RGT25142639	05/06/2021
22/12/2020	Kit Miseq 600	15043762	prepa-flowcell,illumina-depot			ILLUMINA	4	Box	623F2IGPO	MiSeq v3 Reagent kit v3 box 2 of 2	150443894	20450994	RGT25080187	05/06/2021

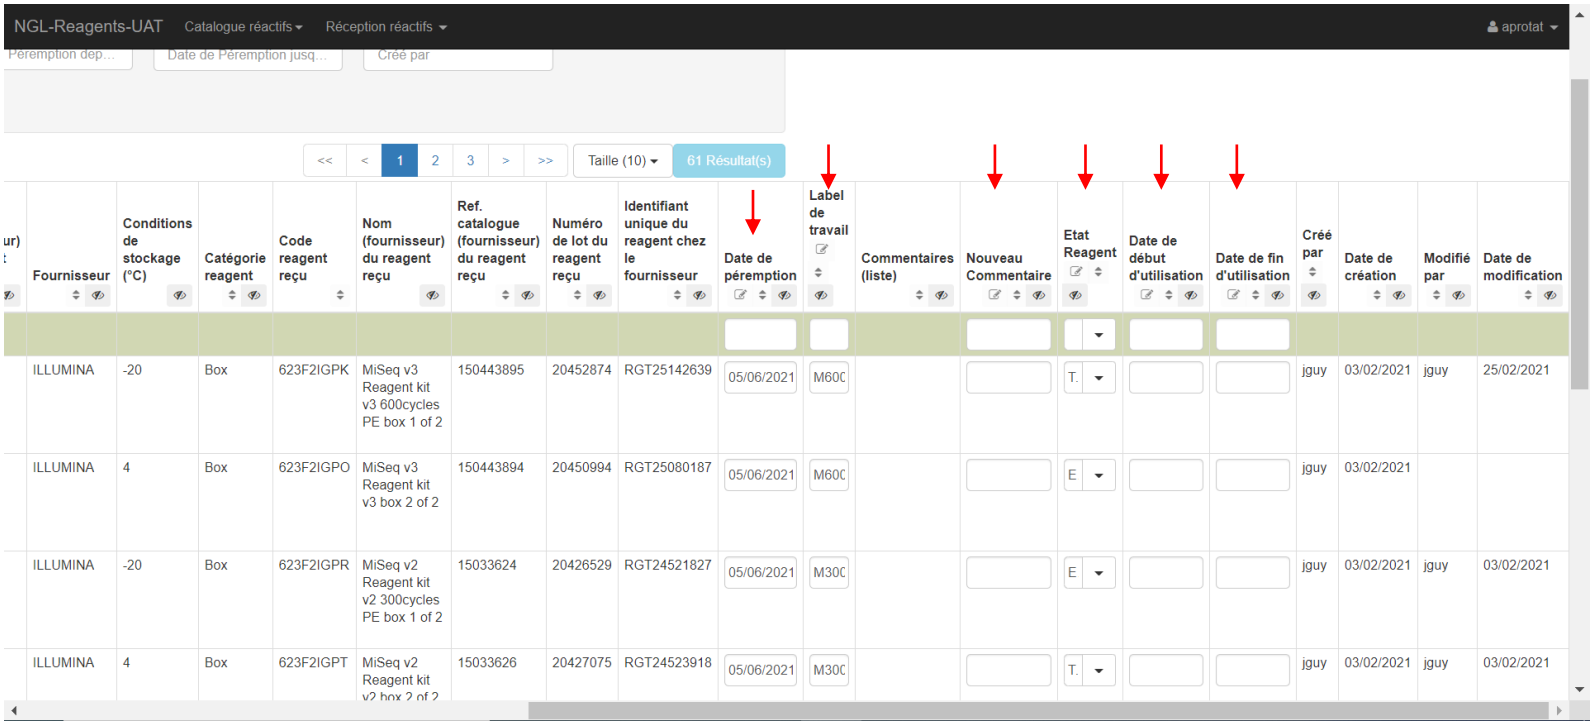

NGL-Reagents-UAT — Catalogue réactifs — Réception réactifs — aprotat

Fournisseur	Conditions de stockage (°C)	Catégorie reagent	Code reagent reçu	Nom (fournisseur) du reagent reçu	Ref. catalogue (fournisseur) du reagent reçu	Numéro de lot du reagent reçu	Identifiant unique du reagent chez le fournisseur	Date de péremption	Label de travail	Commentaires (liste)	Nouveau Commentaire	Etat Reagent	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Créé par	Date de création	Modifié par	Date de modification
ILLUMINA	-20	Box	623F2IGPK	MiSeq v3 Reagent kit v3 600cycles PE box 1 of 2	150443895	20452874	RGT25142639	05/06/2021	M60C			T.			jguy	03/02/2021	jguy	25/02/2021
ILLUMINA	4	Box	623F2IGPO	MiSeq v3 Reagent kit v3 box 2 of 2	150443894	20450994	RGT25080187	05/06/2021	M60C			E			jguy	03/02/2021		
ILLUMINA	-20	Box	623F2IGPR	MiSeq v2 Reagent kit v2 300cycles PE box 1 of 2	15033624	20426529	RGT24521827	05/06/2021	M30C			E			jguy	03/02/2021	jguy	03/02/2021
ILLUMINA	4	Box	623F2IGPT	MiSeq v2 Reagent kit v2 box 2 of 2	15033626	20427075	RGT24523918	05/06/2021	M30C			T.			jguy	03/02/2021	jguy	03/02/2021


RECHERCHE DES RÉACTIFS REÇUS – EXPORT CSV

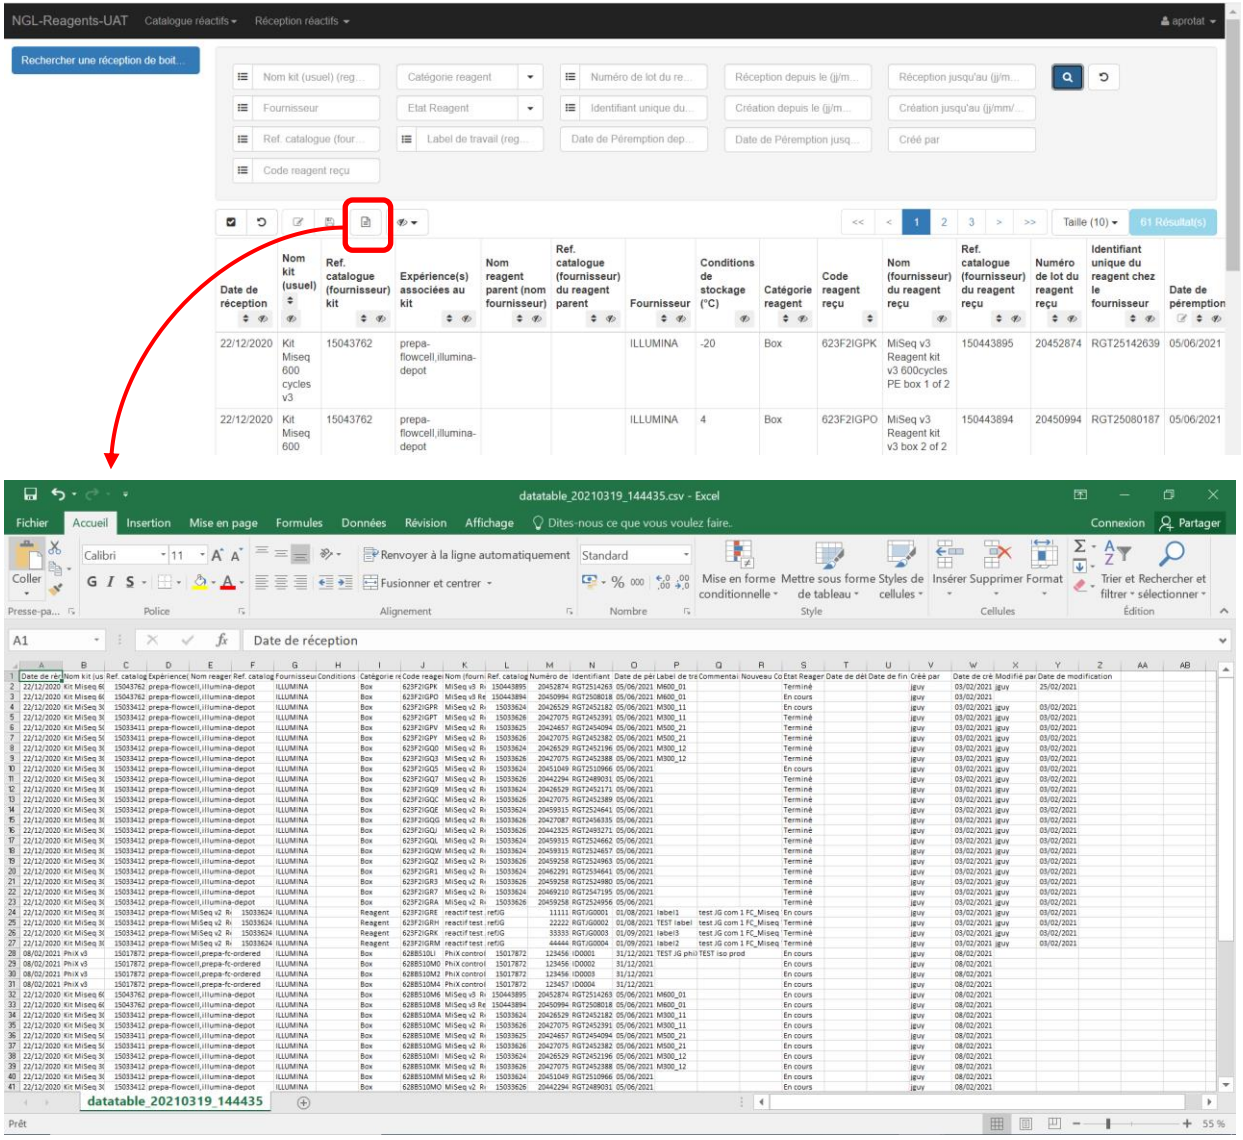



UTILISATION DES RÉACTIFS DANS LES EXPÉRIENCES

UTILISATION DES RÉACTIFS REÇUS DANS LES EXPÉRIENCES

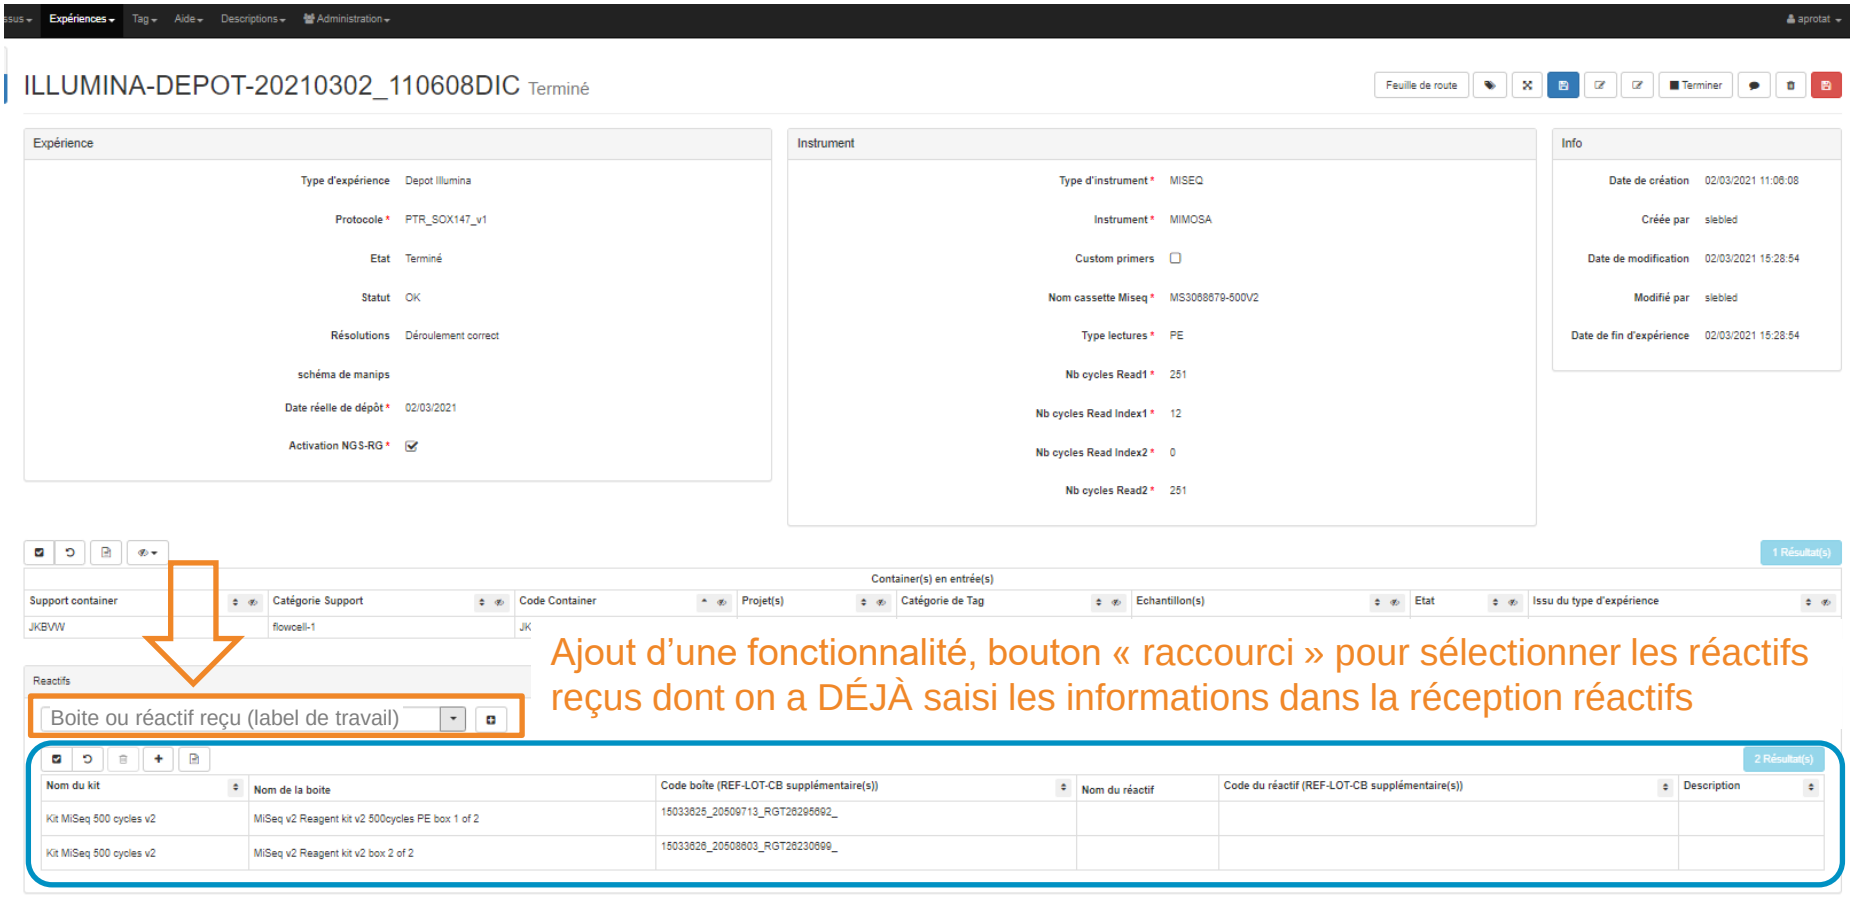



Ajout d'une fonctionnalité, bouton « raccourci » pour sélectionner les réactifs reçus dont on a DÉJÀ saisi les informations dans la réception réactifs

VUE HABITUELLE (mode « 1 »)

Seuls les réactifs à l'état « En cours » ET qui possède un label de travail apparaissent dans le menu déroulant


UTILISATION DES RÉACTIFS REÇUS DANS LES EXPÉRIENCES

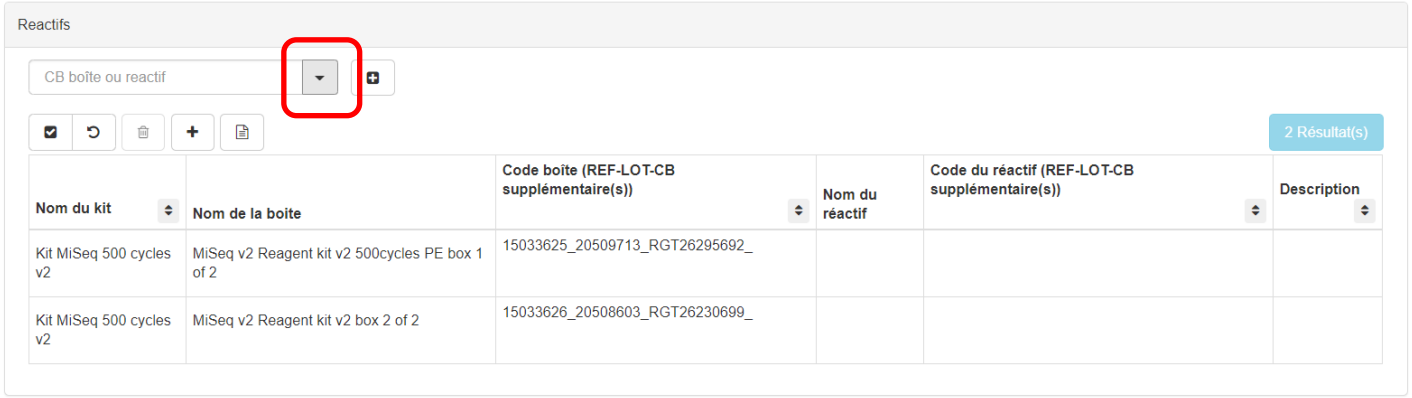

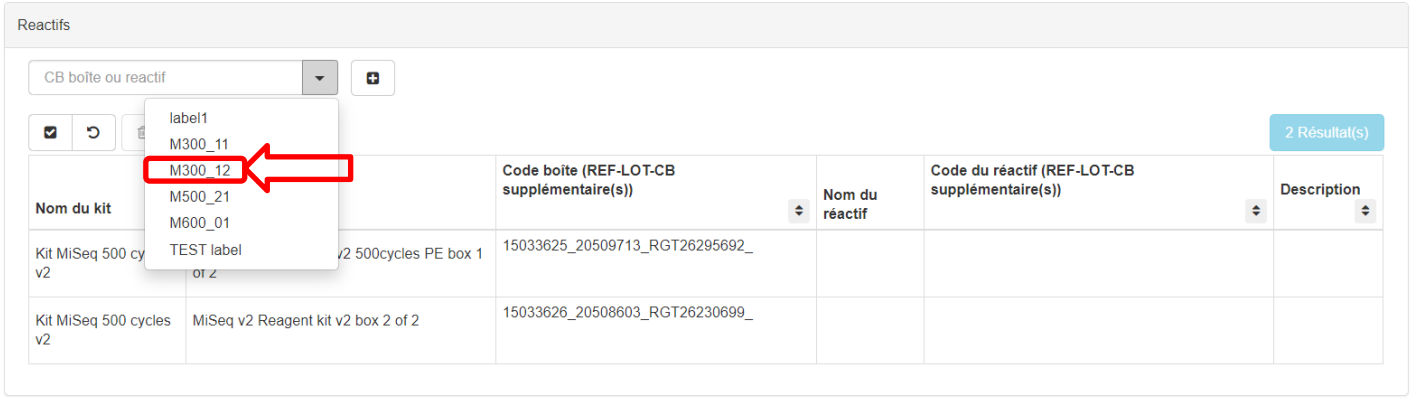

Si 1 label de travail correspond à plusieurs réactifs reçus, l'ensemble de ces réactifs sera injecté dans le tableau

UTILISATION DES RÉACTIFS REÇUS DANS LES EXPÉRIENCES

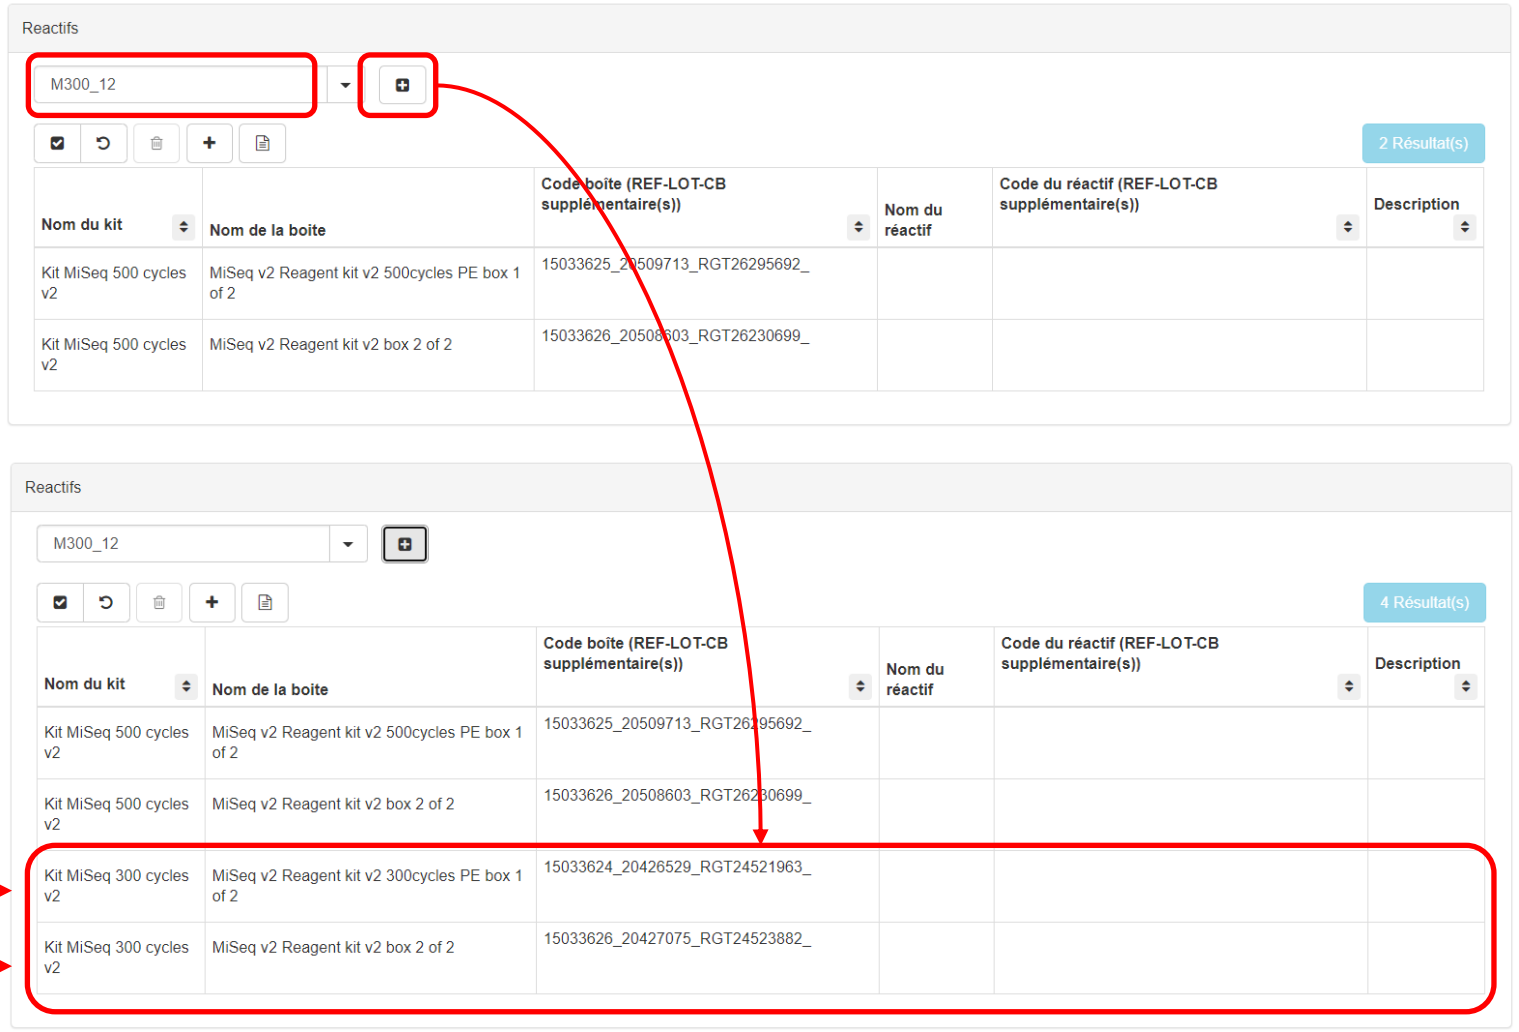

Avantage : gain de temps pour la saisie

Le mode 1 continue de fonctionner donc on peut compléter à la main le niveau « 3 » par exemple.

Avantage : le reporting (filtre de recherche par CB réactif ou reporting général) continue de fonctionner à l'identique.

DÉVELOPPEMENTS À VENIR

Fait dans MEP Reagents 3.0.1 juillet 2021

- Avoir **l'historique des états** sur les réactifs.
- États supplémentaires pour les réactifs *(« déclaré ou reçu », « abandonné »…)*
- Développer l'interface de **création individuelle** de réception réactifs (notamment pour les FC nanopore) et gérer les ***types spécifiques*** via la description.

Non prévu pour le moment :

- Calcul automatique par NGL d'une date de début d'utilisation *(quand utilisé la 1ère fois dans une expérience)*
- Changement automatique d'état quand le réactif est « Terminé » *(a été utilisé autant que le nb d'utilisations déclaré dans le catalogue) (présence d'une colonne Nb utilisations restantes ?)*
- Calcul automatique par NGL de la date de fin d'utilisation *(passage à l'état terminé par exemple)*

ANNEXES

illumina®

INTERNATIONAL PACK SLIP

PACK SLIP NO	DATE	PO NO / Customer PO NO	ORDER DATE	ORDER NUMBER	CUSTOMER NO
1001269175	22-Jan-21	4000903573 - P3240	11-Jan-21	1978629	4000005516

EXPORTER
Illumina Cambridge Ltd.
Freddy van Riemsdijkweg 15
Eindhoven Noord-Brabant
Netherlands 5657 EE

SHIP FROM
Illumina Warehouse & Logistics NL
15 Freddy van Riemsdijkweg
Eindhoven Noord-Brabant
Netherlands 5657 EE

WAYBILL / TRACKING NO
1Z2E032A0494384597

FORWARDER/CARRIER
UPS Nederland BV

MODE OF TRANSPORT
Air

SPECIAL INSTRUCTIONS

SHIP TO
CEA - DRF - IBFJ
Genoscope
31 boulevard des Coquibus
Service Reception du site d'Evry
Evry Essonne
France 91000

CONTACT NAME
Peggy Perroud

CONTACT PHONE
0160872568

SOLD TO
CEA Genoscope
2 rue Gaston Cremieux
Bat G1
Evry Essonne
France 91057

NOTES/REMARKS
Tender 5200001976

CONTENTS

LINE NO	PART NO/ CATALOG	PART DESCRIPTION	BATCH/SERIAL NO	EXPIRATION DT.	QTY	UOM	PACKAGE NO	STORAGE CONDITION
10	20028401/	NVSEQ 6000 SP Rgt Kit v1.5 (100cyc)			1	EA		
20	20031059	NOVASEQ™ 6000 SP CLUSTER CART,V1.5	20504352	14-DEC-2021	1	EA	1	-15C to -25C
30	20014012	LIBRARY TUBE, 1 PACK	1000008040	28-JUL-2023	1	EA	3	15C to 30C
40	20031052	NOVASEQ™ 6000 SP/S1/S2 SBS CART100C, V1.5	20504725	15-DEC-2021	1	EA	1	-15C to -25C
50	20013524	NOVASEQ 6000 SP/S1/S2 BUFFER CART	50000169	06-NOV-2021	1	EA	3	15C to 30C

RÉCEPTION RÉACTIFS – IMPORT FICHIER

Etats possibles (dans la version actuelle de NGL-Reagents > réception réactifs) :

- En cours (par défaut à la réception)
- Terminé

En (V2) : ajout de 2 états :
- Déclaré (deviendra l'état par défaut à la réception)
- Abandonné

Définitions :

- "Déclaré" = reçu, réceptionné, mais pas encore utilisé
- "En cours" = en cours d'utilisation
- "Terminé" = ne peut plus être utilisé dans les expériences (utilisé jusqu'à son nombre max d'utilisations, ou…)
- "Abandonné" = à ne pas utiliser ; problème dès la réception (arrivé endommagé, vide, ...)
  - Quid d'un réactif arrêté après avoir démarré son utilisation (info fournisseur d'un lot défectueux par exemple) ? => Terminé ou abandonné ?
  - Quid d'un réactif pas utilisé à temps et arrivé à date de péremption ?

Avoir un **historique d'état** pour la traçabilité.