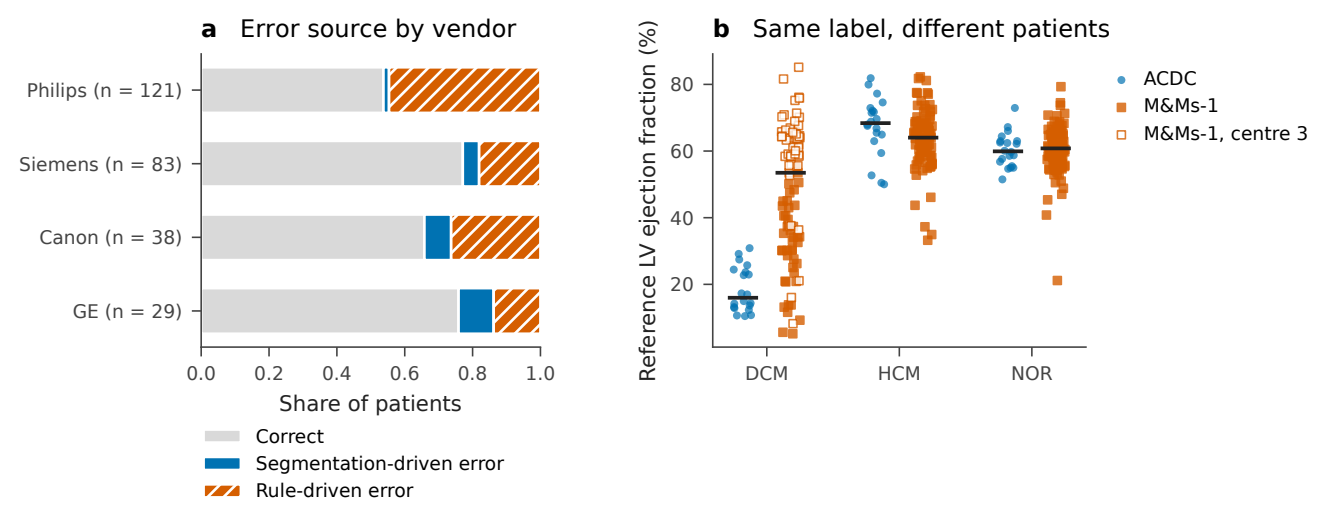
a
Error source by vendor
Philips (n = 121)
Siemens (n = 83)
Canon (n = 38)
GE (n = 29)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Share of patients
Correct
Segmentation-driven error
Rule-driven error
b
Same label, different patients
Reference LV ejection fraction (%)
20
40
60
80
DCM
HCM
NOR
ACDC
M&Ms-1
M&Ms-1, centre 3