

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-6

Beam-Angle / Fracture-Orientation Dependence

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-6 • July 14, 2026

บทคัดย่อ

CL-6 เป็นการทดสอบเชิงสาเหตุเชิงเรขาคณิต — ทดสอบว่าสัญญาณรอยแตกขึ้นกับมุมระหว่างลำแสง กับระนาบร่องหรือไม่ (คาดว่าแรงขึ้นเมื่อลำแสงเลียบระนาบร่าง/tangential เพราะเส้นทางอากาศยาวขึ้น) โดยกวาดมุมลำแสง $\theta \in [-30^\circ, +30^\circ]$ ที่รอยแตก 0.54 มม. (10 seeds/มุม) พร้อมคำนวณ การจัดตำแหน่งวัตถุต่อมุมเพื่อตรึงร่องไว้กลางลำแสง ผลสรุป: สัญญาณตรวจพบได้ทุกมุม (เครื่องหมายถูก, 5/6 มีนัยสำคัญ) = ทนต่อมุมฉาย; และ $|\Delta_{\text{SPR}}|$ โตขึ้น monotonic ตามการเอียง ($3.4 \rightarrow 6.8 \times 10^{-5}$ เมื่อ $|\theta|$ ไป 30°) ตรงทิศที่ฟิสิกส์ทำนาย — แต่ยังไม่ถึงนัยสำคัญ ระดับ per-seed ($p = 0.19$ ที่ $N = 10$) และมุมสุดขอบ $\theta = -30^\circ$ ถูกตัดออกเพราะ artifact เชิงเรขาคณิต สรุป: สนับสนุนเชิงบ่งชี้ (suggestive) — แนวโน้มตรงตามทำนาย แต่ต้องเพิ่ม seed/ช่วงมุมเพื่อยืนยัน

1. สมมติฐานและวิธี

สมมติฐาน CL-6: สัญญาณ $\propto$ ความยาวเส้นทางอากาศที่ฉายผ่านร่อง = ฟังก์ชันของมุมลำแสง—ระนาบร่อง สูงสุดเมื่อลำแสงเลียบระนาบ (tangential) — ตรงกับหลักคลินิกที่รอยแตกเห็นชัดเมื่อเอียงเลียบระนาบ

การจัดตำแหน่ง (สำคัญ): เมื่อเอียงลำแสง ร่องจะเลื่อนออกจากแกน จึงคำนวณจุดร่อง $q = (21.5, 22.3, -62.3)$ มม. (bbox-centered) แล้วตั้ง $\text{src_x}/\text{src_z}$ ต่อมุม + $\text{obj_dx}/\text{obj_dy} = -(R_{\text{beam}}q)_{xy}$ เพื่อ ตรึงร่องไว้กลางลำแสง (ROI กลางภาพใช้ได้ทุกมุม)

การกวาด: $\theta \in \{0, \pm 10, \pm 20, \pm 30\}^\circ$; 0.54 มม., n_seeds=10, field 40 มม.

2. ผลการวิเคราะห์

θ	$\Delta_{\text{SPR}} \text{ (ROI)}$	$ t $	p
-30°	$+21 \times 10^{-5}$ (artifact)	1.75	0.11
-20°	-7.1×10^{-5}	3.08	0.013
-10°	-3.6×10^{-5}	2.43	0.038
0°	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015
$+10^\circ$	-6.4×10^{-5}	2.04	0.071
$+20^\circ$	-4.7×10^{-5}	3.11	0.013
$+30^\circ$	-6.8×10^{-5}	3.77	0.004

2.1 ตรวจพบได้ทุกมุม (robust ต่อมุมฉาย)

ยกเว้น $\theta = -30^\circ$ (ดู §3.3) ทุกมุมให้ $\Delta_{\text{SPR}} < 0$ (เครื่องหมายถูก) และ 5/6 มีนัยสำคัญ — การตรวจพบไม่เปราะต่อมุมฉาย เป็นผลเชิงประจักษ์ที่ดี (ไม่ต้องจัดมุมสมบูรณ์แบบ)

2.2 สัญญาณแรงขึ้นตามการเอียง (ตรงทิศที่ทำนาย)

$|\Delta_{\text{SPR}}|$ เปลี่ยนตาม $|\theta|$ เพิ่มขึ้น monotonic: $3.4 \rightarrow 5.0 \rightarrow 5.9 \rightarrow 6.8 \times 10^{-5}$ ($|\theta| = 0 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$) — ต่ำสุดที่ $\theta = 0$ (ตั้งฉากที่สุด) และแรงขึ้นเมื่อเอียงเข้าหา tangential ตรงตามแบบจำลองเส้นทางอากาศ

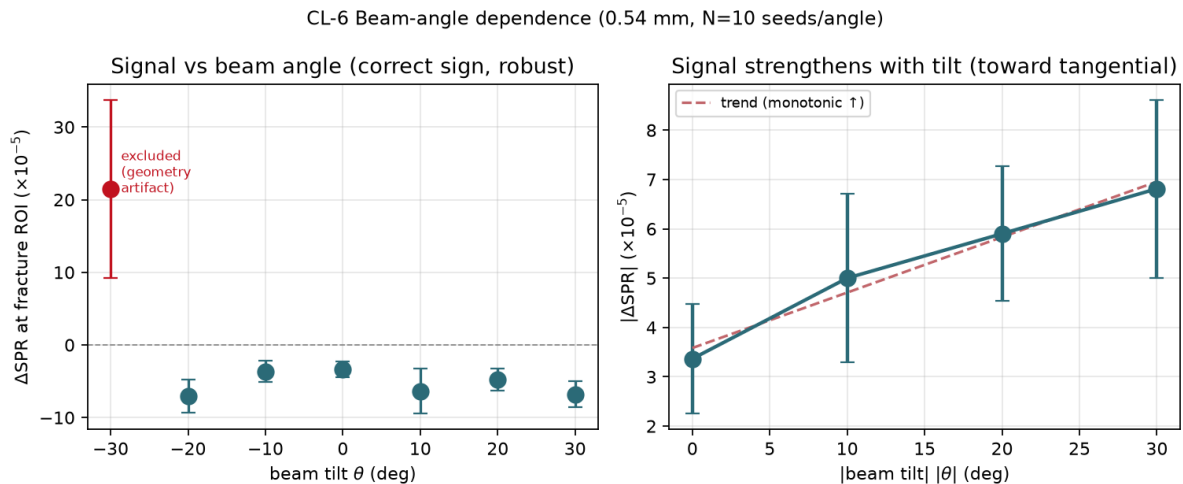


Figure 1: ซ้าย: Δ_{SPR} เทียบมุม (เครื่องหมายลบทุกมุมที่ใช้ได้; -30° แดง = ตัดออก). ขวา: $|\Delta_{\text{SPR}}|$ เทียบ $|\theta|$ (binned) เพิ่มขึ้น monotonic ตามการเอียง

2.3 ข้อจำกัด: $\theta = -30^\circ$ artifact + noise ที่ $N = 10$

$\theta = -30^\circ$ ให้ค่าเป็นบวกและแกว่งรุนแรง (per-seed: +71, +62, +56, ...) เพราะการเอียงนี้ต้องเลื่อนวัตถุ มาก (obj_dx = -49.8 มม.) ดันร่องออกนอกบริบทกระดูกที่สะอาด — เป็นขีดจำกัดเชิงเรขาคณิตของวิธีที่มุมใหญ่ จึงตัดออก. นอกจากนี้ที่ $N = 10$ ความผันผวน per-seed สูง ทำให้ trend $|\theta|$ (แม้ binned means เรียง monotonic) ยังไม่ถึงนัยสำคัญระดับ per-seed (linear fit $p = 0.19$)

3. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-6

กลไกเชิงเรขาคณิต: ☒ สนับสนุนเชิงบ่งชี้ (suggestive) + ยังไม่ conclusive

สองข้อสังเกตทวนสมมติฐาน: (1) สัญญาณตรวจพบได้ทุกมุมด้วยเครื่องหมายที่ถูกต้อง (robust); (2) $|\Delta_{\text{SPR}}|$ โตขึ้น monotonic เมื่อเอียงเข้าหา tangential (3.4 $\rightarrow$ 6.8) ตรงทิศที่แบบจำลอง เส้นทางอากาศทำนาย. อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้ยังไม่ถึงนัยสำคัญที่ $N = 10$ ($p = 0.19$) และมุมสุดขอบ (-30°) ถูกจำกัดด้วยเรขาคณิต — จึงยังไม่ conclusive

4. การตีความและงานถัดไป

- **เชิงบวก:** สัญญาณทนต่อมุมฉาย + แนวโน้ม “เอียงมาก → แรงขึ้น” ตรงกับหลักคลินิก (รอยแตกเห็นชัดเมื่อเอียงเลียบระนาบ) — เป็นลายเซ็นเชิงสาเหตุที่ควรค่าแก่การยืนยัน
- **ข้อจำกัด:** $\pm 30^\circ$ เป็นการรบกวนเล็ก (ยังไม่ถึง tangential เต็มที่); และวิธีเลื่อนวัตถุ แตกที่มุมใหญ่ (`obj_dx` มากเกิน)
- **งานถัดไป (ออกแบบใหม่):** (ก) เพิ่ม `n_seeds=20--30` ต่อมุมเพื่อยกแนวโน้มให้ถึงนัยสำคัญ; (ข) ใช้ช่วงมุมกว้างขึ้น (จนถึง tangential) ด้วยเรขาคณิตที่คงความถูกต้อง (เช่น หมุนวัตถุรอบจุดร่อง โดยตรงแทนการเลื่อนในระนาบ) เพื่อค้นหา “ยอด” ที่ทำนายไว้