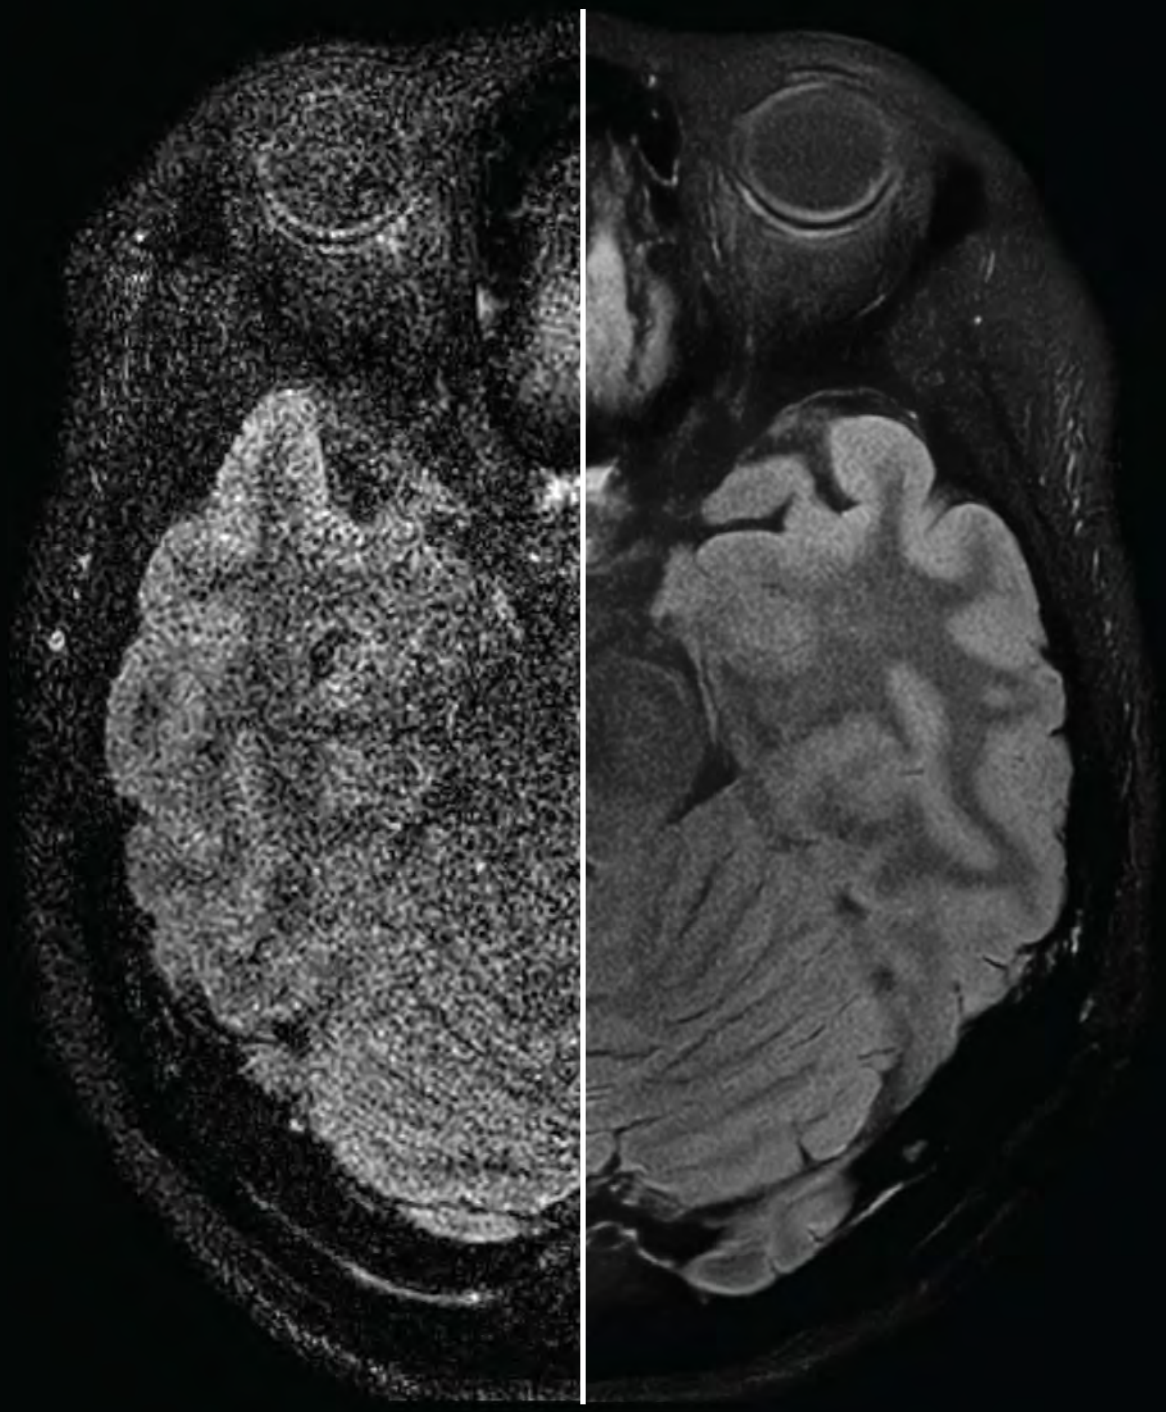
SwiftMR™

Solução de aprimoramento de RM com tecnologia IA

Imagem rápida, qualidade excepcional



AIRS MEDICAL

Apresentamos o SwiftMR™

Software de aprimoramento de RM de última geração

O SwiftMR™ é uma solução transformadora que reduz os tempos de varredura de RM, aumentando o conforto do paciente sem sacrificar a qualidade da imagem. Desenvolvido com um modelo avançado de aprendizagem profunda, o SwiftMR™ foi projetado para se integrar perfeitamente aos sistemas de RM existentes.

Maior eficiência

Reduz os tempos de varredura de RM em até 50%*, aumentando significativamente a rotatividade de pacientes.

Qualidade de imagem excepcional

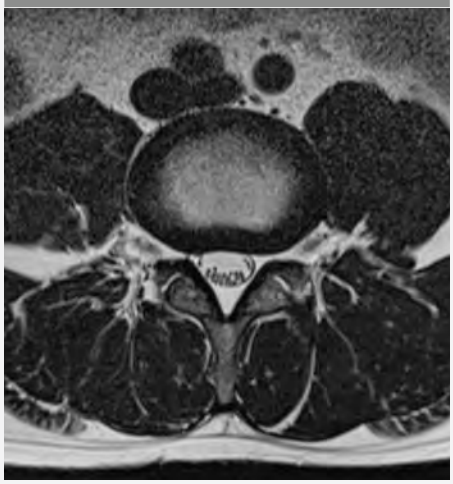
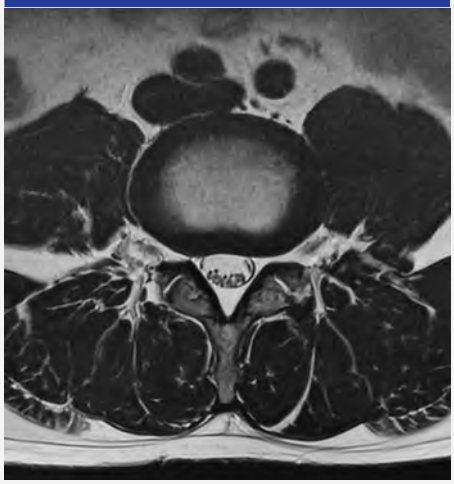
Melhora a qualidade das imagens, tornando as varreduras de sistemas herdados ainda mais claras e detalhadas.

Cobertura abrangente

A liberação do ANVISA, juntamente com as certificações FDA-510(K) e CE Mark, garante a compatibilidade com todas as partes do corpo, sequências e fornecedores.

Como o SwiftMR™ funciona

O SwiftMR™ proporciona uma economia significativa de tempo por meio do ajuste de protocolos de RM e da aceleração de varreduras. Ele emprega um modelo de aprendizagem profunda para aprimorar essas imagens, transformando-as em imagens nítidas e de alta qualidade.

Varredura convencional	Varreduras mais rápidas	Varreduras mais rápidas + SwiftMR™
		
30 min	15 min	**15 min**

Brazil	USA	Europe	KOREA
ANVISA-certified	**FDA 510(k)-cleared** Class II	CE 2460 Class IIa, MDR	**KOREA MFDS approved** Class 1

Sistema de gerenciamento de qualidade	Segurança das informações
ISO 13485:2016 / EN ISO 13485:2016 certified **GMP, MDSAP** certified	**HIPAA**-compliant, **GDPR**-compliant **ISO 27001, 27017, 27018** certified

* Somente para fins de investigação

O SwiftMR™ oferece resultados reais:

Aumente sua produtividade e eficiência

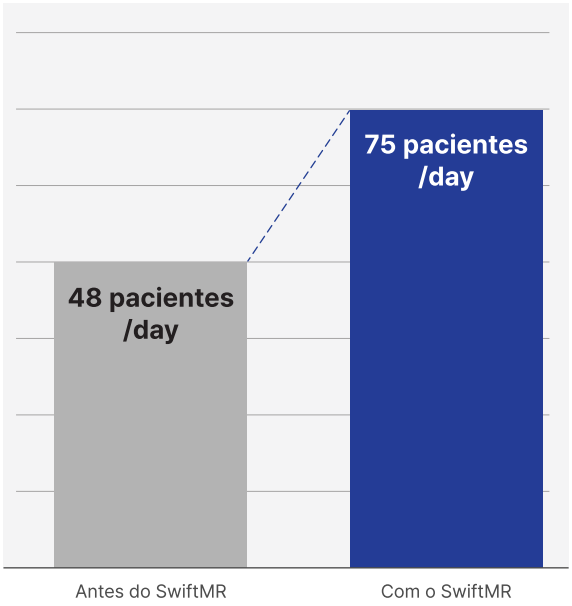
O SwiftMR™ permite que os centros de radiologia alcancem um novo nível de produtividade e eficiência com exames de RM.
A redução do tempo de varredura de RM aumenta a rotatividade de pacientes, criando oportunidades de crescimento de receita por meio do aumento do uso da RM.

Com o SwiftMR™, o Dr. Consulta alcançou um aumento de 56% na capacidade operacional diária.

Redução média de 44% do tempo da ressonância

	Tempo da ressonância		
Parte do corpo	Antes	depois	Reduction
Joelho	12:11	03:53	-68%
Tornozelo	11:49	04:17	-64%
Coluna vertebral (C)	04:38	01:58	-58%
Cérebro (rotina)	12:49	06:25	-50%
Coluna vertebral (L)	06:13	03:10	-49%
Pelve	12:50	06:57	-46%
Ombro	07:09	03:58	-45%
ARM	13:36	07:30	-45%
Quadril	06:14	03:41	-41%

+56% de capacidade operacional diária



Cobertura abrangente do SwiftMR™**

O que nos diferencia é nossa abordagem ponderada para projetar nossos produtos para centros de radiologia. Atendemos a diversas necessidades fornecendo cobertura abrangente.

Idades
Todas as idades

Partes do corpo
Todas as partes do corpo

Intensidade de campo
3 T ou inferior

Sequência de pulsos
Todas as sequências de pulso

Fabricantes
Todos os fabricantes de RM

*Números baseados em dados de um único local. Os resultados individuais podem variar
**As partes do corpo compatíveis, a sequência de pulsos, a intensidade de campo magnético, a população de pacientes e os fabricantes de RM podem variar de acordo com o país.

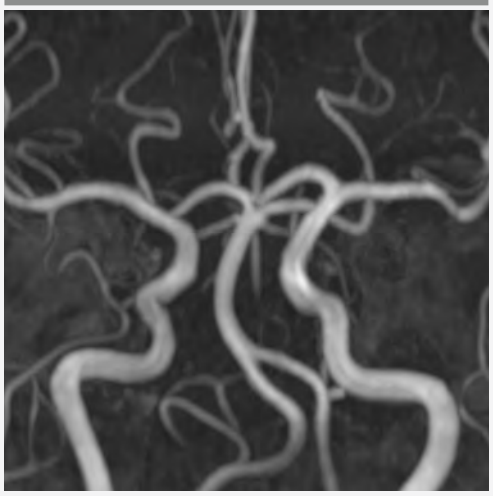
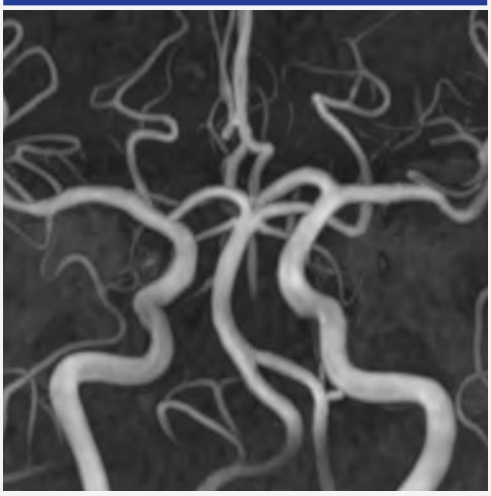
O SwiftMR™ reduz o tempo de varredura

O SwiftMR™ reduz o tempo de varredura de RM em até 50%*, preservando a qualidade da imagem.

Brain MRA

1.5T
Philips
Ingenia

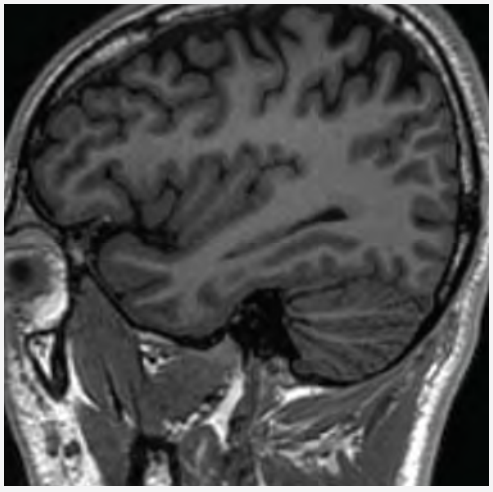
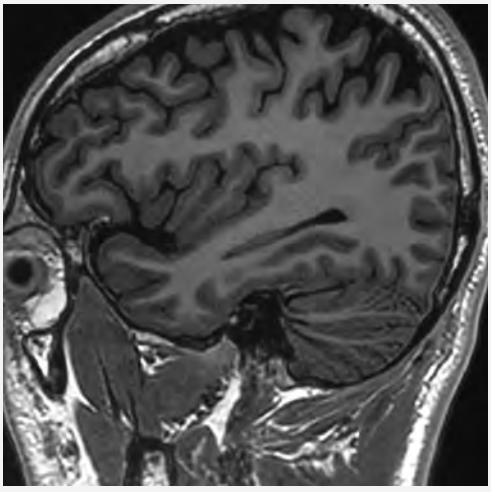
3D TOF
Ⓛ 0.6×0.8×1.2 mm
Ⓡ 0.6×0.8×1.2 mm
MIP

Conventional	SwiftMR™**
	
Tempo de varredura 04:42	Tempo de varredura 02:28

Brain T1WI

3.0T
GE
Discovery MR750w

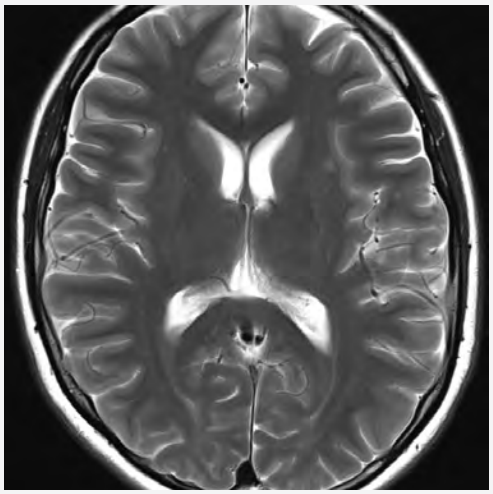
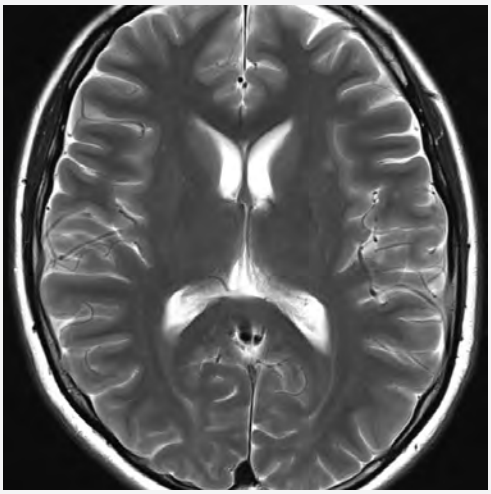
3D BRAVO
Ⓛ 1.0×1.0×1.0 mm
Ⓡ 1.0×1.0×1.0 mm

	
Tempo de varredura 04:11	Tempo de varredura 01:55

Brain T2WI

3.0T
Siemens
MAGNETOM Skyra

2D TSE
Ⓛ 0.4×0.4×5.0 mm
Ⓡ 0.4×0.4×5.0 mm

	
Tempo de varredura 02:22	Tempo de varredura 01:09

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

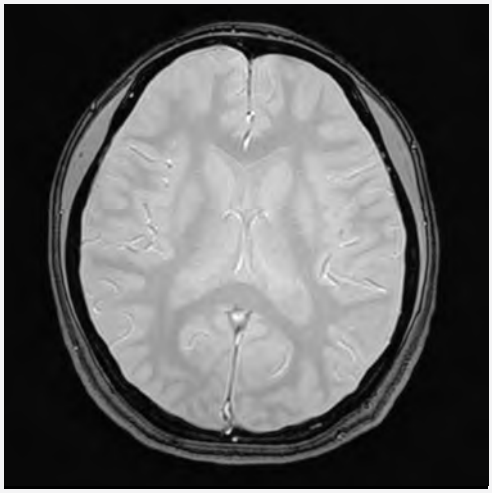
Veja mais imagens

Convencional	SwiftMR™*

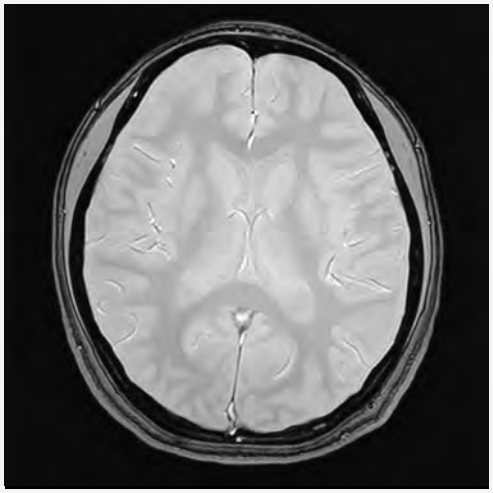
Brain T2*WI

1.5T
GE
Signa HDxt

2D GRE
Ⓛ 0.9×1.1×5.0 mm
Ⓡ 0.9×1.1×5.0 mm



Tempo de varredura 03:17

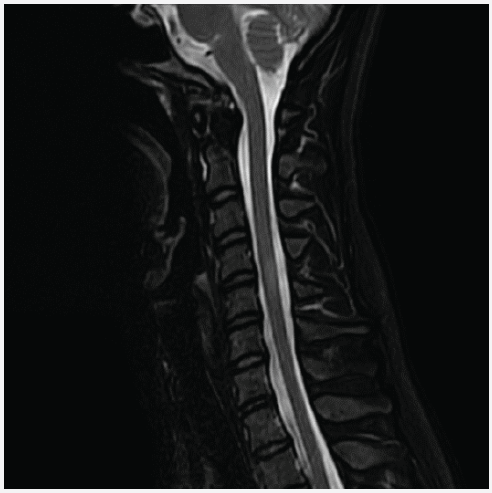


Tempo de varredura 01:40

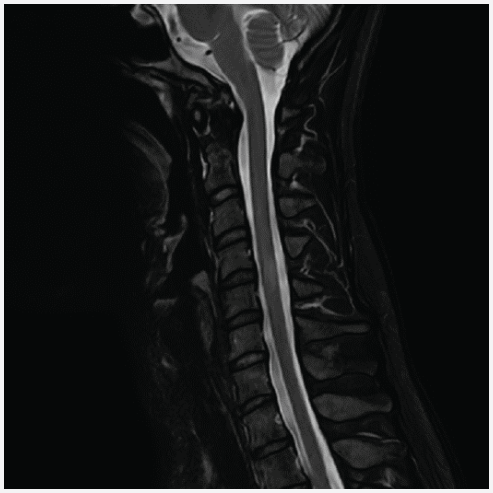
C-Spine Sagittal T2WI

3.0T
GE
Discovery MR750

2D FSE
Ⓛ 0.4×0.4×3.0 mm
Ⓡ 0.4×0.4×3.0 mm



Tempo de varredura 03:10



Tempo de varredura 01:41

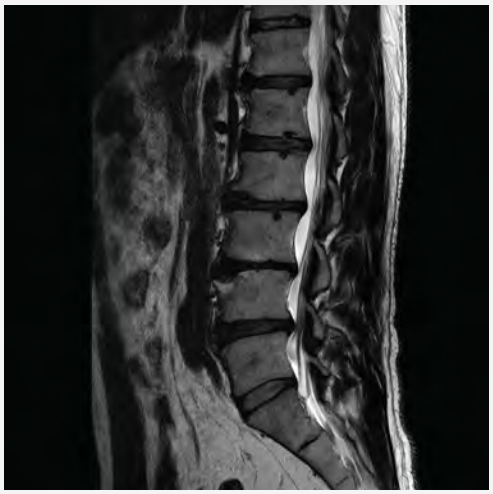
L-Spine T2WI

3.0T
Philips
Ingenia CX

2D TSE
Ⓛ 0.4×0.9×3.0 mm
Ⓡ 0.6×1.1×3.0 mm



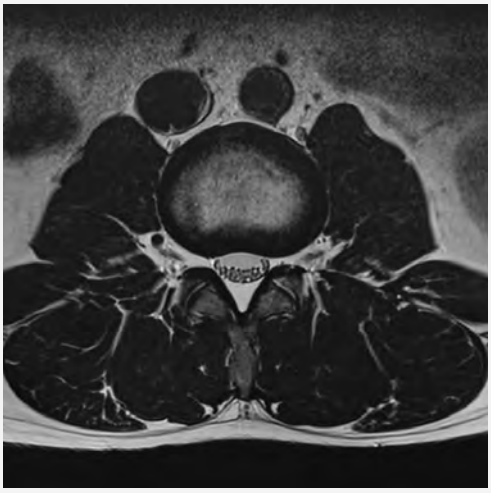
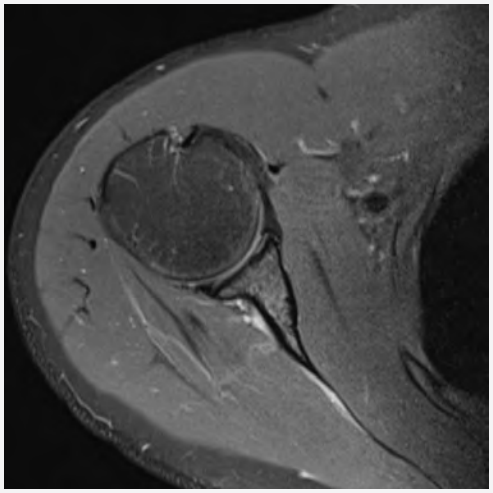
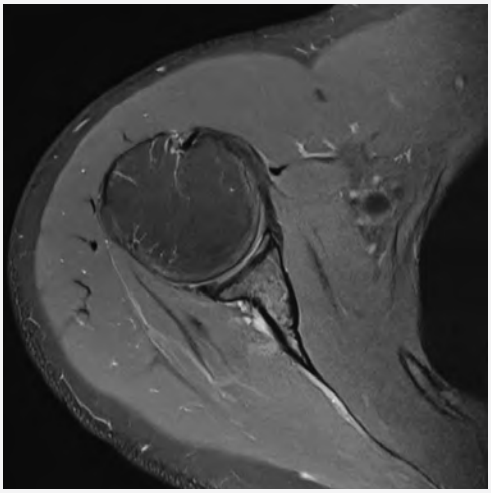
Tempo de varredura 06:08



Tempo de varredura 00:44

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

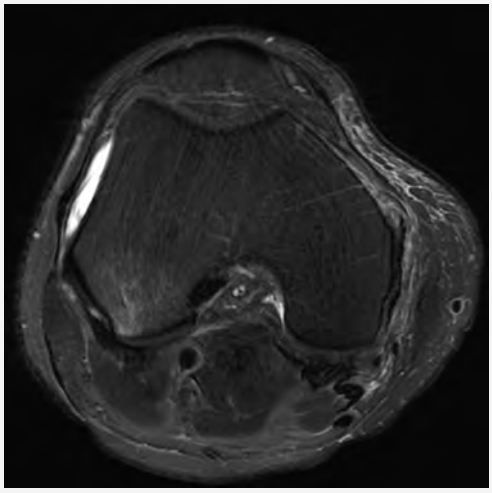
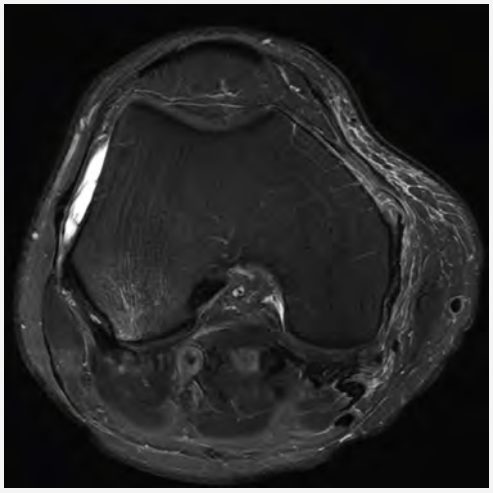
**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

	Convencional	SwiftMR™*
L-Spine T2WI **1.5T** **Siemens** **MAGNETOM Essenza** 2D TSE Ⓛ 0.6×0.8×4.0 mm Ⓡ 0.6×0.8×4.0 mm	 Tempo de varredura 03:00	 Tempo de varredura 01:28
Shoulder PDWI FS **1.5T** **Siemens** **MAGNETOM Essenza** 2D TSE Ⓛ 0.6×0.8×3.0 mm Ⓡ 0.6×0.8×3.0 mm	 Tempo de varredura 02:51	 Tempo de varredura 01:27
Wrist T2WI FS **3.0T** **GE** **SIGNA Premier** 2D FSE Ⓛ 0.3×0.4×2.0 mm Ⓡ 0.3×0.4×2.0 mm	 Tempo de varredura 03:19	 Tempo de varredura 01:49

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

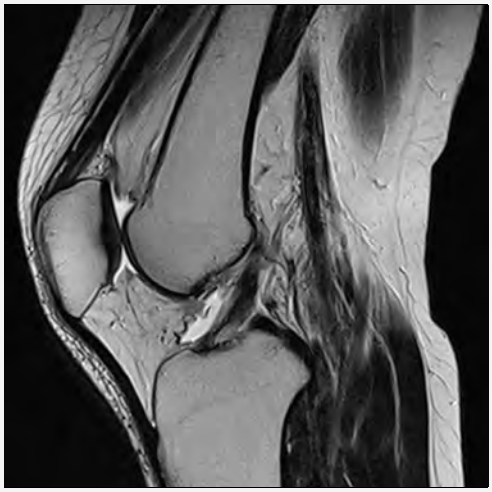
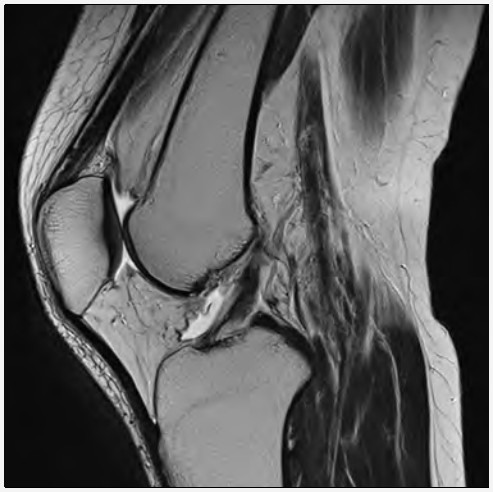
Veja mais imagens

Convencional	SwiftMR™*
	
Tempo de varredura 03:19	Tempo de varredura 01:49

Knee
T2WI FS

3.0T
GE
Discovery MR750

2D FSE
Ⓛ 0.4×0.4×3.0 mm
Ⓡ 0.4×0.4×3.0 mm

	
Tempo de varredura 03:15	Tempo de varredura 01:47

Knee
T2WI

1.5T
Siemens
MAGNETOM Essenza

2D TSE
Ⓛ 0.5×0.6×3.0 mm
Ⓡ 0.5×0.6×3.0 mm

	
Tempo de varredura 02:42	Tempo de varredura 01:36

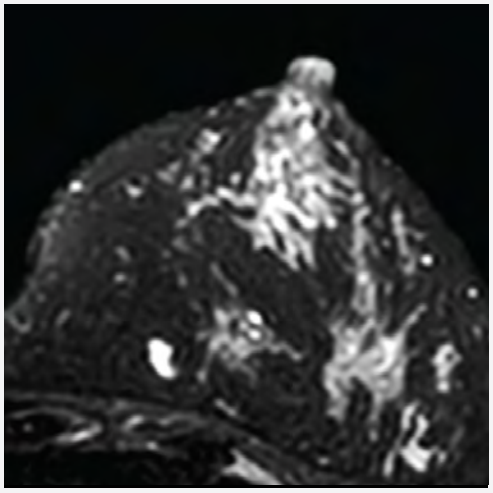
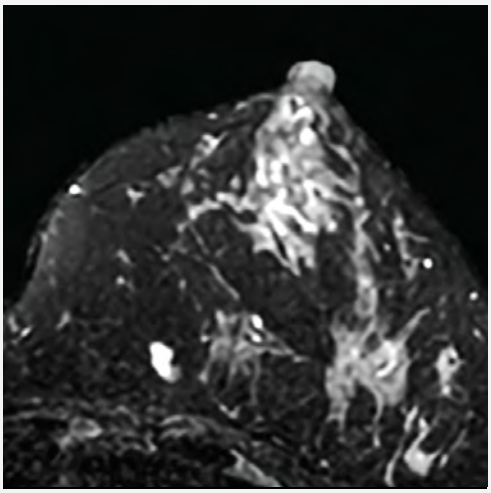
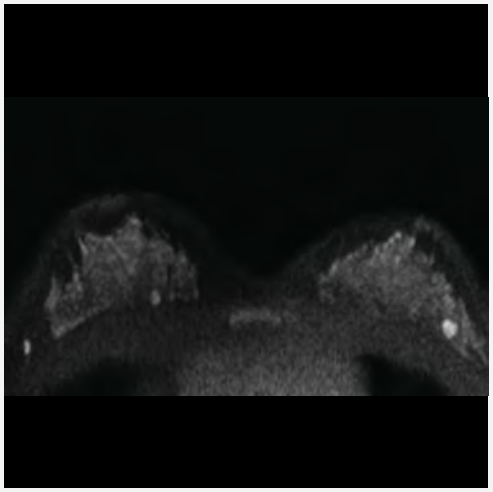
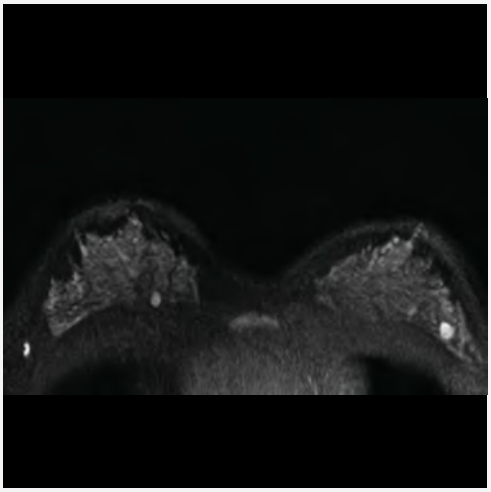
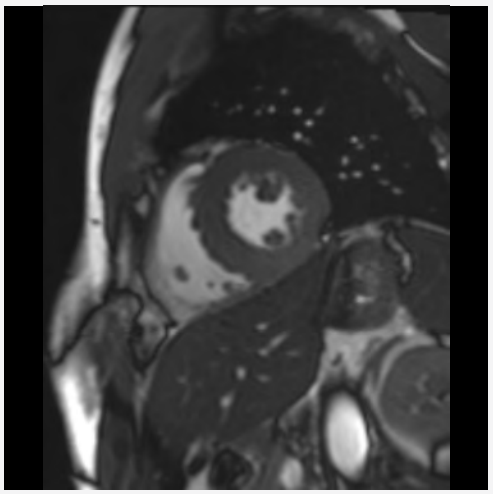
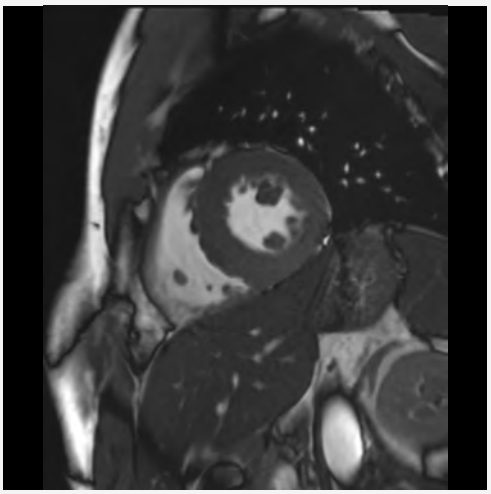
Knee
PDWI FS

3.0T
Philips
Ingenia CX

2D TSE
Ⓛ 0.4×0.5×3.0 mm
Ⓡ 0.4×0.5×3.0 mm

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

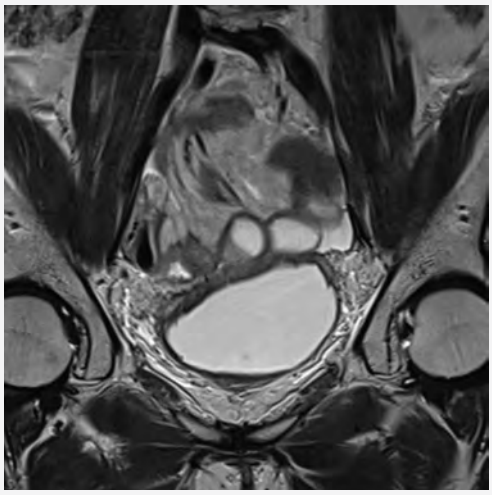
**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

	Convencional	SwiftMR™*
Breast T2WI FS **3.0T** **Philips** **Ingenia CX** 2D TSE Ⓛ 1.4×1.5×1.0 mm Ⓡ 1.2×1.3×1.0 mm		
	Tempo de varredura 05:14	Tempo de varredura 03:17
Breast DWI b800 **3.0T** **Philips** **Ingenia CX** 2D EPI Diffusion Ⓛ 1.3×1.3×3.0 mm Ⓡ 1.3×1.3×3.0 mm		
	Tempo de varredura 06:31	Tempo de varredura 04:43
Heart CINE **3.0T** **Siemens** **MAGNETOM Skyra** 2D TRUEL Ⓛ 1.4×2.2×6.0 mm Ⓡ 1.4×1.8×6.0 mm		
	Tempo de varredura 01:29	Tempo de varredura 00:55

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

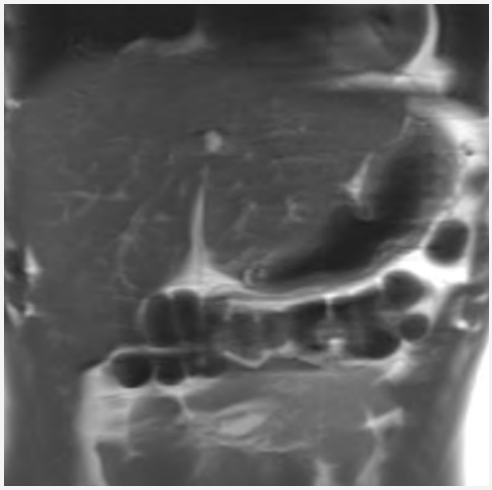
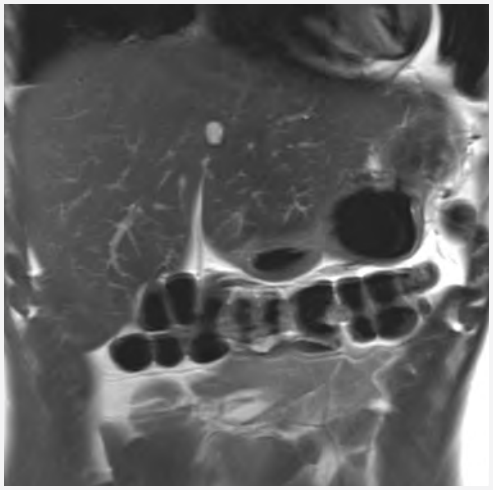
Veja mais imagens

Convencional	SwiftMR™*
	
Tempo de varredura 03:51	Tempo de varredura 02:41

Bladder
COR T2

3.0T
Siemens
MAGNETOM Skyra

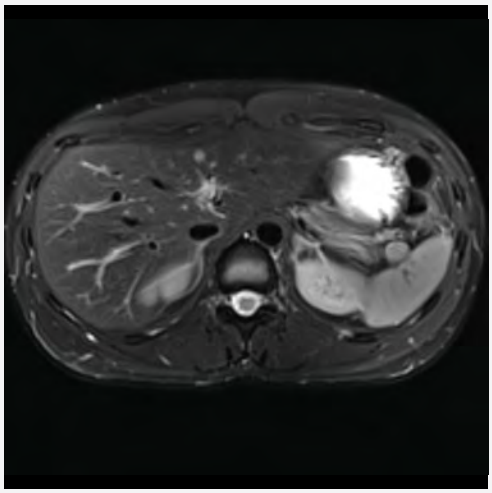
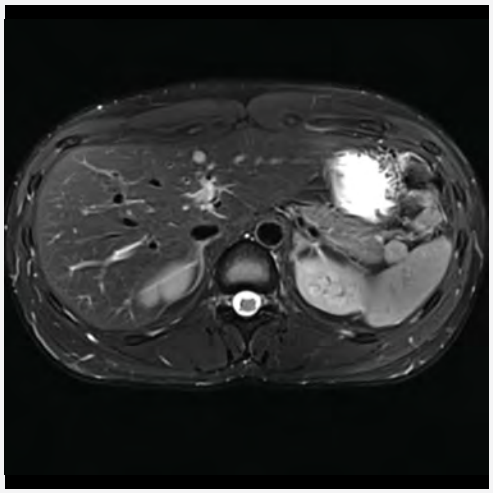
2D TSE
Ⓛ 0.6×0.9×3.0 mm³
Ⓡ 0.5×0.7×3.0 mm³

	
Tempo de varredura 00:33 2 suspensões de respiração	Tempo de varredura 00:17 1 suspensão de respiração

Liver
T2WI

3.0T
Siemens
MAGNETOM Skyra

2D HASTE
Ⓛ 1.2×1.5×5.0 mm
Ⓡ 1.0×1.2×5.0 mm

	
Tempo de varredura 02:20	Tempo de varredura 01:45

Liver
T2WI FS

3.0T
Siemens
MAGNETOM Skyra

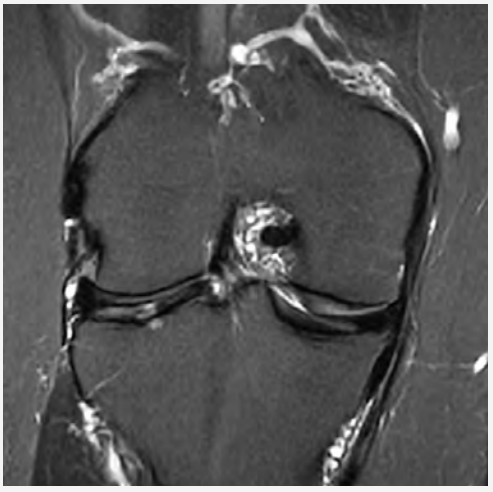
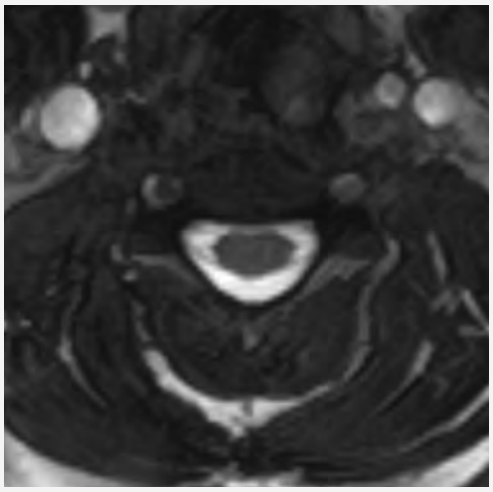
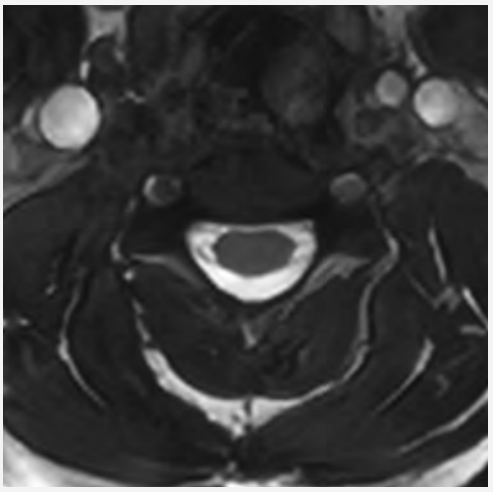
2D TSE-BLADE
Ⓛ 1.5×1.5×4.0 mm
Ⓡ 1.2×1.2×4.0 mm

*Apenas para fins investigacionais para redução do tempo de exame acima de 50%

**Para fins investigacionais em países fora dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, Japão, Taiwan, Malásia, Arábia Saudita, EAU, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, África do Sul, Singapura e Índia. Liberação FDA 510(k) para suportar imagens com redução do tempo de exame em até 50% nos Estados Unidos.

O SwiftMR™ melhora a qualidade das imagens

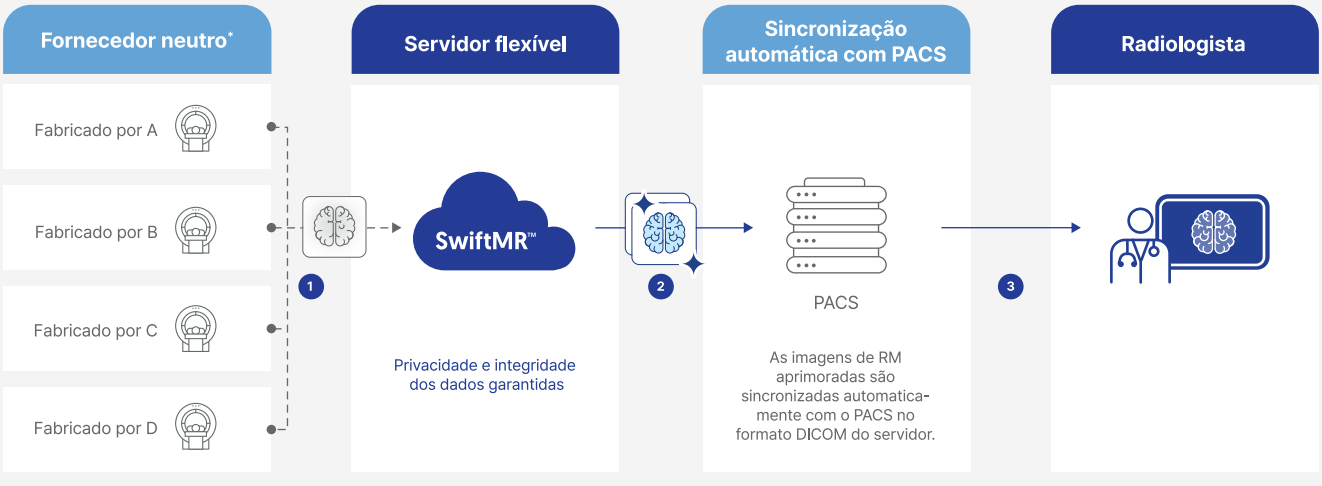
O SwiftMR™ aprimora a qualidade da imagem, tornando as varreduras até mesmo de sistemas herdados mais claras e detalhadas.

	Convencional	SwiftMR™*
Shoulder T2WI FS **1.5T** **Canon** **Vantage Elan** 2D FSE 0.5×0.8×3.0 mm Same scan	 Tempo de varredura 02:12	 Tempo de varredura 02:12
Knee STIR **0.6T** **FONAR** **UPRIGHT Multi-Position MRI** 2D FSE 0.8×0.8×4.0 mm Same scan	 Tempo de varredura 05:26	 Tempo de varredura 05:26
C-Spine T2WI **0.3T** **Hitachi** **AIRIS II** 3D PBSG 1.0×1.2×3.5 mm Same scan	 Tempo de varredura 03:24	 Tempo de varredura 03:24

* Partes do corpo suportadas, sequências de pulso, intensidade de campo, população de pacientes e fabricantes de RM podem variar de acordo com o país

A integração perfeita do SwiftMR™

O SwiftMR™ se encaixa perfeitamente no seu sistema existente - sem interrupções, sem necessidade de equipamentos adicionais. Forneceremos uma equipe dedicada de sucesso do cliente composta por especialistas em RM para instalar nosso software e otimizar seus protocolos.



*Os fabricantes de equipamentos de RM compatíveis podem variar de acordo com o país

Conheça o SwiftMR™ em primeira mão

Mensagem do CEO

No atual cenário competitivo da área da saúde, escolher o parceiro tecnológico certo é fundamental para o sucesso. Como uma empresa de IA em crescimento, compreendemos as suas preocupações sobre a confiança em novas soluções, especialmente no domínio sensível dos cuidados de saúde. Na AIRS Medical, priorizamos a construção de confiança e a garantia da confiabilidade de nossas soluções de radiologia com inteligência artificial.

Estamos orgulhosos do impacto positivo do SwiftMR™ em mais de 1 milhão de pacientes em todo o mundo, recebendo elogios de radiologistas, especialistas em imagem e administradores hospitalares. Este marco enfatiza a eficácia e a confiabilidade de nossa tecnologia.

Acreditamos em colocar nossas soluções à prova. É por isso que oferecemos uma avaliação gratuita do SwiftMR™, sem compromisso. Assim você poderá testemunhar em primeira mão as melhorias que ele pode trazer para suas operações.



Hye Seong Lee
CEO da AIRS Medical



Se quiser saber mais sobre o SwiftMR™, envie um e-mail para **bd@airsmed.com** ou preencha um formulário no nosso site usando este código QR. Estamos ansiosos para falar com você.

airsmed.com

DOC00002327 (Rev.2)

AIRS MEDICAL

Este documento destina-se ao uso exclusivo de profissionais de saúde

bd@airsmed.com

AIRS Medical Inc.

Seoul, HQ

13-14F, Keungil Tower, 223, Teheran-ro,
Gangnam-gu,Seoul, 06142, Republic of Korea

T +82 70-7777-3187 F +82 2-6280-3185

Chicago

475 North Martingale Rd., Suite 710,
Schaumburg, IL 60173, United States

T +1 847-306-8731

Japan

15-16F, Toranomon Hills Business Tower,
1 Chome-17-1 Toranomon, Minato City, Tokyo 105-6490, Japan

T +81 03-6807-5926

Europe

Oskar-von-Miller-Ring 20
80333 Munich, Germany

airsmed.com