Reporte de evaluación BCI
Fecha: 2026-11-03 12:06
Duración: 00:59

Total de intentos: 19
Selecciones completadas (aciertos): 2
Fallos: 17
Accuracy: 10.53%
ITR: 0.91 bits/min

Método de clasificación: CCA
Ventana de tiempo: 3.0s
Canales utilizados: 0:O1, 1:Oz, 2:O2, 3:PO3, 4:PO4

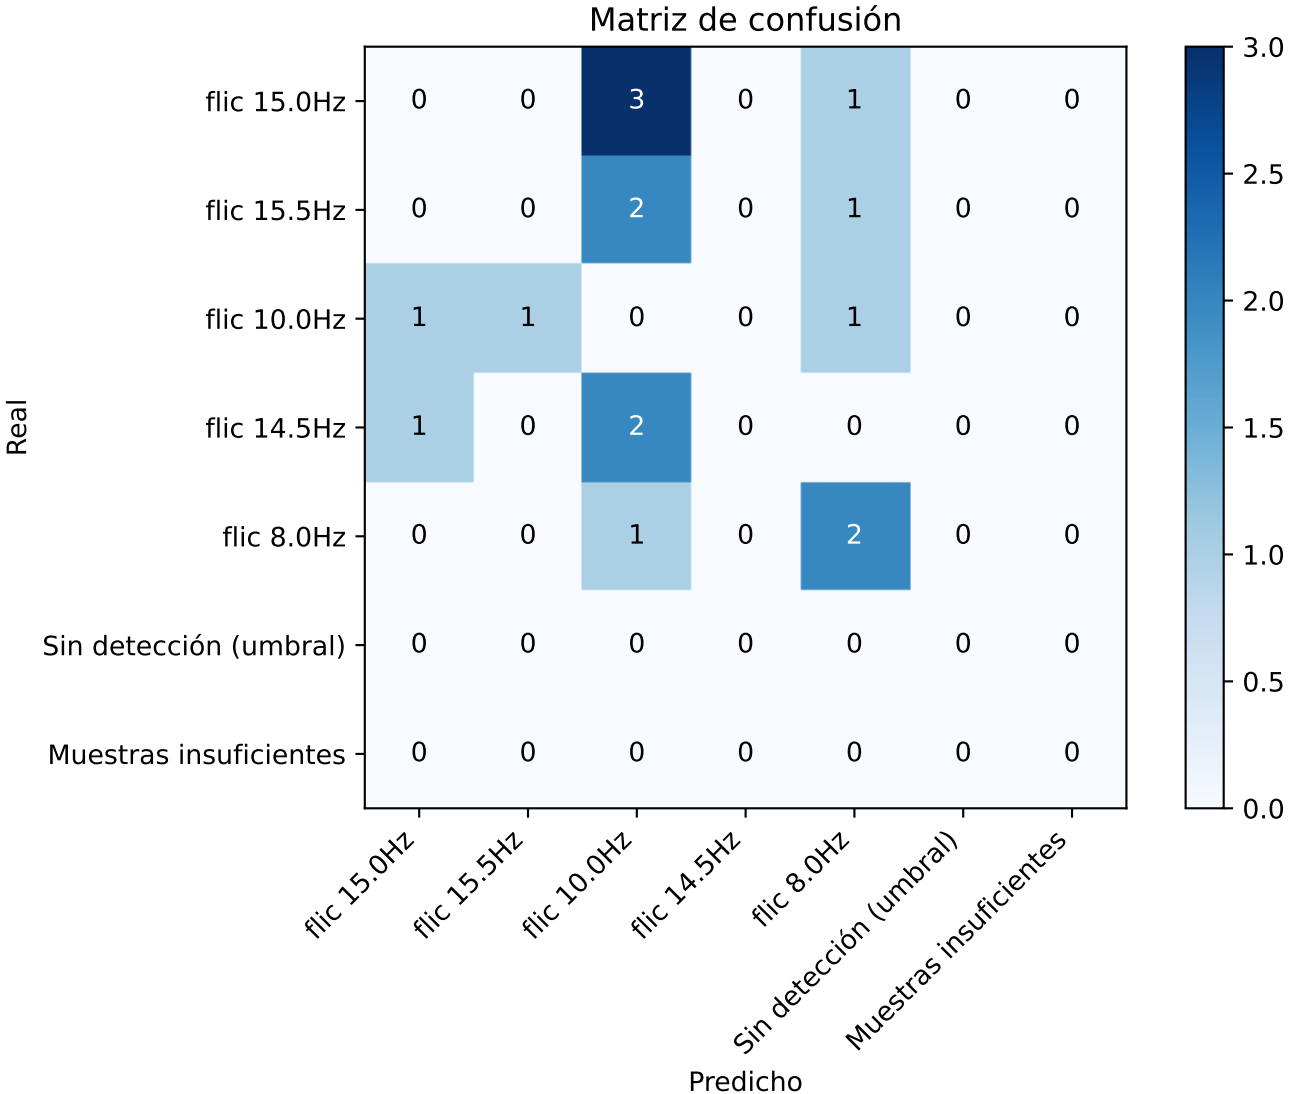
Matriz de confusión
flic 15.0Hz
flic 15.5Hz
flic 10.0Hz
flic 14.5Hz
flic 8.0Hz
Sin detección (umbral)
Muestras insuficientes
Real
0 0 3 0 1 0 0
0 0 2 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0
1 0 2 0 0 0 0
0 0 1 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
flic 15.0Hz
flic 15.5Hz
flic 10.0Hz
flic 14.5Hz
flic 8.0Hz
Sin detección (umbral)
Muestras insuficientes
Predicho
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0