



Aestheon
Embrace Your Life

AI 접목된 최초, 스마트 HIFU

초음파 영상 분석을 통한 인공지능 자동화 시스템

주식회사 에스테온

Aestheon Co., Ltd.



2026. 04

시작하기 전에

I. Grand View Research (2024): "메디컬 에스테틱 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11%를 기록할 전망이며, 이 중 **레이저 제모와 에너지 기반 리프팅 기기가 매출의 가장 큰 축을 담당한다.**"

[Grand View Research: Medical Aesthetics Market Size & Share Report](#)

II. ISAPS (국제미용성형수술협회) 통계: 전 세계 비수술적 시술(Non-surgical procedures) 중 **제모**는 보톡스/필러를 제외한 장비 시술 중 **부동의 1위**.

[ISAPS Global Statistics \(Latest Reports\)](#)

III. Mordor Intelligence: 에너지 기반 미용 기기(EBD) 시장에서 **초음파(HIFU)와 고주파(RF) 장비 모델이 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 보여준다.**

[Energy-based Aesthetic Devices Market Size \(Mordor Intelligence\)](#)

INDEX

1. 회사 및 제품 소개

2. 시장 현황

(w/ 경쟁사 분석)

3. 수익성 분석

4. IPO 전략



MISSION

전세계 피부케어시장의

실질 사용자를 위한 보다

개선된 제품으로 인류

건강에 이바지 한다.

주요 사업 분야



US: 초음파/울리프

듀얼 모드 집속형 초음파 기술
리프팅 & 타이팅



RF: 고주파 / 스팅어

듀얼 모드 고주파 기술
피부 탄력 개선



제모 레이저 (Laser): 에필레이저

Diode 삼파장 3000 와트 기술
삼파장 제모 & 리프팅

울리프 사업 현황 및 2026년 추진 로드맵

개발 및 사업현황

Dual-mode HIFU 개발 완료 / 전시 출품 / 10월 출하

2025. 04



개발 착수

2025. 09



법인 설립

2025. 10



전기/전자 파트
개발 완료

2026. 03



워킹 목업 완성 및 데모
(한국의료기기박람회)
(KIMES)

2026. 10




1차 양산품 출시
CE획득
수출 시작

제품 원리 소개


Ullift: 비 침습형 집속형 초음파 (HIFU) 리프팅 장비 - 원리

Aestheon
Embrace Your Life

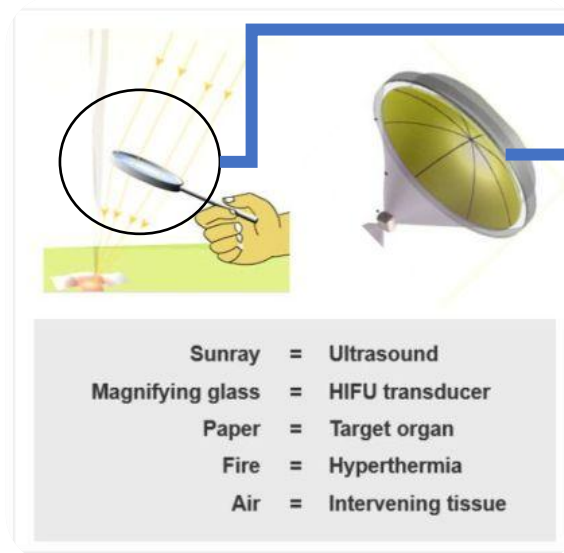

돋보기: 빛을 모아 집속 열 발생


HIFU 소자: 초음파를 모아 집속 에너지 발생

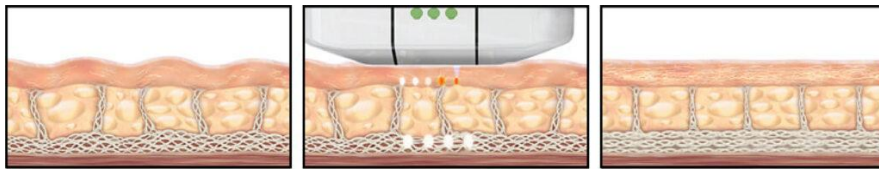

시술 전
노화되 주름진 피부

시술 1일
피부 SMAS 층 가열
자연스러운 재생 반응
새로운 콜라겐 생성 촉진

3개월
2~3개월 걸친 점진적 개선
시술 후 최대 6개월 지속

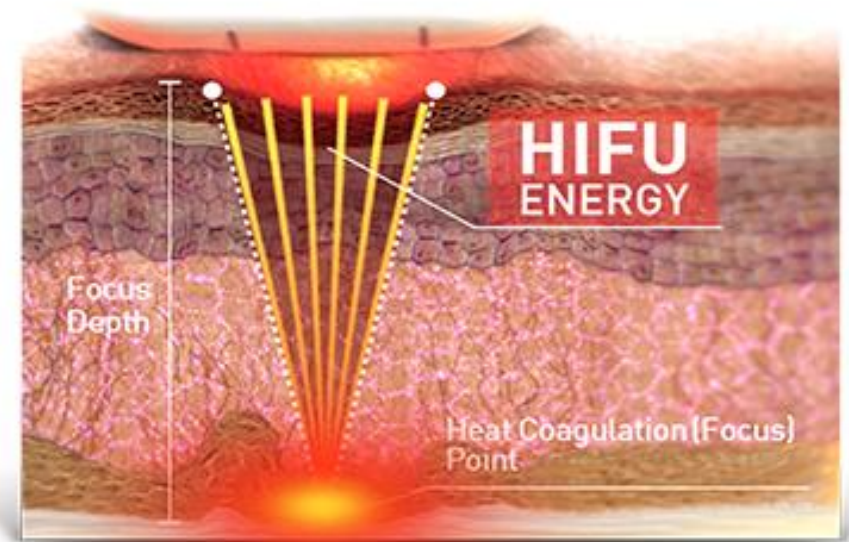

집속 된 초음파 에너지로 피부 콜라겐 층에 미세한 자극을 주어 콜라겐을 재 생성 (Collagen Regeneration)을 촉진 하는 원리

제품 임상 소개


Ullift: 적응증 (Indications)

Aestheon
Embrace Your Life

Skin Tightening



Skin Lifting

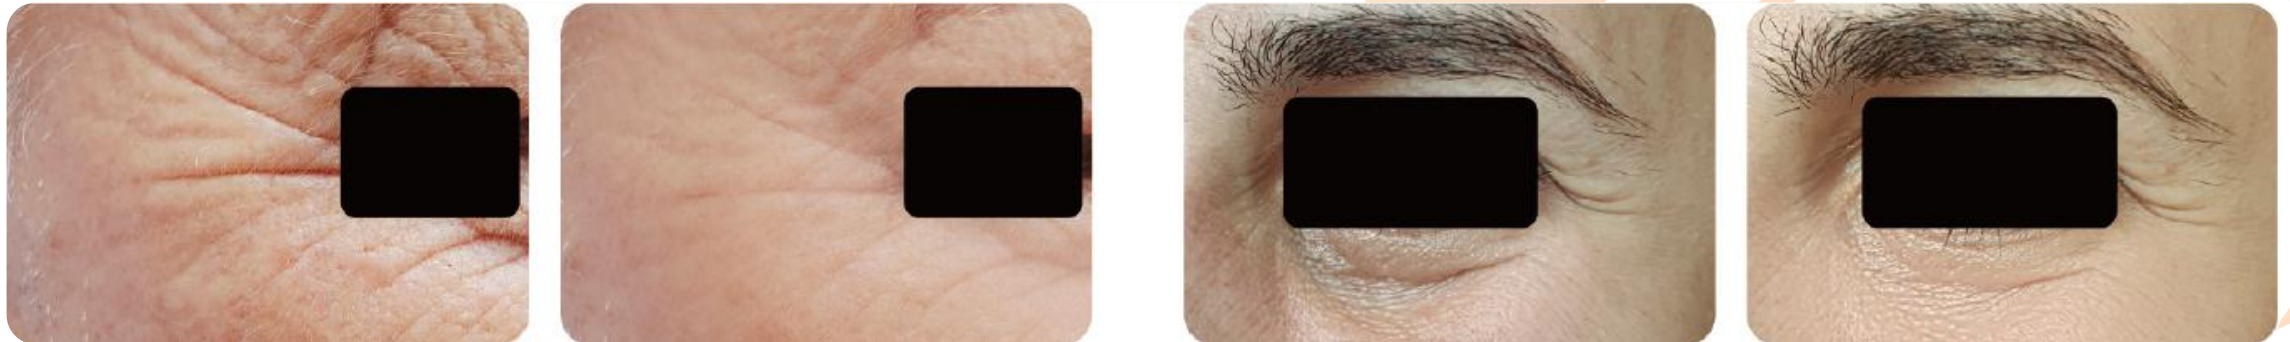


제품 임상 소개

Ullift: 적응증 (Indications)

Aestheon
Embrace Your Life

Skin Tightening

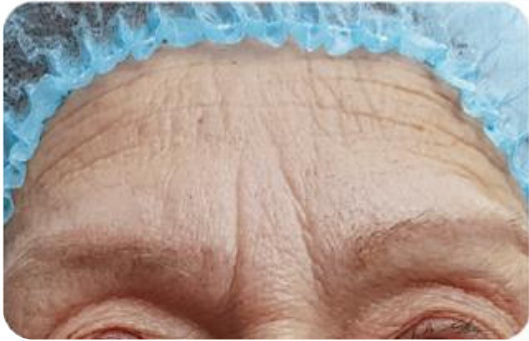

Skin Lifting





시장 니즈 (Market Needs)

- ✓ 비침습 리프팅/타이트닝 수요 급증:수술 없는 안티에이징 기술 선호도 지속 상승
- ✓ 기술 안전성 및 정밀성 요구:부작용 최소화 및 개인별 맞춤 기술 필요성 대두



기존 기술의 한계 (Limitations)

- ✗ 수동 깊이 설정의 오차:시술자가 육안으로 판단하여 정확한 타겟층 설정 어려움
- ✗ 시술자 편차로 인한 일관성 저하:숙련도에 따라 효과 차이 발생 및 화상 위험 상존



SOLUTION

AI 기반 피부층 자동 인식 및 출력 제어 HIFU

인공지능이 실시간으로 피부층을 분석하여 최적의 에너지 깊이와 출력을 자동 조절하는 혁신 기술.
시술자 의존도를 낮추고 안전성과 효과를 획기적으로 향상.


출원: 피부 단면 초음파 영상 분석을 이용한 고강도 집속 초음파의 자동 조사 깊이 제어 방법 및 장치 {Method and Apparatus for Automatic Control of Focal Depth of High-Intensity Focused Ultrasound Using Skin Cross-Sectional Ultrasound Image Analysis}
출원 번호: 10-2025-0205436




정부 정책 부합성

K-바이오 및 의료기기 산업 고도화 · 글로벌 시장 선점을 위한 수출 주도형 핵심 기술 육성

CAD (Computed Aid Diagnosis) 관련 컴퓨터 자동 판독 시스템 (AI 이전 이미 30년전 개발 발전)

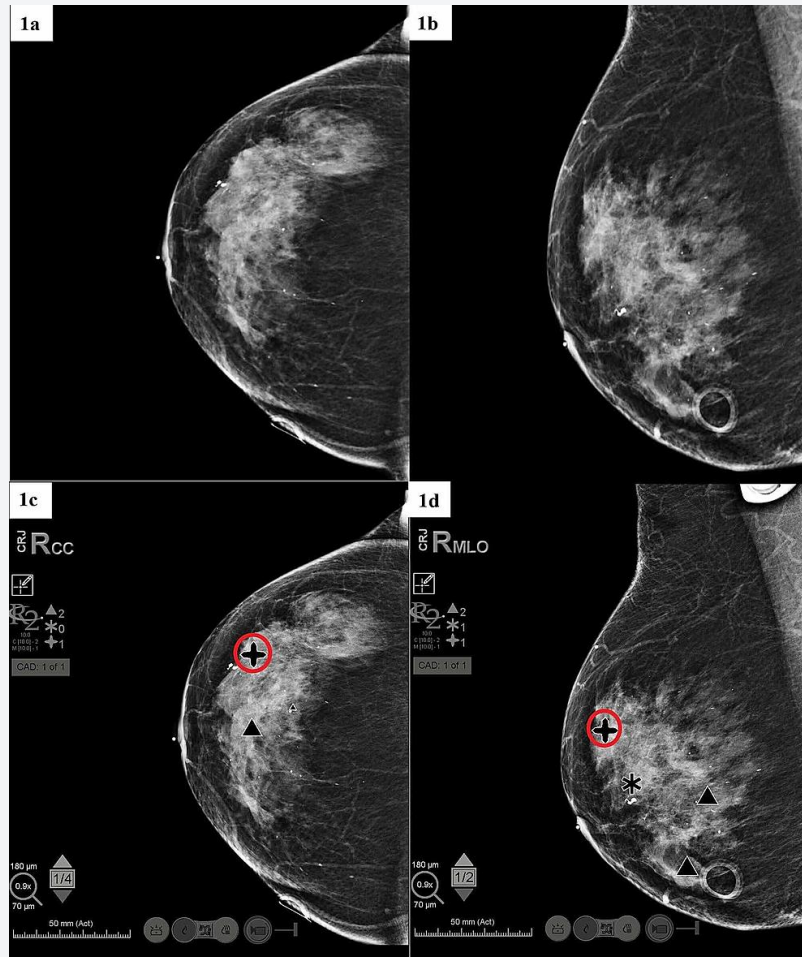

유방암 Mammography에서 암은 판독
비정상적으로 흰 부분

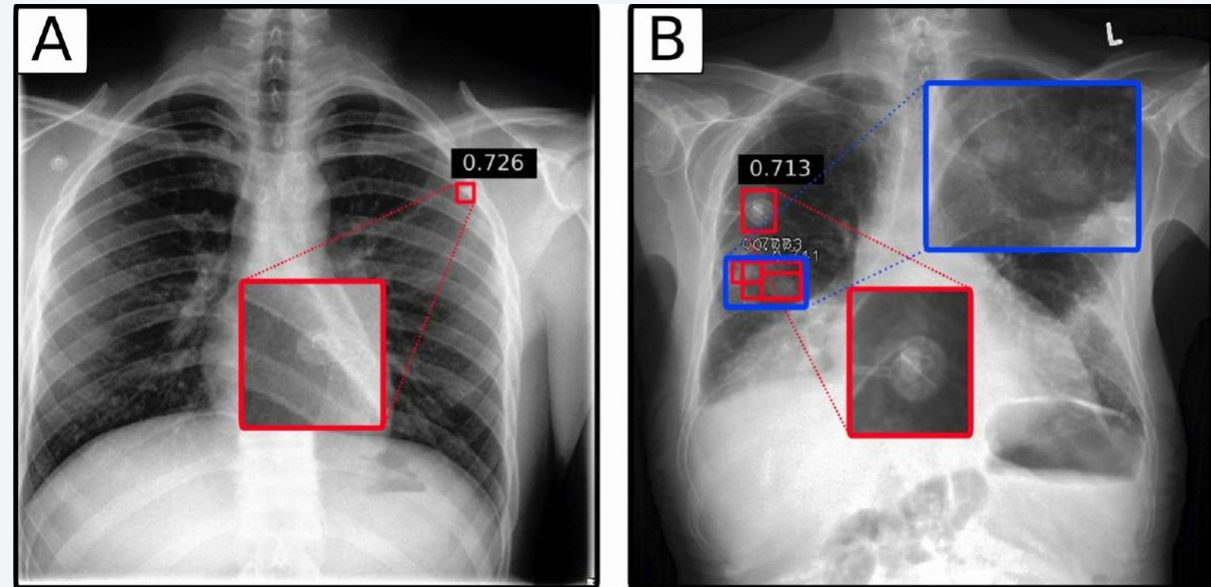


폐 결핵이나, 종양 판독
비정상적 흰색.

대표이사 이력

PACS SI Engineer로 시작 해외 기술 영업 담당한 전문 경력
2001 ~ 2005: (주) 메디칼스탠다드 & (주)승일데이터 시스템
→ DICOM PACS 전문 업체

2008 ~ 2010: PACSPLUS Inc (LA 주재원 PACS & RIS 기술영업 담당)

미국 Ulthera (울세라) 장비 이미지

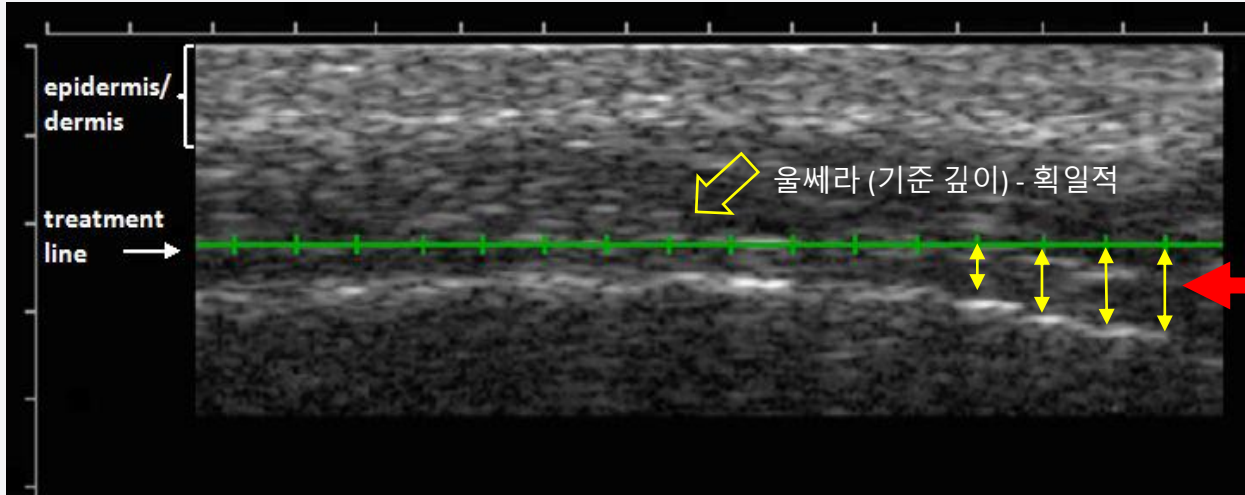


피부 깊이 자동인식 시스템으로 의료사고 차단

- 카트리지 선택 실수나 압력 조절 실수
- 근육층 및 골조직 조사하는 사고 발생.
- 멍, 함몰 등과 같은 부작용

근막(SMAS) 층과 HIFU 깊이
차이를 조절 못함


1. 근막층을 판독하여 최적 깊이 자동 인식 가능.
2. DICOM 표준의 영상으로 픽셀당 길이가 정의 됨.

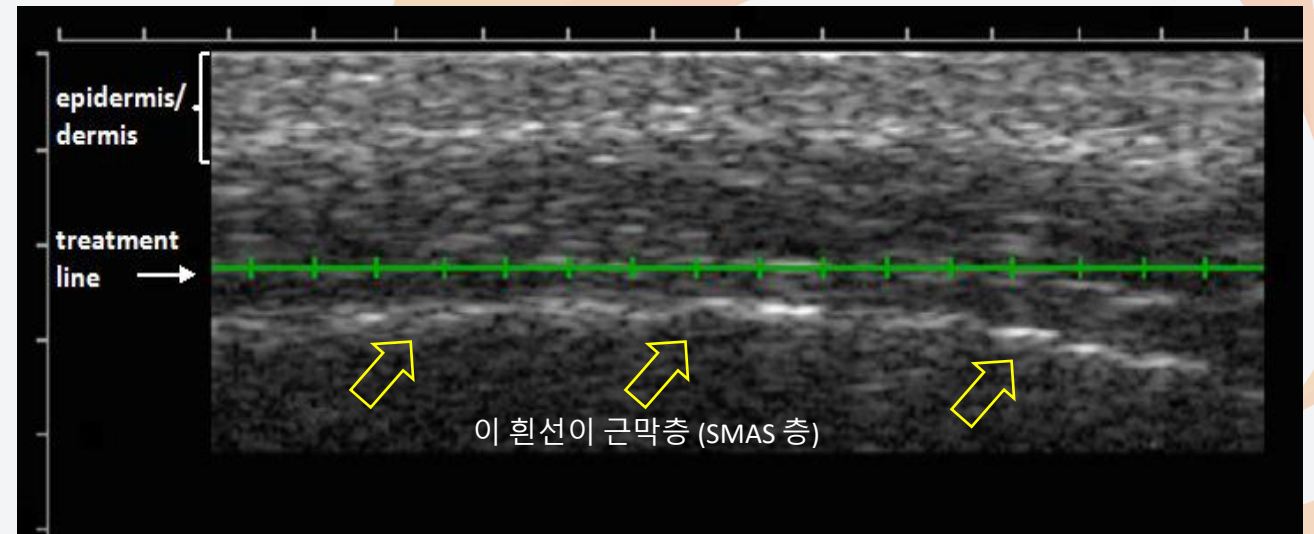

피부층 자동 인식 Core Tech

초음파 영상 데이터를 실시간 분석하여 SMAS(근막)층과 진피층의 깊이를 자동으로 탐지. 시술자 간 편차 없이 정확한 타겟팅 가능.

실시간 초음파 분석 (Real-time Analysis)

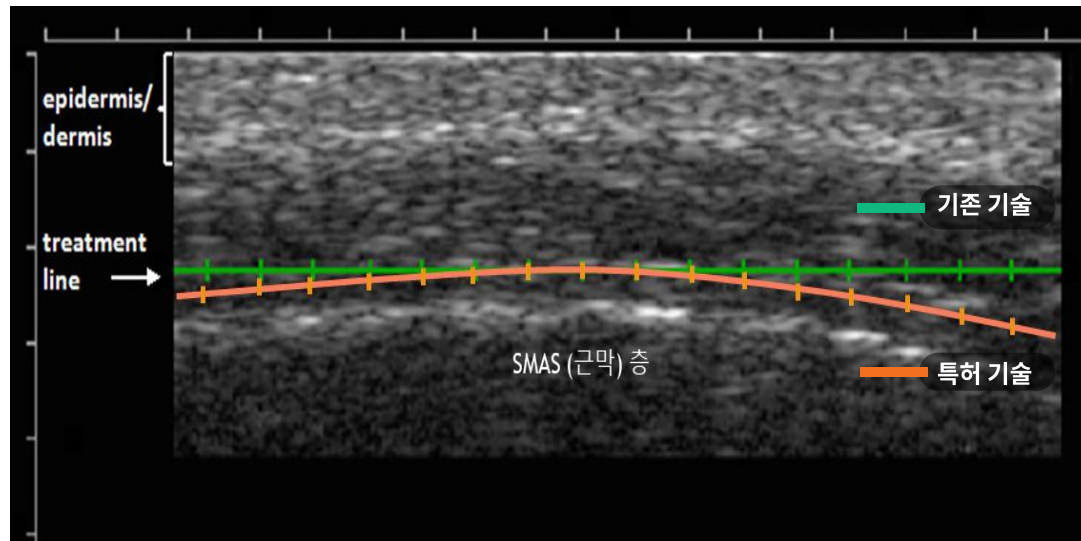


특허 출원 번호: 10-2025-0205436

세로축 자동 조절: AI가 분석한 피부층 깊이에 맞춰 트랜스듀서의 세로축(VERTICAL Axis)을 실시간으로 제어하여 정확한 에너지 조사 깊이를 유지함.


기존 기술

Horizontal Axis Motor 방식: 수평 이동만 가능하며 깊이 조절은 카트리리지 교체나 수동 조작에 의존.
피부 굴곡에 따른 정밀 타겟팅 한계.

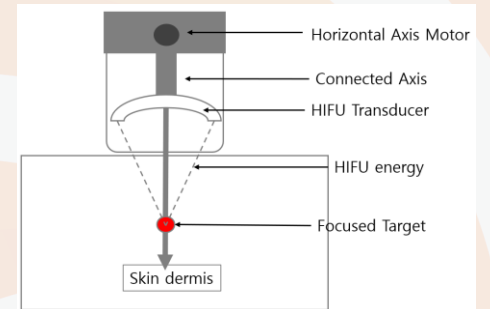

특허 기술 (2차 출원예정)

Vertical Axis Motor 제어: AI 분석 데이터에 기반하여 수직 모터가 실시간으로 조사 깊이를 자동 보정. (속도 해결 방안이 특허)
깊이가 다른 SMAS 층에 일정한 깊이 유지.

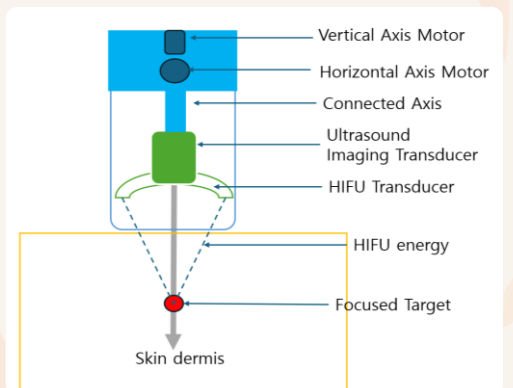

피부층 자동 인식 Core Tech – Smart HIFU

초음파 영상 데이터를 실시간 분석하여 SMAS(근막)층과 진피층의 깊이를 자동으로 탐지. 시술자 간 편차 없이 정확한 타겟팅 가능.

경쟁사 Ulthera 특허 (2026 만료)

전세계 시장 점유율 1위

(특허: 초음파 영상 표출)



(문제: 보여주기만 함)

(문제: 필요성 없음)

(문제: 편의성 없음)

미국 → 독일

아이템 특허

(특허 1: AI영상판독)

(특허 2: AI자동조절)

(특허 3: 빠른 조절)

편의성/필요성

경쟁사 Jeysis 특허

(특허:수직/깊이 조절 모터)

(문제:수직모터 추가만)

(문제:수동 / 불편)

(문제:느림 / 외면)

한국 → 프랑스



※ 그 외 타사 및 클래스시스 조차 관련 기술이 전혀 없음

글로벌 선도 기업 대비 확실한 기술적 격차 확보

기존 장비의 한계를 극복한 AI 기반 차세대 솔루션으로 시장 진입

구분 (Criteria)	Global Competitors	Aestheon (Proposed)
	국내 및 브라질 1위 클래식스 슈링크	AI 기반 Smart HIFU
 깊이/출력 조절	시술자 수동 설정 (Manual)	 AI 기반 자동 인식 및 조절 PATENT
 시술 모드	단일 모드 (Dot or Linear)	 Dual-Mode (Dot + Linear) 통합
 안전성 제어	사전 설정값 의존 (Passive)	 실시간 조직 반응 피드백 제어
 사용자 편의성	높은 숙련도 요구 (Learning Curve)	 스마트 가이드 UI & 추천 프로토콜
 경제성 (TCO)	고가의 장비 및 소모품 비용	 최적화된 유지보수 비용 구조




시가 총액 3.4조



Smart HIFU, 임상 및 기술 AI + IoT 시스템 아키텍처

데이터 기반 진단 및 AI 자동 대응 프로세스

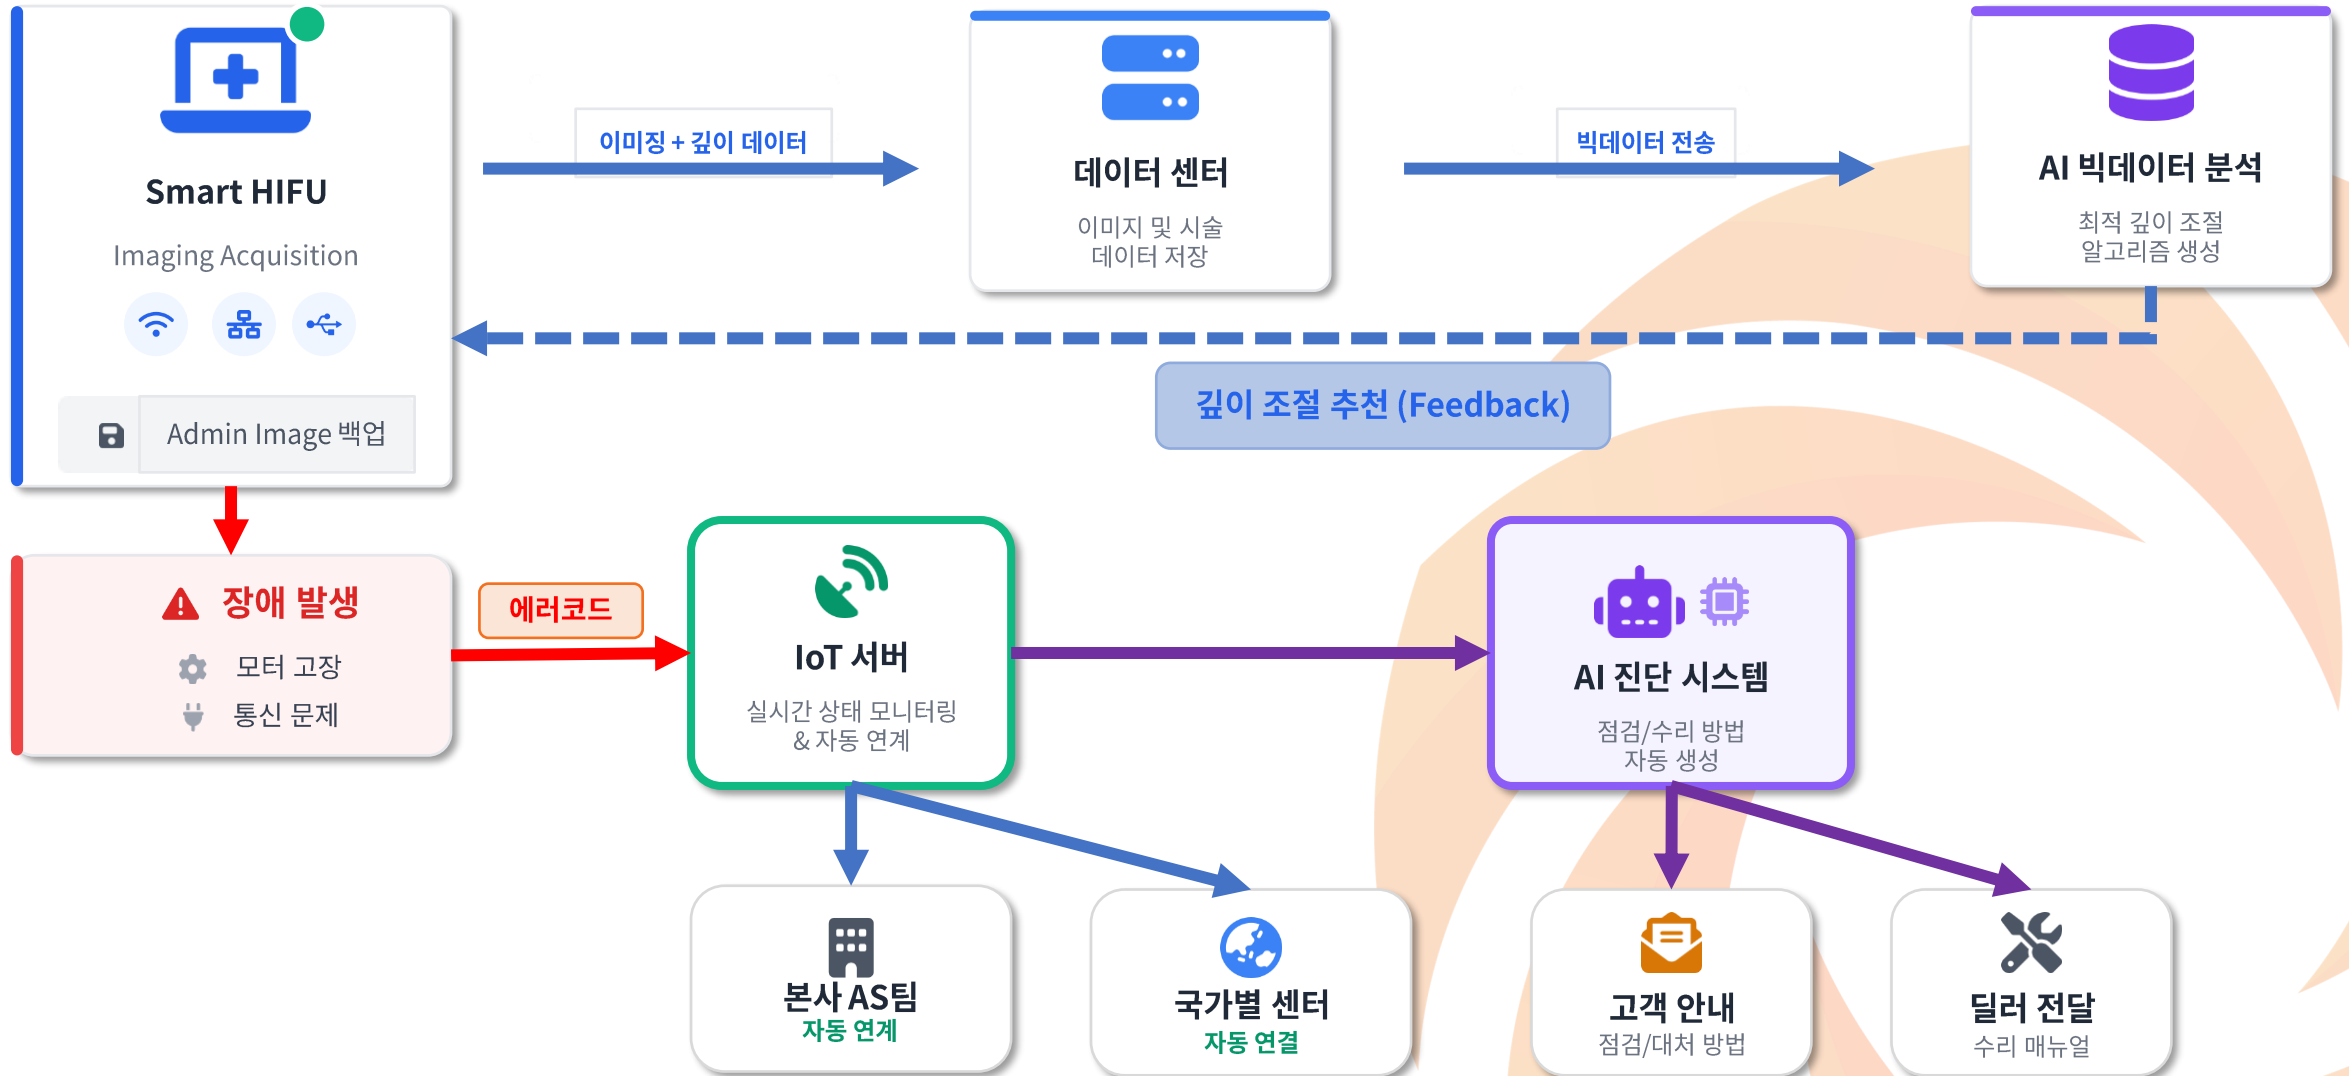

● 정상 데이터 흐름

● 에러 발생 및 전파

● AI 분석 및 솔루션

제품 개발 현황

Ullift: 비 침습형 집속형 초음파 (HIFU) 리프팅 장비 - 시제품

Aestheon
Embrace Your Life

| 울리프(Ullift): 듀얼모드 듀얼핸드피스, 편의성을 최우선으로 구현 함



System Specifications

Type	HIFU(High Intensity Focused Ultrasound)
Handpiece	Line-type dual handpieces
Frequency	4 Mhz, 7 Mhz
Cartridge Depth	Face : 1.5, 3.0, 4.5 mm Body : 6.0, 9.0 mm
Treatment Length	25mm Max
Energy	Face 1.5J Max (0.1J per a step) Body 2.5J Max (0.1J per a step)
Pitch	1.0~2.0 mm (0.1 mm)
Interface	12.1 inch 1280*800 TFT LCD
Dimensions (WxDxH)	374 x 283 x 300(mm)
Input Power	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz



제품소개

Ulift(울리프): 비 침습형 집속형 초음파 (HIFU) 리프팅 장비 - 시제품

Aestheon
Embrace Your Life

시제품 - 최종 개발 완료



- 개발완료 2026년 3월 서울 KIMES (한국 의료기기 박람회) 출품 / 부스: A730
- 2026년 4월 양산 준비(몰드 금형 주문) / CE-KCC 인증 신청
- 2026년 9월 Dubai Derma 출품 (3월 말에서 연기) → 딱 좋은 시점
- 2026년 9월 CE / KCC 획득 수출 시작



2026 KIMES Seoul
2026.03.19 ~22, COEX

제품 개발 현황

Ulift: 제품의 기본 모델과 스마트형 모델

Aestheon
Embrace Your Life

| 울리프 1(Ulift I)

- 듀얼모드와 듀얼핸드피스를 장착한 기존 대비 편의성이
- 빠른 출시, 빠른 시장진입



2026개발 완료 양산 준비중

| 울리프 2 (Ulift II)

- 3년간의 빅데이터 수집과 인공지능을 학습을 적용
- 시장의 **Game Changer**, 세계 최초 스마트 HIFU




2029년 개발 완료 예정

시장 현황

빠른 매출과 소모품으로 인한 급성장 가능성

- 1) 울리프 시장 규모
- 2) 성공 HIFU 공식
- 3) 경쟁사 HIFU 성공과 실패
- 4) 울리프 차별전략

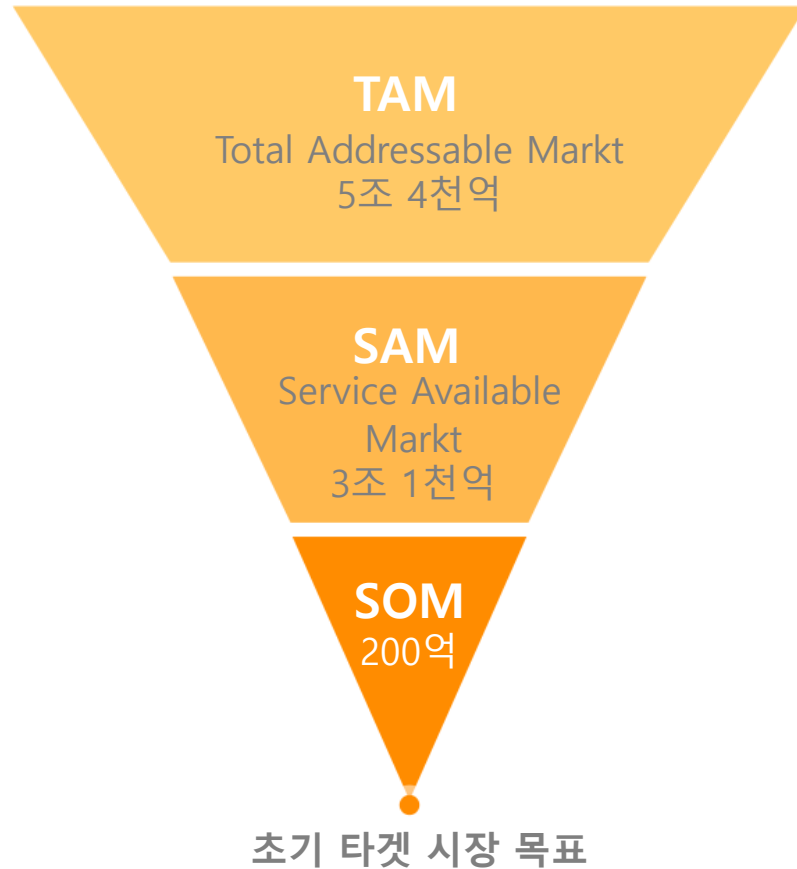

전체 시장

5조4천억

글로벌 에너지기반 에스테틱 시장

- ✓ CAGR 7.22 ~ 10% (2025~2030)
- ✓ 북미, 아시아, 유럽(EMEA) 주요 지역 전체
- ✓ 피부 미용 및 리프팅 장비 시장 포괄

피부 비용 HIFU 시장

3조1천억

HIFU 리프팅 및 타겟 적응증 시장

- ✓ 병·의원 전문 의료기기 시장 (Home-use 제외)
- ✓ 프리미엄 및 미드엔드(Mid-end) 가격대 세그먼트

초기 타겟 시장 (5년내)

200억

주식회사 에스떼온 제품 3종 운용 시장

- ✓ 초기 진출 3개년 주요 거점 (한국/일본/동남아)
- ✓ 5년차 연 매출 200억원 목표 기준 점유율 산정
- ✓ 기존 노후 장비 교체 수요 및 신규 도입처

Links of the Reference: [Data Bridge Market Research](#) / [Precedence](#) / [Straits Research](#) / [Valuates Reports](#)

세계 1위를 다투는 국산 HIFU

(주)클래시스의 Ultra Former 3 (슈링크)

구분 (Criteria)	Global Competitors
	국내 및 브라질 1위 클래식스 슈링크 (Ultra Former III)
→ 선점 인가?	국내 후발 주자 (선도기업: 해외 - 울쎄라 / 국내 - 하이로닉)
→ 디자인 투자	2010년 당시 디자인 금형에만 12억 투자 (업계 평균 2~3억)
→ 영업 투자	초기 무상 교환 100대 (대상: 울쎄라 / 하이로닉)
→ 마케팅 투자	키닥터를 이용한 임상 마케팅 / 학회 전시 적극 참가 (대표: 피부과 원장)
→ 핵심 및 결과	초기 모델 1과 2 실패 / 디자인 중요성 확인 - 2014개발 2017상장, 시총 3.7조



클래시스 실적 & 재무

최근 3년 + 2025 실적 흐름

(단위: 억원)

연도	매출액	영업이익	순이익(지배)	영업이익률	비고
2022	1,418	689	754	48.6%	✔ 슈링크 중심 고마진 구조 확립
2023	1,801	896	742	49.8%	🌐 해외 장비 판매 확대
2024	2,429	1,224	979	50.4%	🏆 역대 최대 실적, OP 1,200억+ (클래시스 - 병원용 피부 의료기기)
2025	3,368	1,706	1,319	50.7%	📈 컨센 기준, 고성장 이어가는 전망 (컴퍼니 가이드)

근거 사이트: <https://contents.premium.naver.com/prover/wisdomessenger/contents/251207112444540qf?utm>

- 시가총액 약 3.5~3.6조원 수준 (1,319억 x 27 = 시총: 3조 7000억원)
- PSR 약 27배

관련 성공한 동종 업체들

(주)하이로닉/(주)클래시스/(주)아스테라시스 / (주)텐텍 (IPO중)

시가총액



그 외 설립 후 20여년동안 비소모품 제품으로 상장 못하다가 소모품 장비로 바로 상장한 회사

- 1) 원텍: 1999년 설립 > 2020년 올리지오 (고주파 RF) 출시 후 2022년 상장. (24 / 3)
- 2) 이루다: 2006년 설립 > 2017 시크리트 (고주파 RF) 출시 후 2020년 상장 (15 / 3)

왜 그들은 실패 했는가

HIFU로 크게 성공한 업체를 보고 단순 시도함

1. 로우엔드급 디자인 피델리티(Fidelity)

- 높은 금형 비용 부담 → 저급 디자인
- 하이엔드 포지셔닝의 한계

2. 임상 마케팅 부재

- 임상연구진(의사) 확보 하지 않음
- 시술 전후 사진 부재

3. 집종의 부재

- 기존제품에 집착
- 집중하지 않음



차별성:

1. 디자인 투자: **첫 인상 전략** (Middle-High-End급 구매력 확보)
2. 편리성 개선: 사용자 **편의성을 극대화**.
3. 기능 개선: **듀얼 모드** (Linear & Dot) / 사용기간 개선 **12000 시술 샷**
4. 가격 경쟁력: **잉크젯 프린터 전략**: 19볼 세트, 25볼 카트리지

비교항목	울세라	클래시스	아스트라시스	하이로닉	제이시스	은성	텐텍	에스떼온
모델	울세라	슈링크 시리즈	리프테라	더블오 시리즈	리니어지	포커스듀얼	텐세라	Ulift (올리프)
핸드피스	1개	2개	1개	1개	1개	1개	1개	2개
수출가 (Dist. USD)	40,000	20,000	15,000	15,000	15,000	12,000	12,000	6~10,000
카트리지 시술 샷 수	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000

텐텍: 텐세라



아스트라시스
리프테라



사업성 및 수익성

초음파 HIFU / 고주파 마이크로니들 / 고주파 MNRF

- 1) 율리프 수출 전략
- 2) 율리프 수익성 분석
- 3) 추가 제품 계획
- 4) 종합 성장 계획

2026 올리프 수출 전략

제품 수출 전략 및 실행 그리고 개발

Aestheon
Embrace Your Life

상업화 추진 전략

▶ 올리프(Ullift) 수출 및 유저 / 사업화 빠른 확보

6개월 단기 성과 창출	빠른 수출 및 CE 인정 가능 국가 JP 일본 TH 태국 HK 홍콩 AE 두바이 ID 인도네시아 PH 필리핀 IN 인도 ML 말레이시아	※ 독점 계약 국가 ※ 계약 및 사전 주문 국가 ※ 계약 협의중 국가	의료기관 직접 수입 또는 의사 명의 보증 제도를 활용하여 정식 인증 전 Fast-Track 수출 개시 또는 2026년 8월 CE 획득 이후 수출 예정 국가
1년 시장 확장	일반 인증 국가 (KFDA 인정) VN 베트남 SG 싱가포르 TW 대만 TH 태국 JP 일본		한국 식약처(KFDA) 승인 문서로 현지 인증이 가능한 국가를 활용하여 간소화된 등록 절차로 신속 진입
2년 선진 시장	Medical CE / FDA 필수 요구 국가 EU 유럽(EU) 전역 US 미국 GB 영국 CA 캐나다 AU 호주		엄격한 임상 데이터 및 기술 문서(MDR) 준비. 진입 장벽이 높으나 시장 규모가 가장 큰 핵심 시장
3년 독자 인증	현지 추가 인증 필요 (복합 인증) SA 사우디 (SFDA) BR 브라질 (ANVISA) RU 러시아 (GOST-R) CN 중국 (CFDA)		CE/FDA 획득을 기본 요건으로 하며, 현지 대리인을 통한 별도 임상/등록 절차가 필수적인 고난이도 시장



▶ 이와 동시에 1년차 부터 제모레이저 및 고주파 장비 개발

울리프 수익성 계산의 근거

HIFU 카트리지 예상 판매량 분석

Aestheon
Embrace Your Life

🎯 판매 목표 설정

초기 시장 진입 및 인지도를 고려하여 보수적인 기준을 적용했습니다.

본 계획 (보수적 기준)

10개

10개 / 대

시장 평균 (메이저급)

평균 30개

20~40개 / 대

📊 시술 기준 및 근거 산출



1회 시술 Shot 수

600~1,000

얼굴 전체 기준



카트리지 용량

10,000 shots

1개당 약 10~15건 시술

월 평균 환자
25~50건

×

연간 예상 수요 산출 흐름

운영 기간
12개월

=

연간 시술 인원
300~600건



시장 수요 분석 결과

연간 20~40개 카트리지 수요 발생

사업 계획 적용 (보수적)

연 10개



수익 산출 (1대 기준)

연간 카트리지 매출

10개 × \$800

\$8,000

5년 소모품 기대 수익

연매출 × 5년

\$40,000

참고: 초기 1세트 가격 10,000 USD



울리프 수익성 계산의 근거

울리프 - 해외 수출 3개년 계획

매출 소스	장비수출 대수			카트리지 수출 대수			장비수출 금액			카트리지 수출 금액			수출 (USD)		
	2027년	2028년	2029년	2027년	2028년	2029년	2027년	2028년	2029년	2027년	2028년	2029년	2027년	2028년	2029년
일본	10	20	30	50	195	428	\$100,000	\$200,000	\$300,000	\$40,000	\$156,000	\$342,400	\$140,000	\$356,000	\$642,400
태국	5	10	20	25	97.5	239	\$50,000	\$100,000	\$200,000	\$20,000	\$78,000	\$191,200	\$70,000	\$178,000	\$391,200
홍콩	5	8	10	25	87.5	170	\$50,000	\$80,000	\$100,000	\$20,000	\$70,000	\$136,000	\$70,000	\$150,000	\$236,000
UAE	5	10	20	25	97.5	239	\$50,000	\$100,000	\$200,000	\$20,000	\$78,000	\$191,200	\$70,000	\$178,000	\$391,200
인도	20	50	100	100	440	1151	\$200,000	\$500,000	\$1,000,000	\$80,000	\$352,000	\$920,800	\$280,000	\$852,000	\$1,920,800
인도네시아	10	20	30	50	195	428	\$100,000	\$200,000	\$300,000	\$40,000	\$156,000	\$342,400	\$140,000	\$356,000	\$642,400
베트남	10	20	30	50	195	428	\$100,000	\$200,000	\$300,000	\$40,000	\$156,000	\$342,400	\$140,000	\$356,000	\$642,400
대만	10	20	30	50	195	428	\$100,000	\$200,000	\$300,000	\$40,000	\$156,000	\$342,400	\$140,000	\$356,000	\$642,400
총합	75	158	270	375	1,502.5	3,511	\$750,000	\$1,580,000	\$2,700,000	\$300,000	\$1,202,000	\$2,808,800	\$1,050,000	\$2,782,000	\$5,508,800

일반적 HIFU 교체 주기

1년차 5%
2년차 12% 적용

초기 시장 진입 후 발생하는 교체 수요를 반영한 전략적 수치입니다.
이 추정 방식은 의료기기 산업 분석에서 흔히 쓰는 **Survival / Replacement curve**를 적용함

» North America

North America leads the Skin Imaging Systems Market Outlook with 38% global share and over 80,000 active systems. The United States alone accounts for more than 74,000 units. Annual dermatology visits exceed 85 million across the region. Over 71% of licensed dermatologists use digital imaging in routine exams. Canada reports 6,200 systems across hospitals and clinics, with provincial screening programs covering 4.8 million patients. 3D imaging adoption reached 29% in tertiary hospitals. AI-assisted diagnostics are used in 46% of urban facilities. Tele-dermatology networks handle over 18 million consultations annually. **Replacement cycles average 6.2 years**, driving steady equipment turnover. Regulatory frameworks standardize device use across 50 states and 10 provinces.

Replacement cycles average 6.2 years


근거사이트: https://www.marketreportsworld.com/market-reports/skin-imaging-systems-market-14723366?utm_source

연차별 누적 교체 확률 및 해석

사용 연수	누적 교체 확률	해석 및 시장 상황
1년차	3 ~ 5%	초기 불만 / 기대치 미달 발생 시기
2년차	8 ~ 12%	경쟁사 프로모션, 신모델 등장으로 인한 이탈
3년차	18 ~ 25%	효과·통증·속도 비교 본격화 시점
4년차	30 ~ 40%	기술 세대 교체 시점 (Tech Refresh)
5년차	45 ~ 60%	대다수 고객 교체 고려
6 ~ 7년차	70 ~ 85%	사실상 교체 주기 도달

올리프 판매 및 수익성 분석

장비 및 카트리지 판매 실적 전망 (Sales Projection)

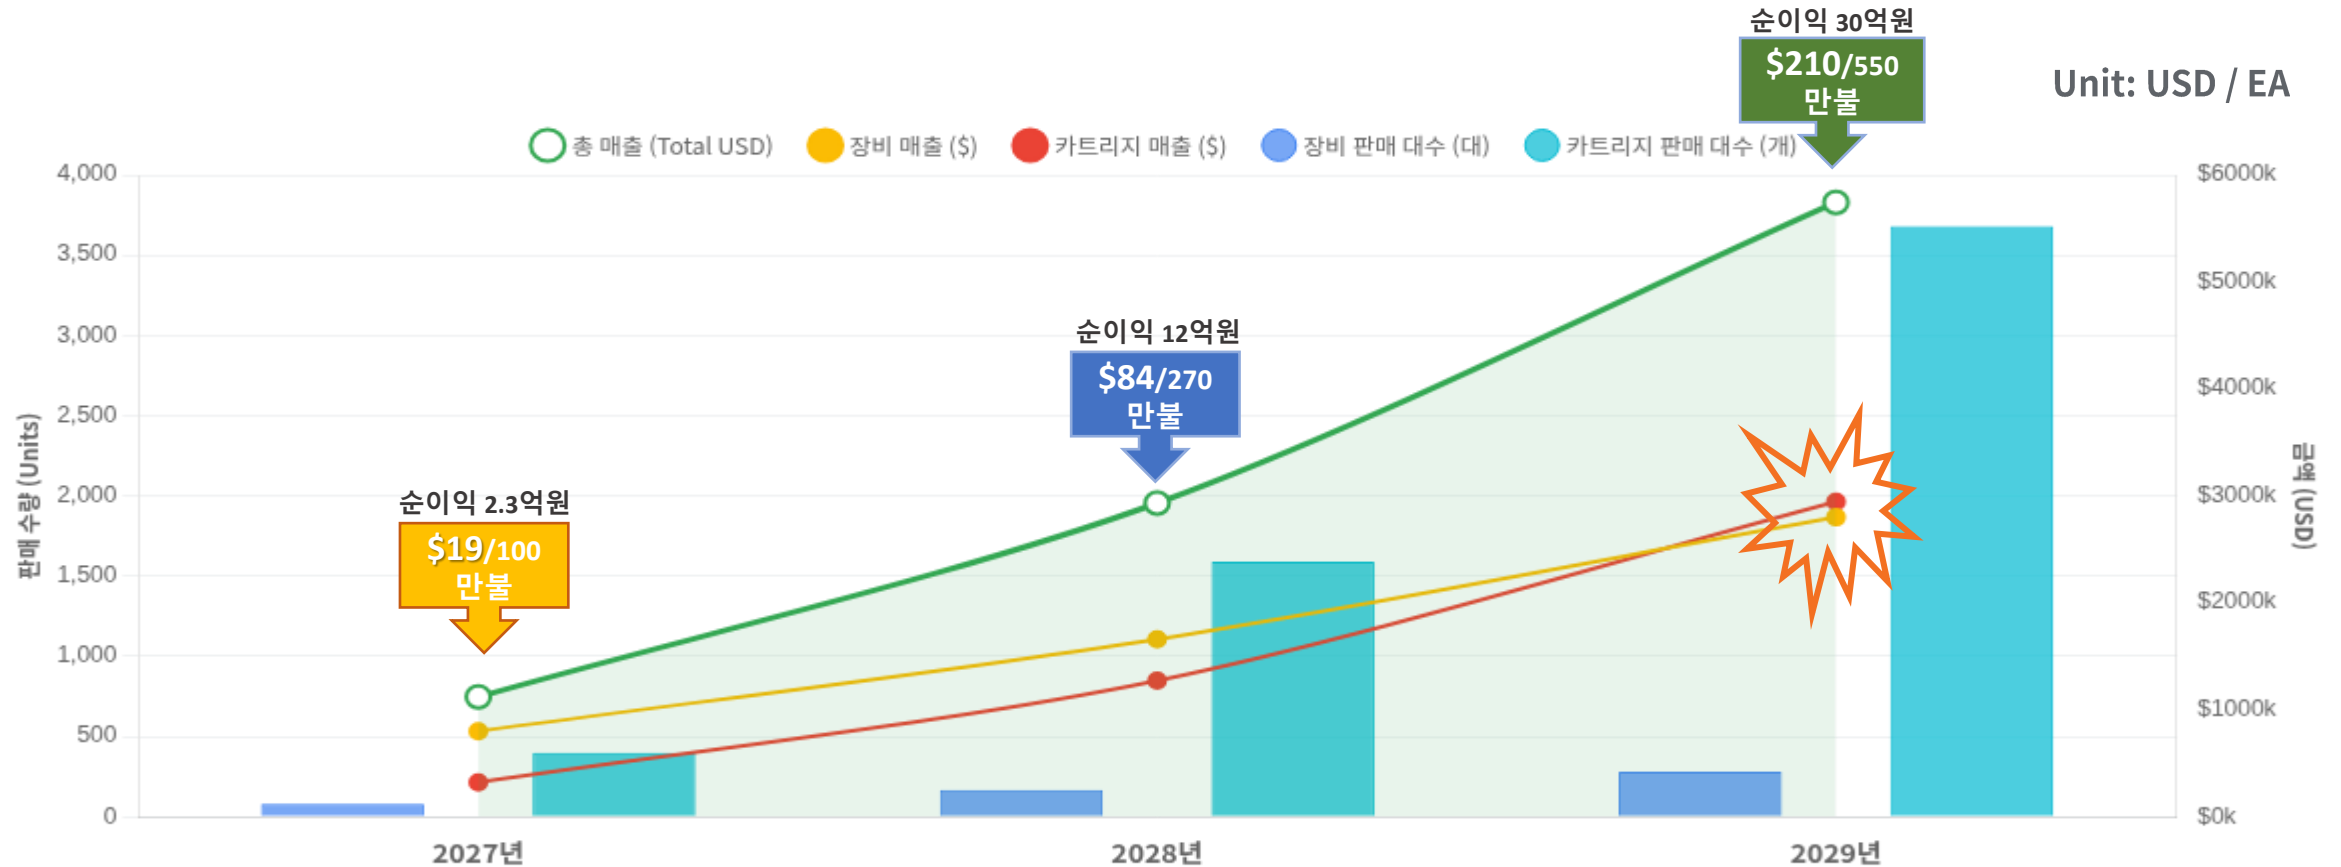

폭발적인 매출 성장세

2027년 112만 달러에서 2029년 574만 달러로, 3년 간 약 5배 이상의 총 매출 성장이 예상됩니다. (HIFU만)

소모품 중심의 수익 구조 전환

2029년 기준 카트리지 판매량(3,681개)이 장비(280대)를 압도하며, 카트리지 매출(\$2.94M)이 장비 매출(\$2.8M)을 추월하여 안정적 수익 기반을 마련합니다.

시장 확대 가속화

장비 판매 대수가 매년 약 2배씩 증가(80→166→280)하고 있어, 초기 시장 점유율 확보 전략이 성공적으로 반영되고 있음을 시사합니다.

영업이익율 50%의 근거 (Ullift 자세 제품의 원가 근거)

	파트	원가	가격	마진율
1	메인 바디 (250만원)	₩ 4,650,000	₩ 15,000,000 (\$9,000 ~ \$12,000)	223%
2	핸드피스 2 개 (x 30만원)			
3	카트 (60만원)			
4	기본 카트리지 5 개 (x 15만원)			
5	기타 포장 운송 등 (20만원)			
6	추가 카트리지(15만원)	₩150,000	₩ 900,000 (\$ 800)	500%

HIFU 제품을 주력으로 하는 경쟁사
모두 상장(IPO) 성공한 직접적인 원인

추가 제품 라인업 계획

제품 개발 3개년 계획

Aestheon
Embrace Your Life

3종 핵심 무기

개발완료



Ullift (2025)

증명된 비침습 강력한 리프팅
초음파 HIFU 장비

- Dual Modes (Dot & Linear)
- Dual Handpieces
- 높은 영업이익율 **50%**
- 2026년 하반기 수출 시작

개발중



Epilazer (2026)

국내 최초 3천와트
삼파장 다이오드 제모 레이저

- 전세계 미용시장의 50%: 제모
- 755nm 레이저 토닝
- 삼파장 리프팅
- 2026년 하반기 수출 시작

ENTRY



Stinger (2027)

모노폴라 & 마이크로니들
고주파 RF 복합 장비

- RF 리프팅 장비의 최선 유형
- 바늘에 대한 거부감 대비
- 가장 높은 영업이익율 **60%**

Global Market Opportunity

3종 제품의 총 시장 규모

58 ~ 70 억 달러
약 10조원

Market Segmentation

초음파 HIFU 시장 USD 25-30억

다이오드 제모레이저 시장 USD 18-25억

고주파 리프팅 시장 ~USD 15억

- ✓ 성공 미용장비 상장사들의 성공 공식
- ✓ + 제모레이저 경험 시너지


※ 앞서 말한 HIFU 상장 업체들 제모레이저 없음 (어려움)

전체 제품 수출 계획

초음파, 다이오드, 고주파 장비

Ulift (초음파HIFU)

(단위: USD)

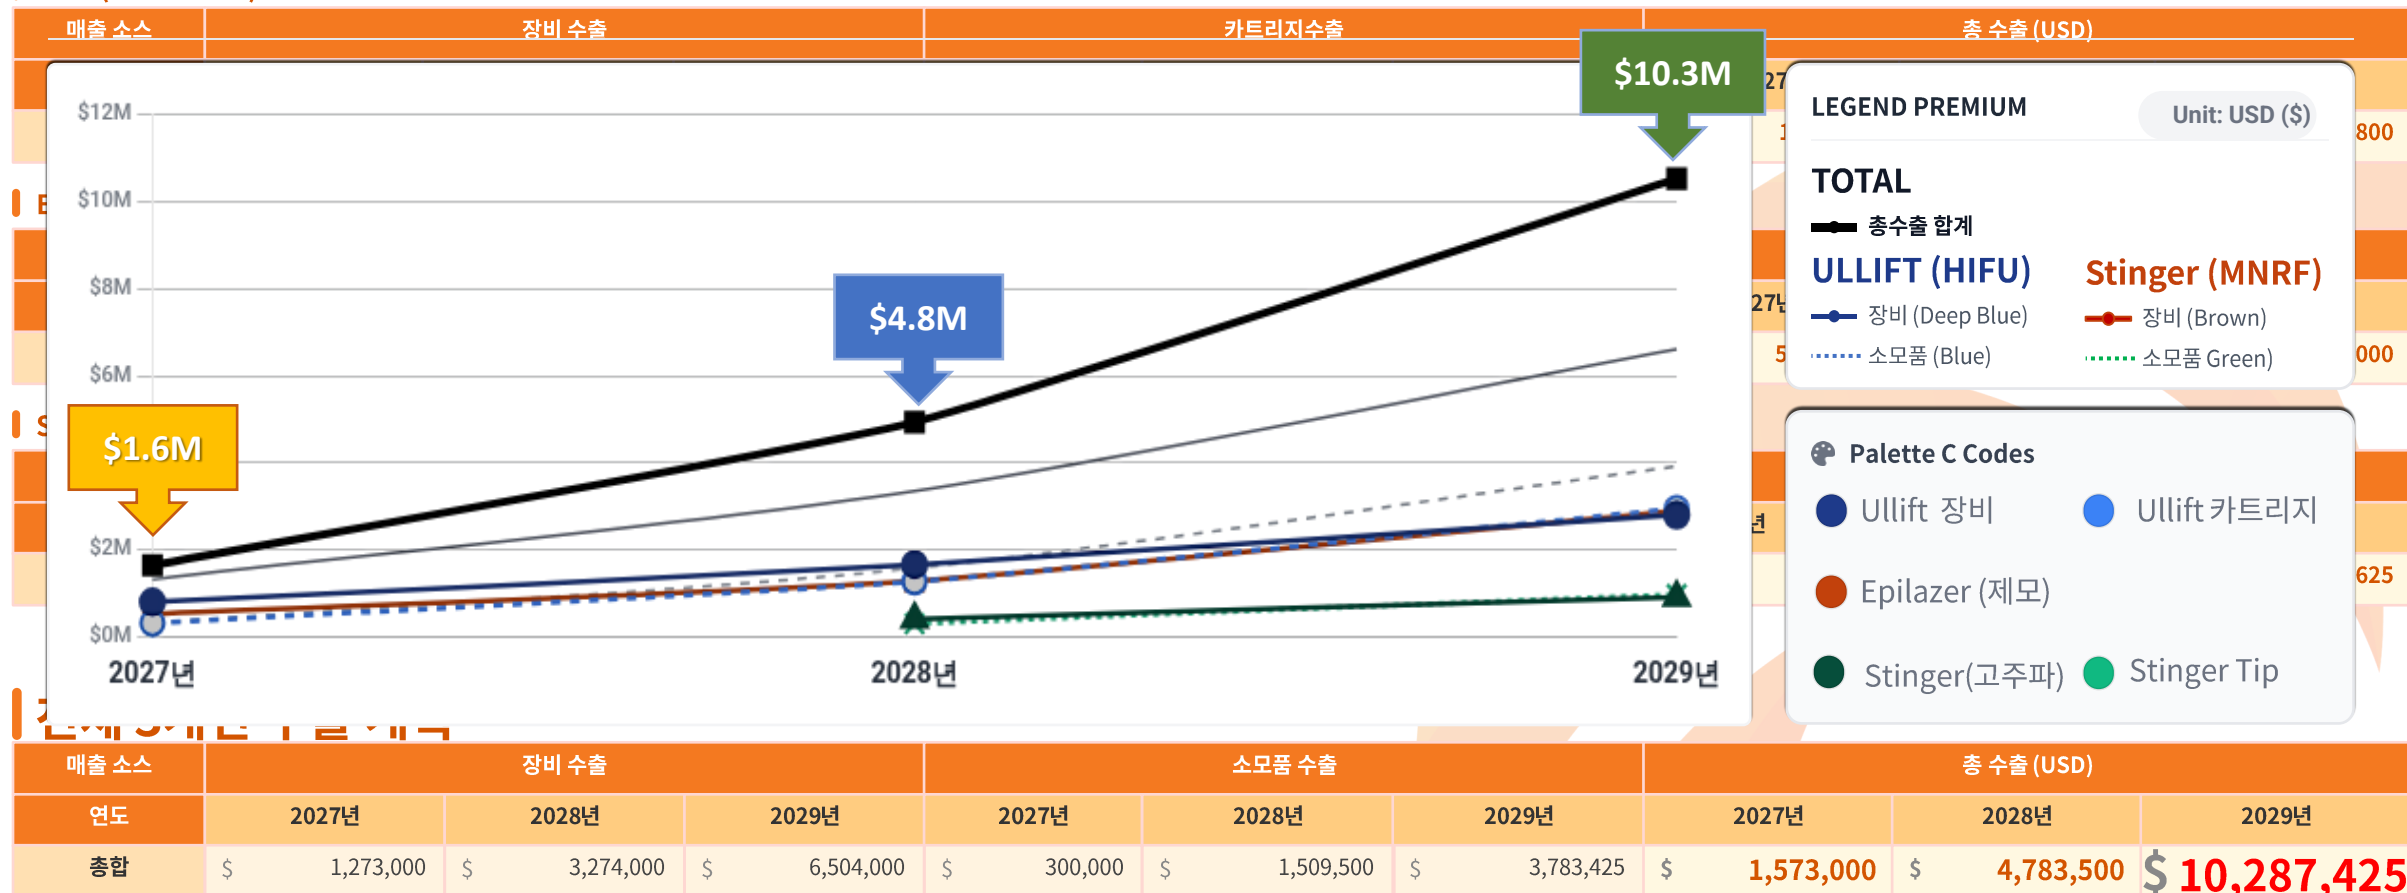

→ 목표: 클래식스 3400억 매출의 5%: 170억

→ 목표 수출액 USD 1050만불에 환율을 적용 → 약 150억 + α (국내영업)


IPO 및 Exit 전략

지속적 우상향 & 영업효율성 & 글로벌 확장

- 1) 사업현황 및 3개년 계획
- 2) 5개년 종합 성장 계획
- 3) 독점 계약 및 주문 현황

주식회사 에스떼온 사업 현황

- 2025년 03월 개발 시작 (개발비 예산 2억 4천)
- 2025년 09월 법인 설립 (자본금 2억7천)
- 2025년 12월 1차 데모 완료
- 2026년 02월 2차 데모 완료
- 2026년 03월 국제의료기기박람회(KIMES) 출품
- 2026년 04월 대표이사 유상증자 (1억 3천) – 총 자본금 4억
- 2026년 09월 두바이 학회 (Dubai Derma) 출품

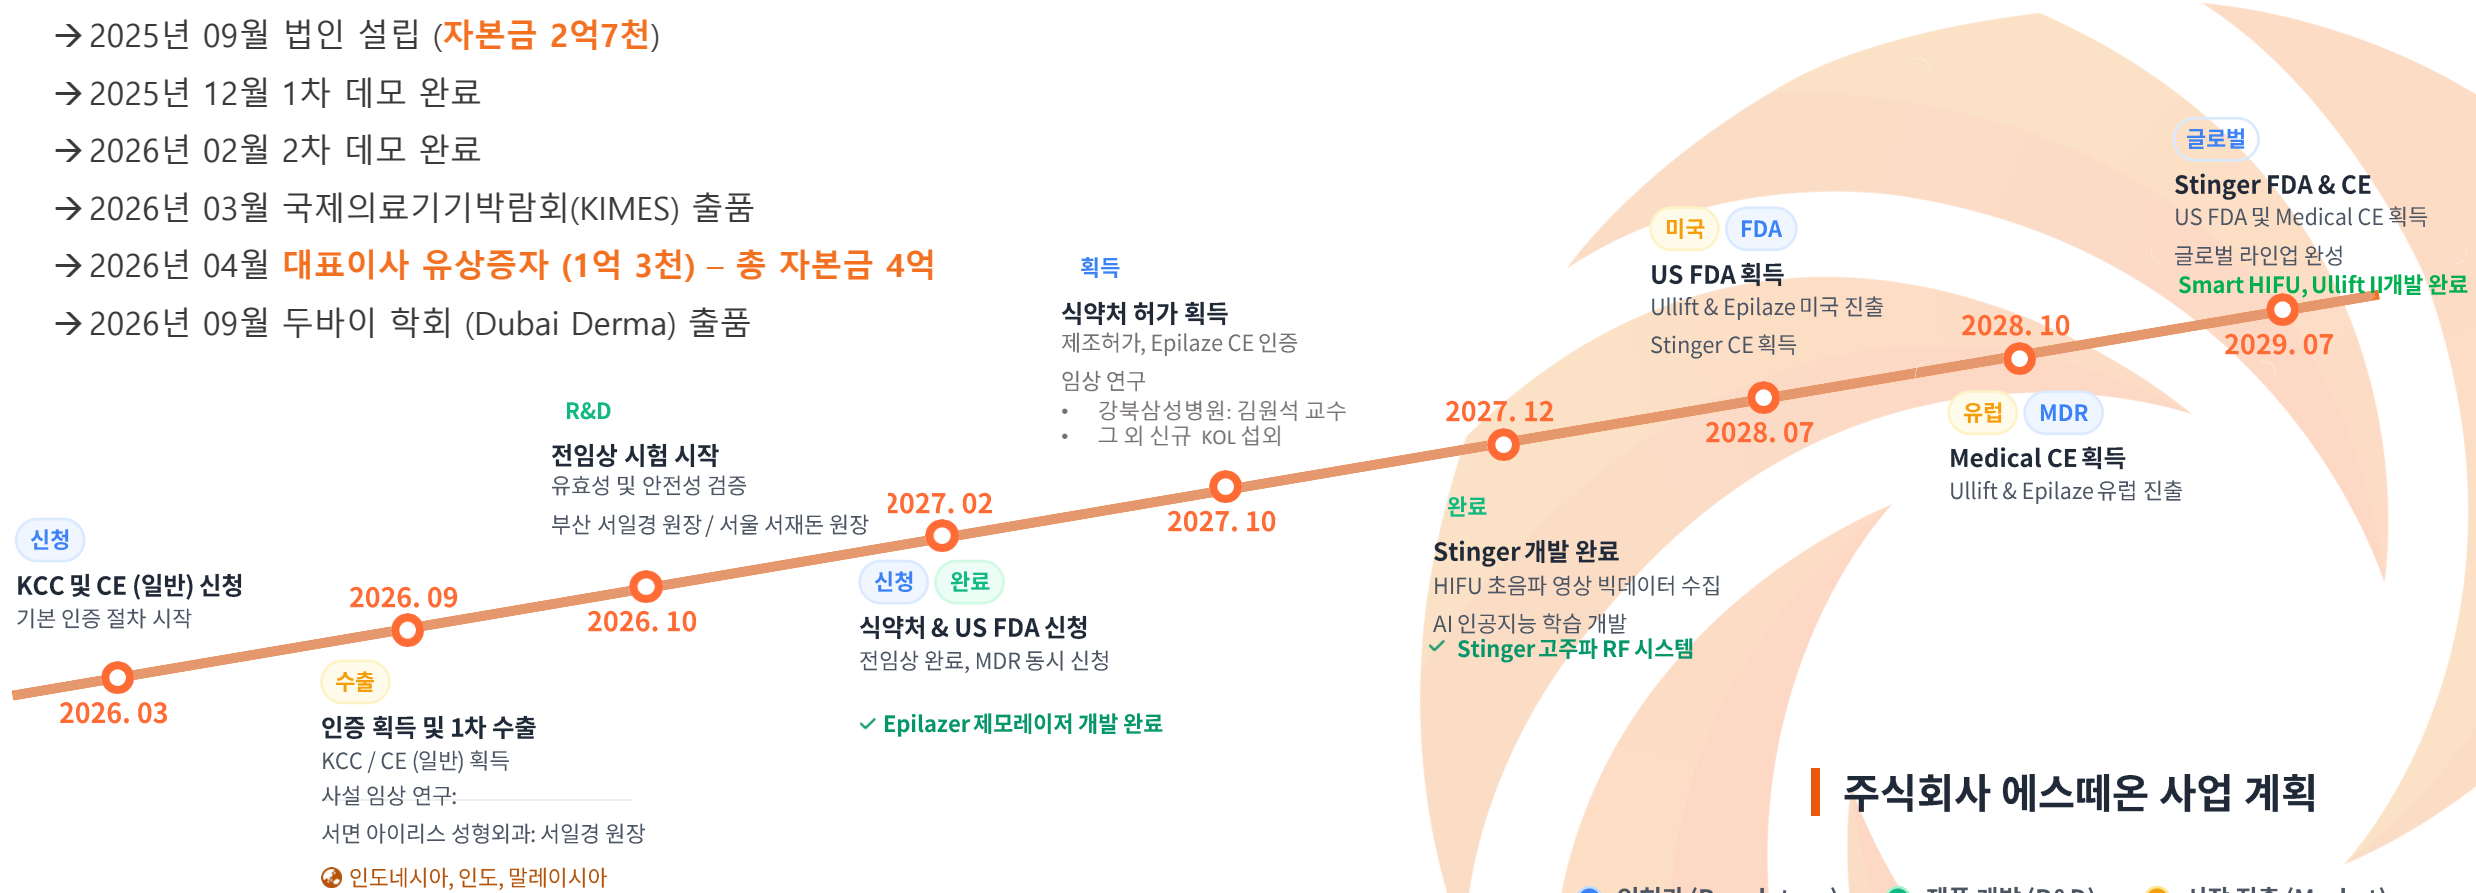

주식회사 에스떼온 사업 계획

- 인허가 (Regulatory)
- 제품 개발 (R&D)
- 시장 진출 (Market)

주식회사 에스떼온 중장기 계획



1. 인도네시아 Pt. Sinergi Bintang Milenia 독점 계약

2026년 4월 01일 (한국 국제 의료기기 박람회: KIMES 2026)

Contract No.: EA20260402-002CHW

AESTHEON CO., LTD.
EXCLUSIVE DEALERSHIP AGREEMENT
2026-04-01

BETWEEN
PT. SINERGI BINTANG MILENIA
ADDRESS: GRAND CIBUBUR COUNTRY RUKO FOOD PLAZA RPP 2, 6 CKEAS KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT 16966, INDONESIA
TEL: +62 821-1111-1632 / E-MAIL: ALTHUR@SINERGI-INDONESIA (HEREINAFTER "DISTRIBUTOR")

AND
AESTHEON CO., LTD.
ADDRESS: 1F, CENTERMDONG-RO 45, HAEUNDAL-GU, BUSAN 48059, RE
TEL: +82-70-4090-2027 / FAX: +82-51-742-7990 / E-MAIL: INFO@AE (HEREINAFTER "AESTHEON")

(HEREIN COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PARTIES")

Witnesseth
Whereas AESTHEON desires to appoint a distributor as its exclusive distributor specified in Exhibit 'A' hereof ("Products") for the Territory specified in article 1, sell the Products to DISTRIBUTOR for purposes of resale by DISTRIBUTOR within the Territory.

Whereas, DISTRIBUTOR desires to act as the distributor of the Products in the Territory for purposes of resale to end-users within the Territory.

Now therefore, in consideration of the promises and covenants herein contained, the Parties agree as follows.

1. Definitions
1.1 Term
The term (period of selling) is limited for **three years** after agreement is signed by the Parties. If any party wants to terminate this agreement during the term, it should provide written notice of cancellation 30 days before termination or so mutually consent.
1.2 Product
"Products" mean Aesthetic & Medical Treatment Systems of AESTHEON hereof, which may be changed from time to time by written mutual agreement.

1 / 10

Exclusive Dealership Agreement

Contract No.: EA20260402-002CHW

Aestheon
P R E S E N T S

11.4 Notices
Any notice herein required or permitted to be given will be in writing, in the English language, and may be personally served, sent via electronic mail (email), sent by facsimile machine, sent by an internationally recognized mail courier service, or sent by certified mail, return receipt requested. Said notice will be deemed to have been given if personally served, when served, or if by e-mail or facsimile machine, immediately upon e-mail or facsimile transmission, respectively, or if mailed on the third business day after deposit to the internationally recognized mail courier company or in the mail with air mail postage, prepaid and properly addressed. For the purposes hereof, the addresses of the parties hereto (until a notice of change thereof is given as provided for in this clause) will be as those set forth at the beginning of this Agreement.

11.5 Language
The official text of this Agreement shall be the English language, and any interpretation or construction of this Agreement shall be based thereon. If this Agreement or any documents or notices relating to it are translated into another language, the English version shall be controlling in the event of discrepancy between the two.

11.6 Title and Readings
The title and headings of the articles, sub-articles, paragraphs, and clauses of this Agreement are for convenience of reference only and shall not affect the construction of any provision of this Agreement.

11.7 Counterparts and Signatures
This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which taken together shall constitute but the same instrument. Any signature on any notice or other document executed in connection with this Agreement may be transmitted by facsimile or scanned and emailed PDF or TIF copy as executed shall be treated for all purposes as an original document.

IT IS AGREED:
Aestheon Co., Ltd.

Signed by President
Name: Howoong Choi
Date: April 1, 2026

Pt. Sinergi Bintang Milenia.

Signed by CEO
Name: Anastasia Yuli Susanti
Date: April 1, 2026

9 / 10

Exclusive Dealership Agreement / EA20260402-002CHW

수출 시기: 2026년 10월 CE 획득 시점

그 외 4~5개 업체 딜러쉽 논의 중 (Dubai Derma 전시 이후 2~3곳 확보 예상)

2. 대만 PrimeStar Medical 독점 계약

2026년 4월 01일 (한국 국제 의료기기 박람회: KIMES 2026)

Contract No.: EA20260402-001CHW

AESTHEON CO., LTD.
EXCLUSIVE DEALERSHIP AGREEMENT
2026-04-01

BETWEEN
PRIMESTAR MEDICAL CO., LTD.
ADDRESS: 10F-2, NO. 90, SEC. 1, JIANGUO N. RD., ZHONGSHAN DISTRICT, TAIPEI 104, TAIWAN
TEL: +886 939 076000 / E-MAIL: BENSON@PSM (HEREINAFTER "DISTRIBUTOR")

AND
AESTHEON CO., LTD.
ADDRESS: 1F, CENTERMDONG-RO 45, HAEUNDAL-GU, BUSAN 48059, RE
TEL: +82-70-4090-2027 / FAX: +82-51-742-7990 / E-MAIL: INFO@AE (HEREINAFTER "AESTHEON")

(HEREIN COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PARTIES")

Witnesseth
Whereas AESTHEON desires to appoint a distributor as its exclusive distributor specified in Exhibit 'A' hereof ("Products") for the Territory specified in article 1, sell the Products to DISTRIBUTOR for purposes of resale by DISTRIBUTOR within the Territory.

Whereas, DISTRIBUTOR desires to act as the distributor of the Products in the Territory for purposes of resale to end-users within the Territory.

Now therefore, in consideration of the promises and covenants herein contained, the Parties agree as follows.

1. Definitions
1.1 Term
The term (period of selling) is limited for **three years** after agreement is signed by the Parties. If any party wants to terminate this agreement during the term, it should provide written notice of cancellation 30 days before termination or so mutually consent.
1.2 Product
"Products" mean Aesthetic & Medical Treatment Systems of AESTHEON hereof, which may be changed from time to time by written mutual agreement.

1 / 10

Exclusive Dealership Agreement

Contract No.: EA20260402-001CHW

Aestheon
P R E S E N T S

11.4 Notices
Any notice herein required or permitted to be given will be in writing, in the English language, and may be personally served, sent via electronic mail (email), sent by facsimile machine, sent by an internationally recognized mail courier service, or sent by certified mail, return receipt requested. Said notice will be deemed to have been given if personally served, when served, or if by e-mail or facsimile machine, immediately upon e-mail or facsimile transmission, respectively, or if mailed on the third business day after deposit to the internationally recognized mail courier company or in the mail with air mail postage, prepaid and properly addressed. For the purposes hereof, the addresses of the parties hereto (until a notice of change thereof is given as provided for in this clause) will be as those set forth at the beginning of this Agreement.

11.5 Language
The official text of this Agreement shall be the English language, and any interpretation or construction of this Agreement shall be based thereon. If this Agreement or any documents or notices relating to it are translated into another language, the English version shall be controlling in the event of discrepancy between the two.

11.6 Title and Readings
The title and headings of the articles, sub-articles, paragraphs, and clauses of this Agreement are for convenience of reference only and shall not affect the construction of any provision of this Agreement.

11.7 Counterparts and Signatures
This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which taken together shall constitute but the same instrument. Any signature on any notice or other document executed in connection with this Agreement may be transmitted by facsimile or scanned and emailed PDF or TIF copy as executed shall be treated for all purposes as an original document.

IT IS AGREED:
Aestheon Co., Ltd.

Signed by President
Name: Howoong Choi
Date: April 1, 2026

PRIMESTAR MEDICAL CO., LTD.

Signed by President
Name: Howoong Choi
Date: April 1, 2026

9 / 10

Exclusive Dealership Agreement

수출시기: 한국 식약처 승인 시점 (KFDA 필요)

선주문 입금 1차 확보 (45,000 USD)



Aestheon
Embrace Your Life

오래 경칭해주셔서 감사합니다.

2030까지 170억 매출 70억 순이익으로 2000억 회사가치 달성

Innovating Timeless Money Maker

금번 지원으로 부산의 유일의 그러나 한국을 넘어 세계 최고의 Aesthetic 전문
업체로 성장하겠다는 약속을 드립니다.



CONTACT

070-4090-2027

billchoi@aestheon.com



ADDRESS

부산광역시 해운대구 센텀동로 45 1층
(주)에스떼온



WEBSITE

www.aestheon.com