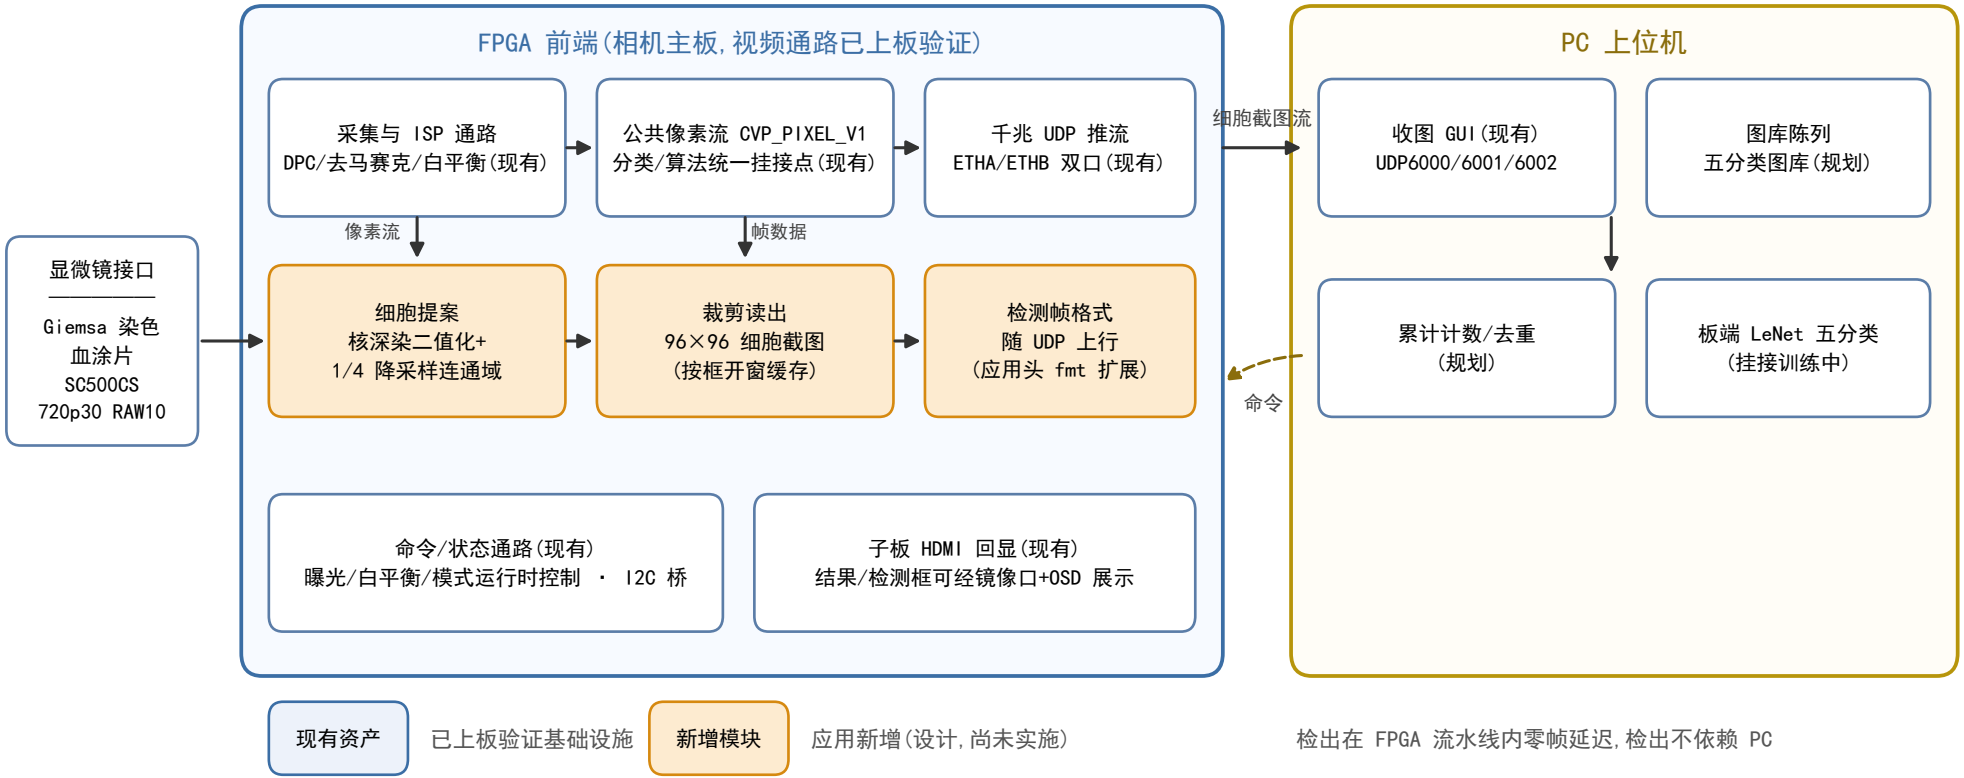
显微镜接口
Giemsa 染色
血涂片
SC500CS
720p30 RAW10
FPGA 前端(相机主板,视频通路已上板验证)
采集与 ISP 通路
DPC/去马赛克/白平衡(现有)
公共像素流 CVP_PIXEL_V1
分类/算法统一挂接点(现有)
千兆 UDP 推流
ETHA/ETHB 双口(现有)
像素流
帧数据
细胞提案
核深染二值化+
1/4 降采样连通域
裁剪读出
96×96 细胞截图
(按框开窗缓存)
检测帧格式
随 UDP 上行
(应用头 fmt 扩展)
命令/状态通路(现有)
曝光/白平衡/模式运行时控制 · I2C 桥
子板 HDMI 回显(现有)
结果/检测框可经镜像口+OSD 展示
细胞截图流
命令
PC 上位机
收图 GUI(现有)
UDP6000/6001/6002
图库陈列
五分类图库(规划)
累计计数/去重
(规划)
板端 LeNet 五分类
(挂接训练中)
现有资产
已上板验证基础设施
新增模块
应用新增(设计,尚未实施)
检出在 FPGA 流水线内零帧延迟,检出不依赖 PC