PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA			PENGELOLAAN ALAT *SINGLE USE REUSE*		
Status Dokumen	**Status Review**	**Status Revisi**	**Tanggal Terbit**	**Tanggal Efektif**	**Tanggal Peninjauan Kembali**
Baru	00	00	20 Januari 2026	20 Februari 2026	20 Januari 2029

Riwayat Revisi

Revisi	Penanggung Jawab	No Dokumen	Uraian Perubahan
00	KPI	SPO/PHBW/KPI-064	-

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA	**PENGELOLAAN ALAT** ***SINGLE USE REUSE***		
	No. Dokumen: SPO/PHBW-/KPI-064	Revisi: 00	Halaman: 1/5
SPO	Tanggal Terbit: 20 Januari 2026	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit PRIMAYA HOSPITAL BHAKTI WARA **dr. AGUS MARVIANTO**	
PENGERTIAN	Pengelolaan peralatan medis/bahan medis habis pakai (BMHP) yang sudah digunakan kemudian dilakukan pemrosesan ulang untuk digunakan kembali.		
TUJUAN	1. Menjamin Keamanan dan efektivitas alat reuse 2. Menekan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan efisiensi biaya dengan memperhatikan keselamatan pasien 4. Memastikan proses reuse sesuai standar mutu, etika dan regulasi		
KEBIJAKAN	1. Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/II/2025 Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya 2. Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 089/PER/DIR/PHBW/I/2026 tentang Panduan Peralatan Medis/Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Yang di Gunakan Kembali (Re-Use) Rumah Sakit Primaya.		
PROSEDUR	1. Pengumpulan Alat Pasca Pakai: a. Petugas unit gunakan alat pelindung diri masker dan sarung tangan, melakukan *Point of use* dengan cara: bersihkan bagian luar alat dengan kasa yang dibasahi dan bagian		

CONTROLLED

PROSEDUR

lumen disemprot menggunakan syringe yang berisi cairan wfi dan heparin sampai dengan cairan yang keluar jernih.

b. Lakukan pemeriksaan visual cepat untuk mendeteksi kerusakan alat

c. Pisahkan alat dan segera buang ke dalam tempat sampah infeksius bila terdapat kerusakan

d. Masukan alat kedalam kemasannya kembali dan letakkan kedalam *container* tertutup sesuai dengan warna yang sudah disediakan:
   Hijau : *reuse* ke 1
   Kuning : *reuse* ke 2
   Orange : *reuse* ke 3

e. Antar alat ke CSSD, kurang dari 60 menit sejak POU Care

2. *Pre cleaning* dan cleaning

a. Petugas CSSD melakukan kebersihan tangan.

b. Petugas CSSD menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan) menerima alat dan memeriksa alat sesuai visual memastikan tidak ada darah / kotoran.

c. Petugas CSSD menggunakan alat pelindung diri lengkap (masker, sarung tangan rumah tangga sesuai ukuran, apron, google, topi pelindung, sepatu boot) saat proses pre cleaning dan cleaning

d. Petugas CSSD melakukan perendaman alat

CONTROLLED
CONTROLLED DOCUMENT

PROSEDUR

yang berasal dari *container* dengan larutan enzymatic mengikuti petunjuk pabrik dan sesuai warna *container* secara bergantian (tidak bersamaan dengan isi *container* lain).

e. Petugas CSSD melakukan proses penyikatan alat di dalam larutan enzymatik atau permukaan air dan sikat satu arah menggunakan sikat yang sesuai dan tidak merusak alat. Selanjutnya semprotkan air bertekanan untuk menghilangkan kotoran.

f. Petugas CSSD membilas semua peralatan secara menyeluruh hingga tidak ada bau.

g. Petugas CSSD memastikan kondisi alat kesat/tidak licin dan tidak ada kotoran atau residu yang tersisa.

h. Keringkan alat menggunakan *air gun, drying cabinet.*

3. Pemeriksaan Kelayakan dan Fungsi alat

a. Petugas CSSD Melakukan inspeksi kelayakan alat secara visual menggunakan *magnifying lamp* dan menggunakan perabaan.

b. Pastikan alat utuh, tidak tumpul, tidak patah, tidak retak, dan tidak berubah warna, tidak king-king.

c. Alat yang tidak layak di buang ke tempat sampah medis.

d. Lakukan pencatatan kelayakan alat.

CONTROLLED
CONTROLLED DOCUMENT

PROSEDUR

4. Pelabelan dan pengemasan
   a. Alat yang sudah lolos uji kelayakan dan uji fungsi diberi penanda menggunakan karet sesuai dengan warna *re-use.*
   b. Masukkan alat ke dalam *pouches,* berikan internal indikator lalu segel.
   c. Alat yang sudah di *pouches* ditempel stiker warna pada kemasan luar *pouches.*

      Hijau : *reuse* ke 1

      Kuning: *reuse* ke 2

      Orange: *reuse* ke 3
   d. Berikan penanda tanggal sterilisasi dan tanggal kadaluawarsa serta stiker penanda *reuse* sesuai warna.
5. Proses sterilisasi

   Lakukan sterilisasi dengan *Ethylene Oxide (EO)* atau Plasma.
6. Penyimpan

   Simpan alat yang sudah steril di lemari penyimpanan alat dengan suhu dan kelembaban yang sesuai berdasarkan kelompok alatnya.
7. Pencatatan dan Pelacakan Alat *Reuse*
   a. Petugas unit melakukan pencatatan semua pasien yang menggunakan alat medis/ BMHP yang digunakan kembali di lembar monitoring pasien.

CONTROLLED
CONTROLLED DOCUMENT

PROSEDUR	b. Petugas menempelkan bukti indikator internal dan eskternal sterilisasi dan No. Lot dilembar kondisi sterilisasi, untuk dapat di lakukan pelacakan alat *reuse* jika terjadi infeksi pada pasien.
UNIT TERKAIT	1. Unit Kamar Bedah 2. Unit Rawat Inap dan Rawat Jalan 3. Unit CSSD
REFERENSI	1. *Indian Heart Journal* 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 3. *AAMI ST79:2023 Section on reprocessing of single -use items* 4. WHO 2023 *Reprocessing Guidelines*

CONTROLLED
CONTROLLED DOCUMENT

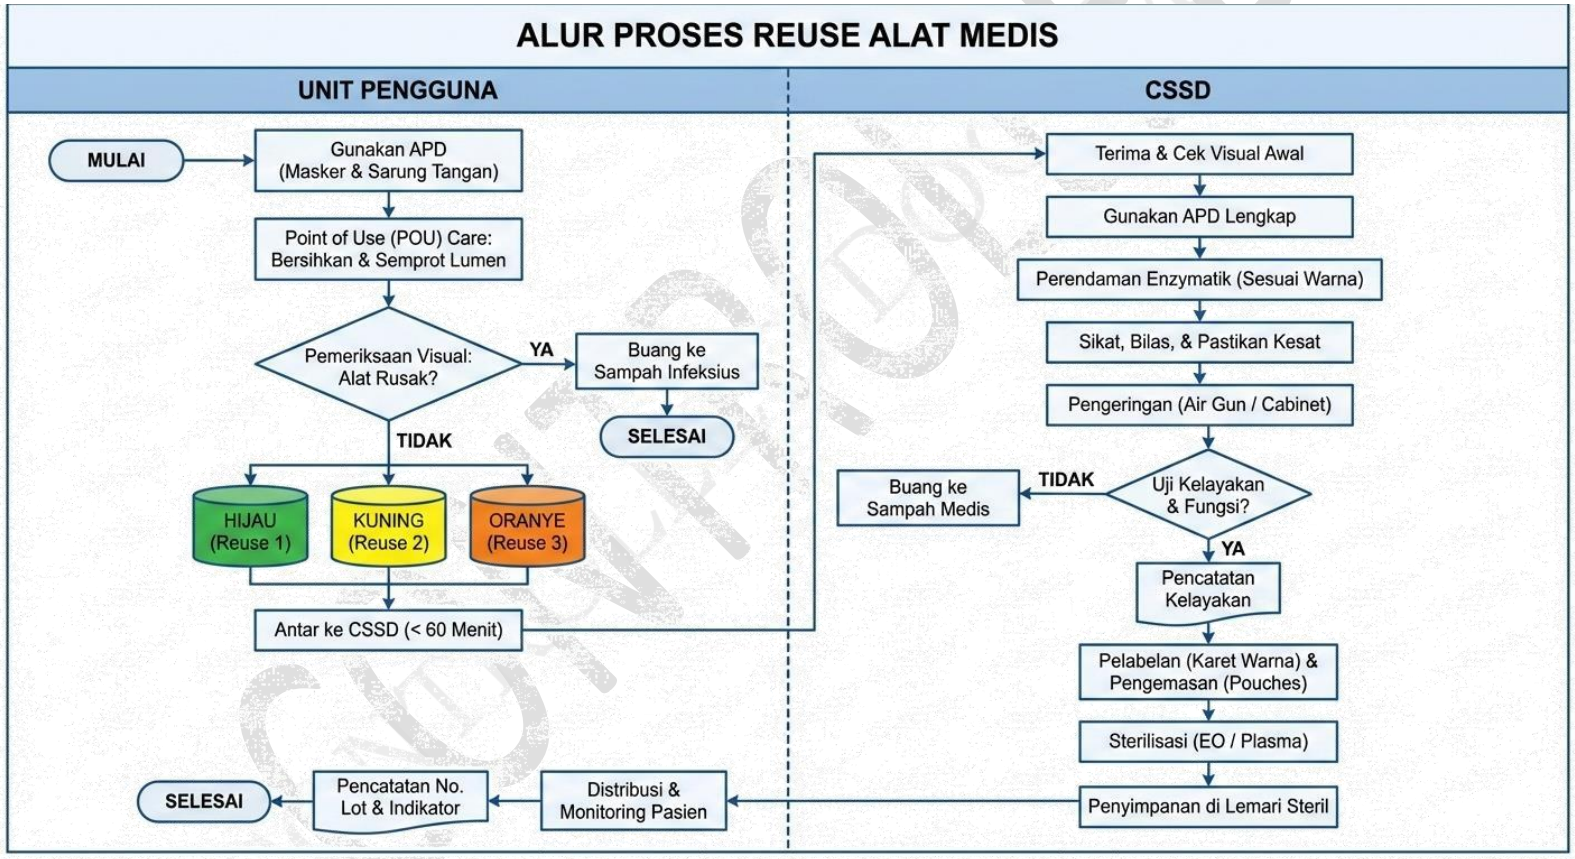
ALUR PROSES REUSE ALAT MEDIS
UNIT PENGGUNA
CSSD
MULAI
Gunakan APD (Masker & Sarung Tangan)
Point of Use (POU) Care: Bersihkan & Semprot Lumen
Pemeriksaan Visual: Alat Rusak?
YA
Buang ke Sampah Infeksius
SELESAI
TIDAK
HIJAU (Reuse 1)
KUNING (Reuse 2)
ORANYE (Reuse 3)
Antar ke CSSD (< 60 Menit)
Terima & Cek Visual Awal
Gunakan APD Lengkap
Perendaman Enzymatik (Sesuai Warna)
Sikat, Bilas, & Pastikan Kesat
Pengeringan (Air Gun / Cabinet)
Uji Kelayakan & Fungsi?
TIDAK
Buang ke Sampah Medis
YA
Pencatatan Kelayakan
Pelabelan (Karet Warna) & Pengemasan (Pouches)
Sterilisasi (EO / Plasma)
Penyimpanan di Lemari Steril
Distribusi & Monitoring Pasien
Pencatatan No. Lot & Indikator
SELESAI

CONTROLLED