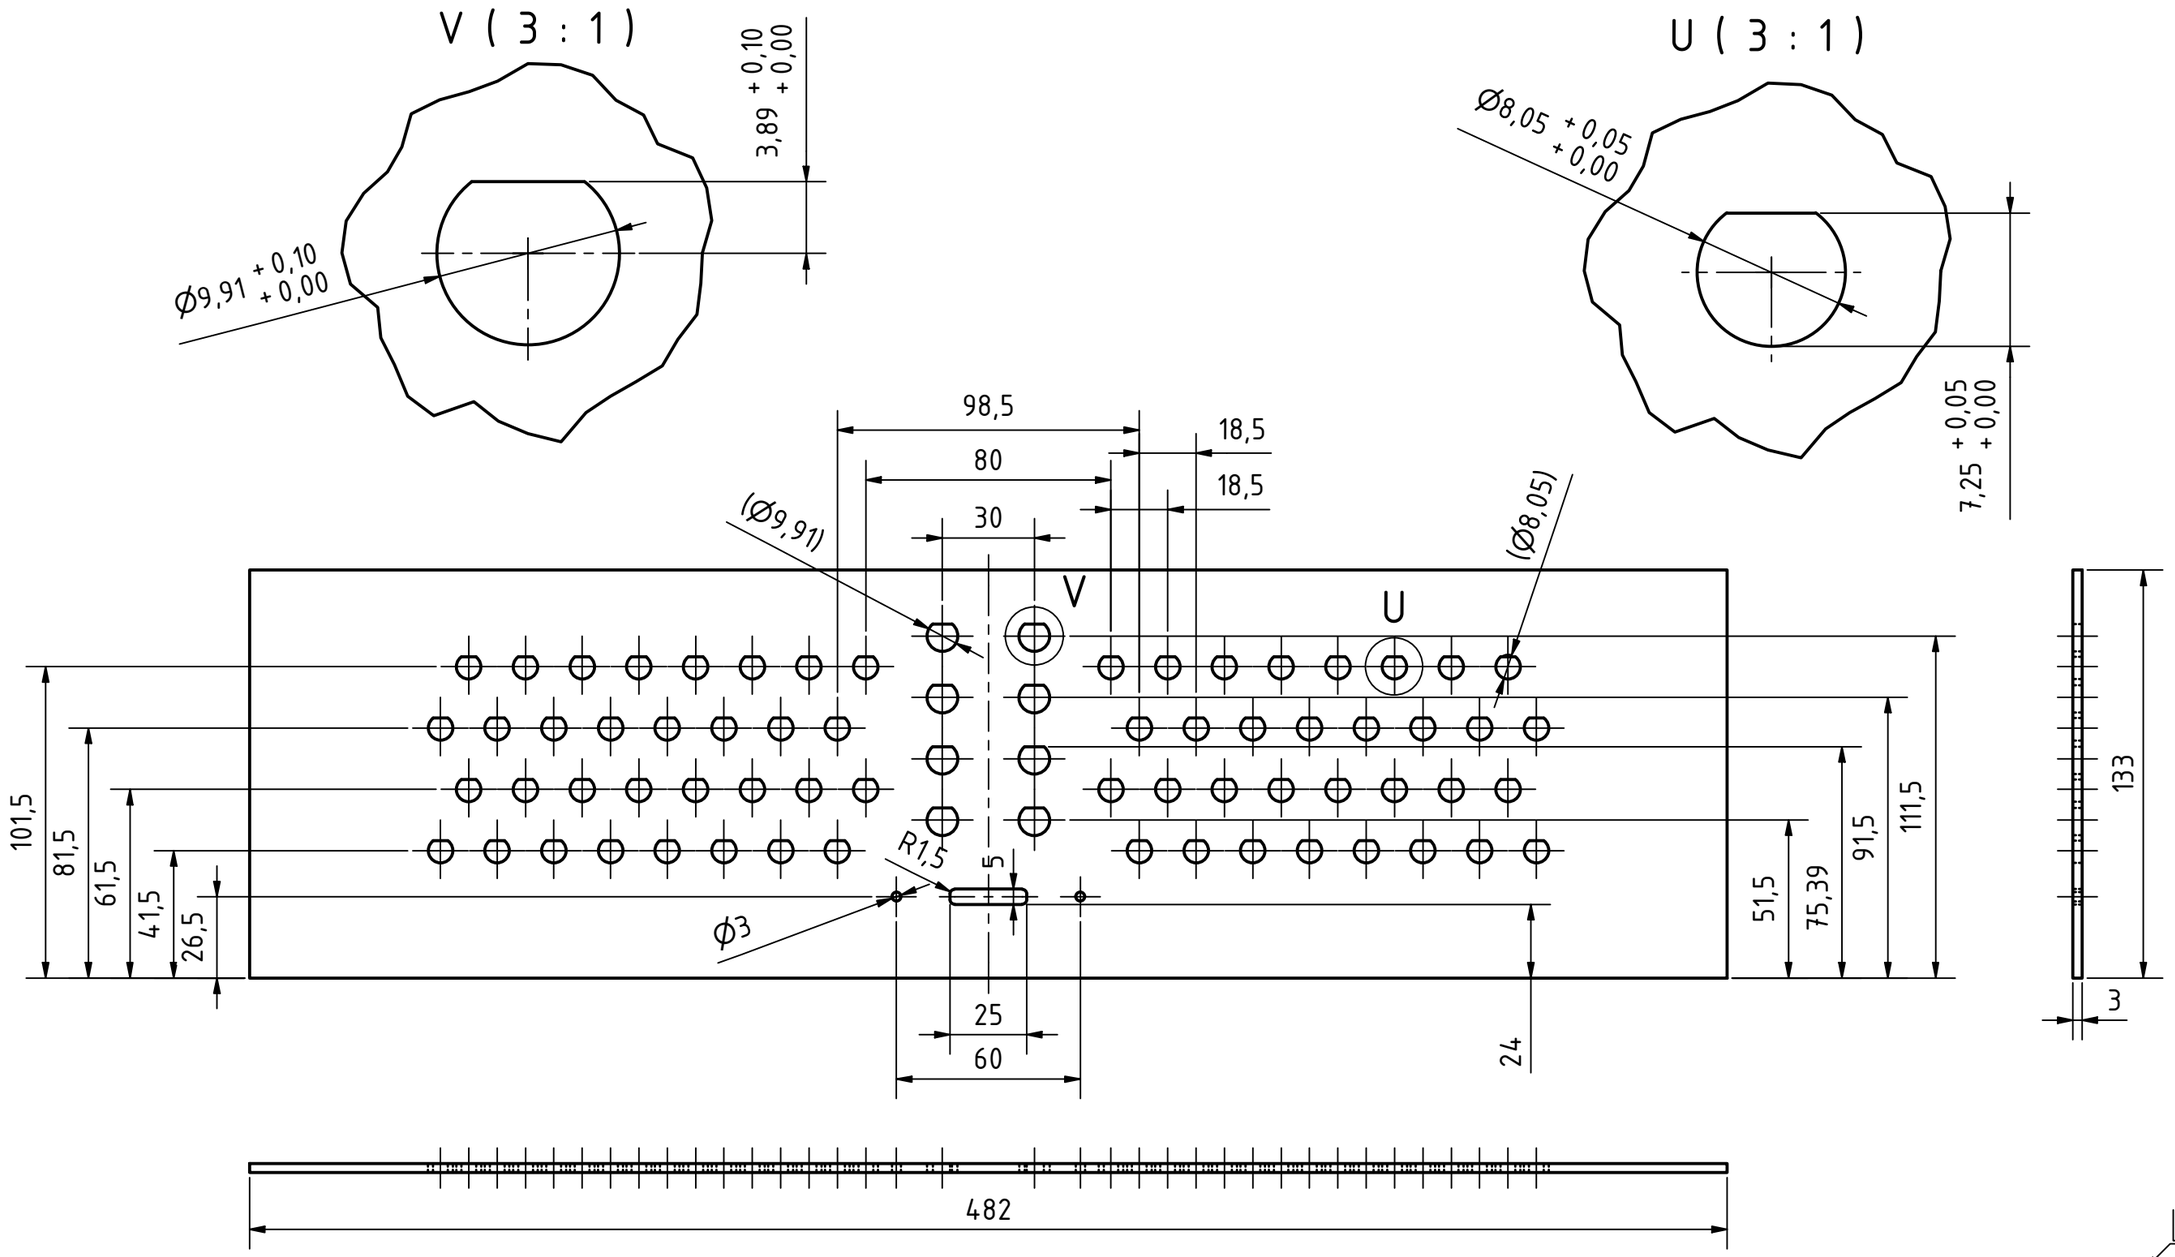

-0.3

+0.1

				Allgemein-toleranz ISO 2768-mK		Kanten ISO 13715	Maßstab: 1:2 (3:1) / Stückzahl: 1
							Werkstoff: Aluminium Halbzeug:
					Date	Name	
				Drawn	19.05.2022	Jacopo DS	Rydberg Strontium/sry-public/ LabMonitoringSystemBox
				Checked			
				Standard			
				Max-Planck-Institut für Quantenoptik Hans-Kopfermann-Str. 1 85748 Garching Tel.: 089-32905-204 MPQ			FrontPanel
State	Changes	Date	Name				1 A3