Tabla de contenido

1. Objetivo 2
2. Alcance 2
3. Descripción 2
4. Requerimientos 3
4.1. Requerimientos generales de diseño 3
4. Firmas de Ms Sinergy SAS 22
Revisión por parte de Ms Sinergy SAS 22
Aprobación del proveedor: 22

1. Objetivo

Documentar los respectivos requerimientos de usuario para la creación de la página web de Ms Sinergy SAS, asegurando que se cumplan las mejores prácticas de diseño y usabilidad web, así como los estándares de accesibilidad y seguridad digital. Esta página web debe reflejar la identidad de la empresa y facilitar el acceso a la información sobre nuestros productos y servicios, optimizando la experiencia del usuario y fortaleciendo nuestra presencia en línea.

2. Alcance


La página web de Ms Sinergy SAS debe garantizar una experiencia de usuario óptima, ofreciendo información clara y accesible sobre nuestros productos y servicios.

3. Descripción

Diseñar una página web integrada para informar, optimizar y que sea trasversal para los proyectos a futuros que tenga la organización.

4. Requerimientos

4.1. Requerimientos generales de diseño

tem	Descripción	Observaciones
1	Logo: 	N.A.
2	Tipo de letra: Eras Light ITC	N.A.
3	 Paleta de colores:	N.A.
4	Idioma: español -Ingles - portugués	N.A.
5	El dominio de la página web debe ajustarse a las necesidades de la organización	N.A.
6	Debe contar con lo siguiente módulos: 1. Que es Sinergy. Anexo 1 1.1. Misión: Ms Sinergy SAS, es una organización que direcciona las áreas de metrología (magnitud de presión) y ensayos, en los sectores industriales, farmacéutico, alimentario, hospitalario y veterinario, manteniéndose a la vanguardia de las nuevas tecnologías a través de la implementación de metodologías agiles con base a una mejora continua en los procesos generando la satisfacción y desarrollo sostenible de sus clientes 1.2. Visión: La organización Ms Sinergy SAS, ejecutará para el 2024 la acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia "ONAC". del área de calibraciones obteniendo como ello la integración a nivel nacional e internacional para la prestación del servicio de metrología – magnitud de presión diferencial. El laboratorio de ensayos alinearlo a las metodologías que ONAC requiere para una futura ampliación en el esquema acreditado.	N.A.


1.3. Política de calidad: Ms Sinergy S.A.S., somos un laboratorio altamente comprometido con la calidad y la excelencia en nuestros servicios. Nos acogemos a las metodologías como: BPM, BPL, BPA Y BPD para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes. Adoptamos un enfoque de mejora continua, buscando constantemente optimizar nuestros procesos y servicios para ser más eficientes, efectivos e innovadores. Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los lineamientos establecidos por la ISO/IEC 17025:2017 y a seguir las regulaciones impuestas por entes reguladores y organizaciones que otorgan reconocimiento. Contamos con un equipo altamente capacitado y en constante formación, asegurando la competencia profesional en todas las áreas. Buscamos la mejora continua, integrando soluciones avanzadas para optimizar nuestros procesos y servicios. Mantenemos la imparcialidad, confidencialidad e integridad en nuestras operaciones. Nuestro compromiso es ofrecer resultados confiables, precisos en constante mejora, consolidándonos como líderes en la industria.

1.4. Línea del tiempo de la organización: (Imagen)

2020: Inicio de actividades con calificaciones ensayos
2021: Expansión de servicios en el territorio nacional.
2022: se inicia con la calificación de vehículos de transporte en cadena de frio.
2023: Calificación equipos de producción.
2024: Proyección Proceso de acreditación en calibración de equipos de diferencial de presión.
2025: Proyección Proceso de acreditación en magnitud de temperatura y humedad relativa



1.5. Módulo de cotización:

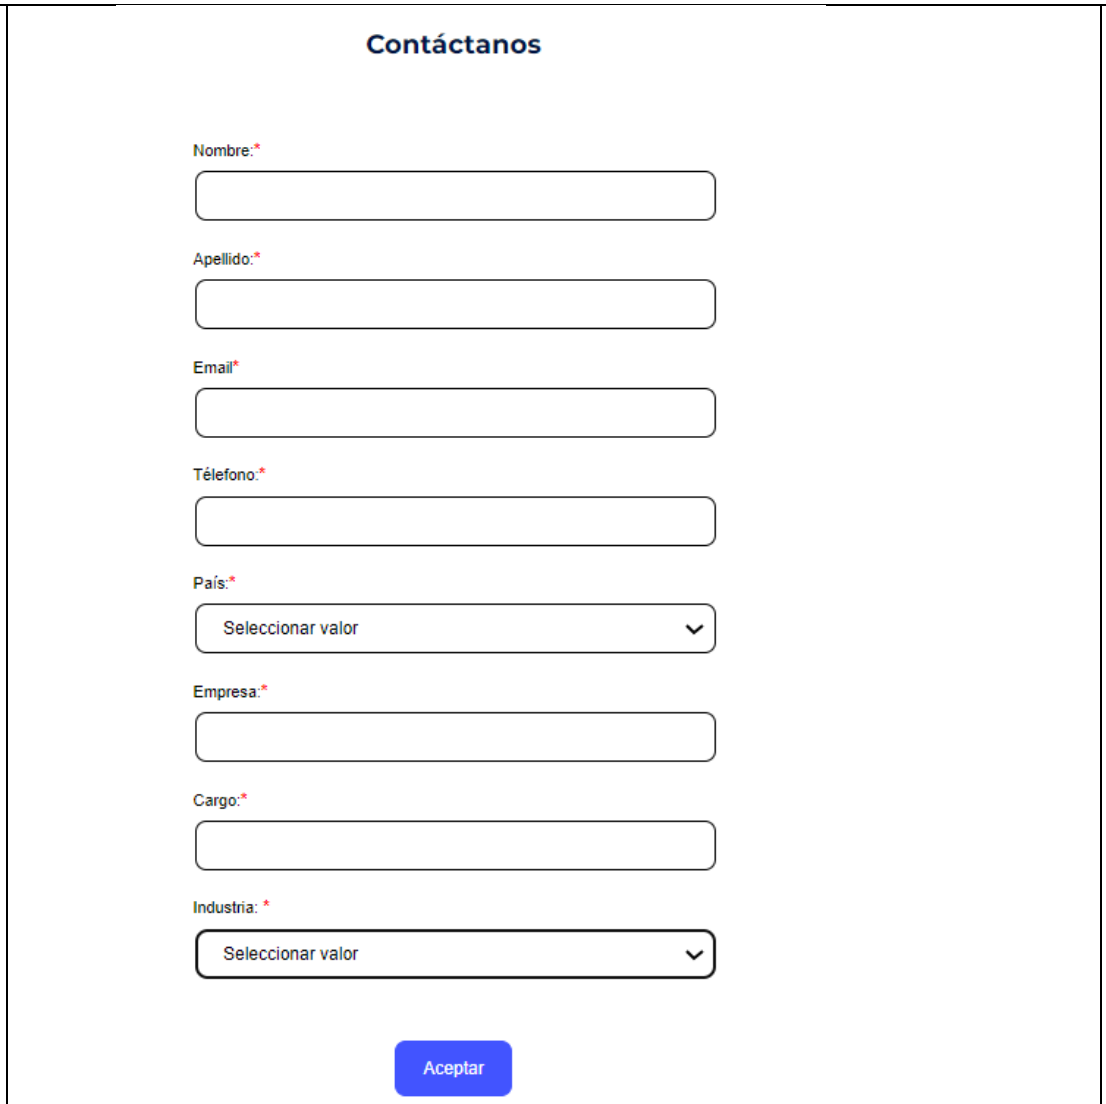

Después de empresa agregar el ítem de servicio a solicitar
Correo donde debe llegar la información: ventas@mssinergy.com

Tipo de servicio requerido

2. Servicios (Barra de inicio)



2.1. Servicio de Calibraciones: (Ítem 1 lista desplegable)

Item	Código (1)	Magnitud (2)	Sede (3)	Intervalo de medición (4)	Instrumento a calibrar (5)	Incertidumbre expandida de medida (6)	Instrumentos, equipos patrones utilizados (7)	Documento normativo (8)	Méto
1	DIGB	Presion	Carrera 7 Este 1A-32 interior 1	0 Pa ≤ p ≤ 996 Pa 0 $inH_2O \leq p \leq 4$ inH_2O	Manómetro de presion diferencial (digitales - analógicos-transmisores) clase de exactitud ≥ ± 0,5 % de escala completa	1,0 Pa (0.0041 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Directriz DKD R-6-1 Calibración de instrumentos Medidores de Presion Edición 03/2014 Revisión 3. Excepto Numeral 8.5	Ca
2	DIGB	Presion	in situ	0 Pa ≤ p ≤ 996 Pa 0 $inH_2O \leq p \leq 4$ inH_2O	Manómetro de presion diferencial (digitales - analógicos-transmisores) clase de exactitud ≥ ± 0,5 % de escala completa	1,0 Pa (0.0041 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Directriz DKD R-6-1 Calibración de instrumentos Medidores de Presion Edición 03/2014 Revisión 3. Excepto Numeral 8.5	Ca
3	DIGB	Presion	Carrera 7 Este 1A-32 interior 1	0 Pa ≤ p ≤ 50 Pa (0 $inH_2O \leq p \leq 0.2$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	1,1 Pa (0.0045 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca
4	DIGB	Presion	Carrera 7 Este 1A-32 interior 2	50 Pa < p ≤ 124 Pa (0.2 $inH_2O < p \leq 0.5$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	1,8 Pa (0.0072 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca
5	DIGB	Presion	Carrera 7 Este 1A-32 interior 3	124 Pa < p ≤ 747 Pa (0.5 $inH_2O < p \leq 3$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	3,0 Pa (0.012 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca
6	DIGB	Presion	in situ	0 Pa ≤ p ≤ 50 Pa (0 $inH_2O \leq p \leq 0.2$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	1,1 Pa (0.0046 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca
7	DIGB	Presion	in situ	50 Pa < p ≤ 124 Pa (0.2 $inH_2O < p \leq 0.5$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	1,8 Pa (0.0073 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca
8	DIGB	Presion	in situ	124 Pa < p ≤ 747 Pa (0.5 $inH_2O < p \leq 3$ inH_2O)	Manómetros de columna de líquido clase de exactitud ≥ ± 3 % de escala completa	3,0 Pa (0.012 inH_2O)	Manómetros digitales de presión diferencial Clase de exactitud ± 0,5 % de escala completa	Procedimiento ME-021 para la calibración de columnas de líquido manométricas y barométricas Centro español de metrología	Ca

Laboratorio de Presión diferencial: Ms Sinergy ofrece el servicio en esta variable para calibración Manómetro digital, manómetro analógico transmisor de presión y columna de líquido con un alcance de medición desde 0 inH2O hasta 4inH2O. (Descripción).

2.1.1. Laboratorio de temperatura: (Ítem 2 lista desplegable)

En construcción

.

2.1.2. Laboratorio de humedad relativa (Ítem 3 lista desplegable)

En construcción

2.2. Servicio de calificaciones (Ítem 4 lista desplegable)

2.2.1 Calificación de sistemas de apoyo critico

Con una duración de la calificación de 24 horas y/o 48 horas de acuerdo con los protocolos establecidos.

- Integridad de filtros HEPA.
- Medición de caudal de suministro y extracción.
- Cálculo de cambios hora.
- Medición de calidad de aire.
- Medición de diferenciales de presión.

	• Pruebas de humo.   Balómetro GTI 620	



Fotómetro de aerosol modelo 3991

2.2.1 Calificaciones isotérmicos

La calificación es el proceso mediante el cual se verifica que un equipo o sistema cumple con sus especificaciones y requisitos establecidos. Es un componente del proceso de aseguramiento de calidad.
Busca asegurar que el equipo o sistema funcione correctamente y de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las necesidades del usuario. La calificación generalmente se realiza para garantizar que un equipo esté en condiciones adecuadas de operación.

Tipos de calificación

- Calificación de Diseño (DQ): Verifica que el diseño del equipo o sistema cumpla con las especificaciones y requisitos del usuario.
- Calificación de Instalación (IQ): Asegura que el equipo o sistema esté instalado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Calificación Operacional (OQ): Verifica que el equipo o sistema funcione de acuerdo con sus especificaciones bajo condiciones operativas normales.
- Calificación de Desempeño (PQ): Asegura que el equipo o sistema funcione correctamente en condiciones de uso normales y cumpla con las expectativas del usuario.

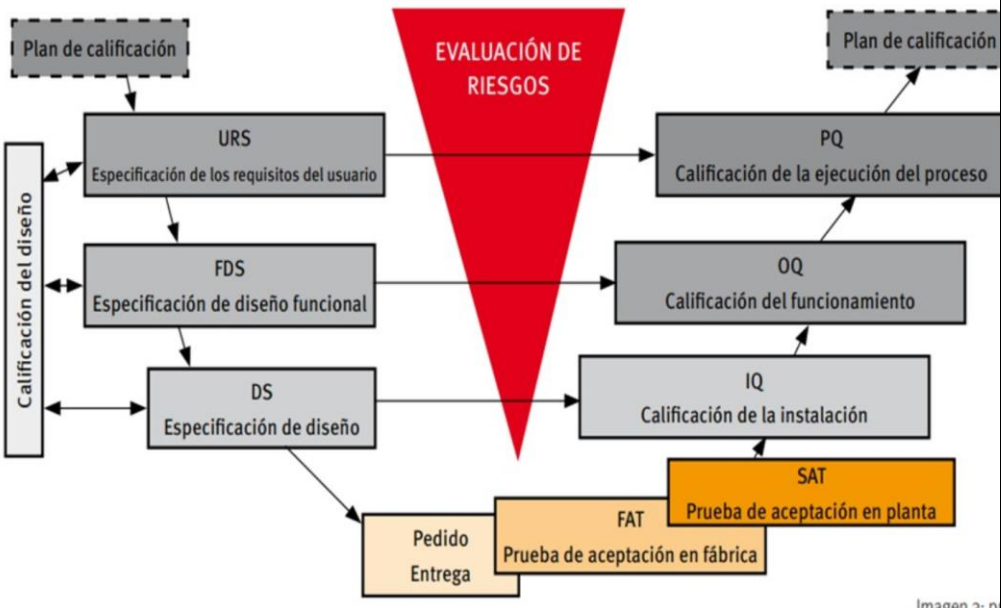


Imagen 3: p

Equipos a calificar

- Baños Maria.
- Cámaras de estabilidad.
- Cámaras de esterilización de óxido de etileno.
- Congeladores.
- Cuartos fríos
- Horno de secado.
- Incubadoras.
- Marmitas- Tanques de preparación
- Perfiles de temperatura y humedad.
- Refrigeradores.
- Ultra congeladores.
- Equipos de producción
- Plantas eléctricas.



Incubadora



Congelador

2.2.2 Mapeos térmicos

Es un proceso de análisis de datos de temperatura y humedad relativa que se requiere para cualquier espacio a signado para el almacenamiento de productos que así lo requieran (TTSP s). De acuerdo con WHO Técnica Report Series, No. 961 el procedimiento que se realiza para mapeos térmicos es:

Evaluación de distribución de temperatura
Evaluación de humedad relativa
Evaluación de temperatura cinética media (MKT)
Evaluación de excursiones
Evaluación de puntos críticos
Creación o estructura del protocolo de mapeo.
Recopilación de la información del área a evaluar.

Áreas de Aplicación:

Industria Farmacéutica: Cámaras de almacenamiento, áreas de producción y transporte de medicamentos.
Industria alimentaria: almacenes, cámaras de refrigeración y áreas de procesamiento.
centros hospitalarios: almacenamiento de medicamentos, equipos médicos y áreas críticas.





Figure 1 – Typical location of data loggers in a pallet racking storage area


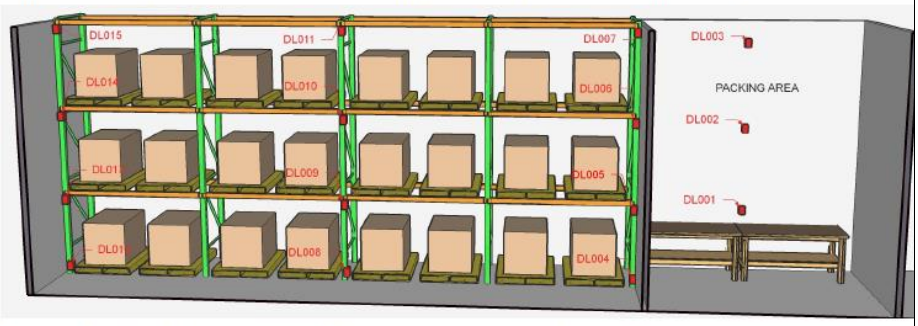


Figure 2 – Typical location of data loggers in a walk-in cold room

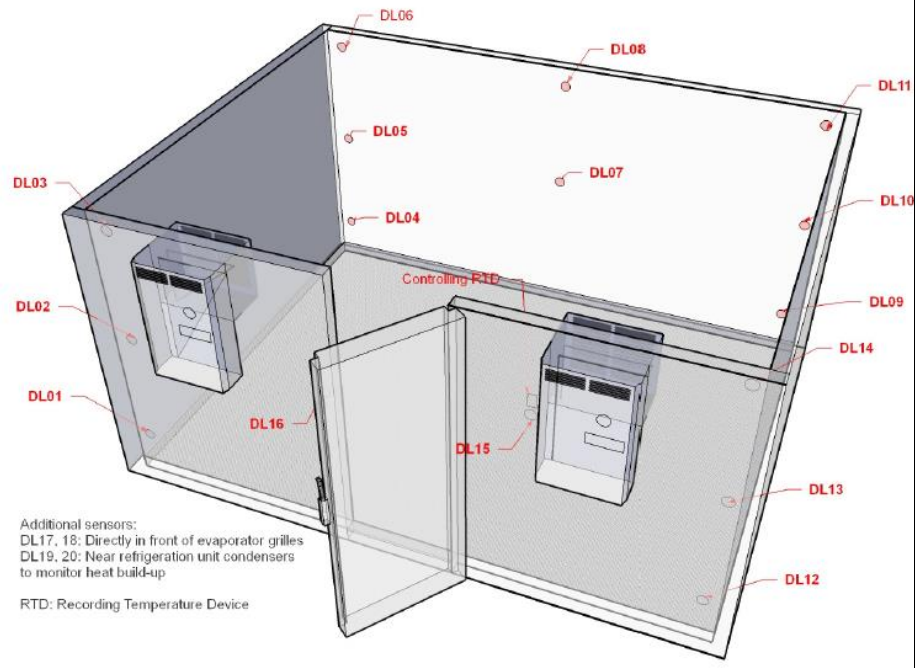

2.2.3 Calificación de vehículos

La calificación de vehículos refrigerados es un proceso técnico y sistemático que asegura que los vehículos utilizados para el transporte de productos sensibles a la temperatura, como medicamentos, alimentos y productos biológicos, cumplan con los requisitos necesarios para mantener la integridad y calidad de los productos transportados. Este proceso incluye:

3. Verificación de equipos: Asegurarse de que los sistemas de refrigeración del vehículo funcionen correctamente y puedan mantener la temperatura requerida durante el transporte.


4. Pruebas de temperatura: Realizar pruebas de mapeo térmico para verificar la uniformidad de la temperatura en todo el compartimento de carga, asegurando que no haya puntos calientes o fríos que puedan comprometer los productos.


5. Validación de procedimientos: Asegurar que los procedimientos de carga, descarga y transporte cumplan con las normativas y estándares de calidad específicos de la industria.

6. Documentación y registros: Mantener registros detallados de todas las pruebas y verificaciones realizadas, incluyendo cualquier mantenimiento y calibración de los equipos de refrigeración.

7. Cumplimiento regulatorio: Garantizar que el vehículo y sus sistemas de refrigeración cumplan con las regulaciones y normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, par

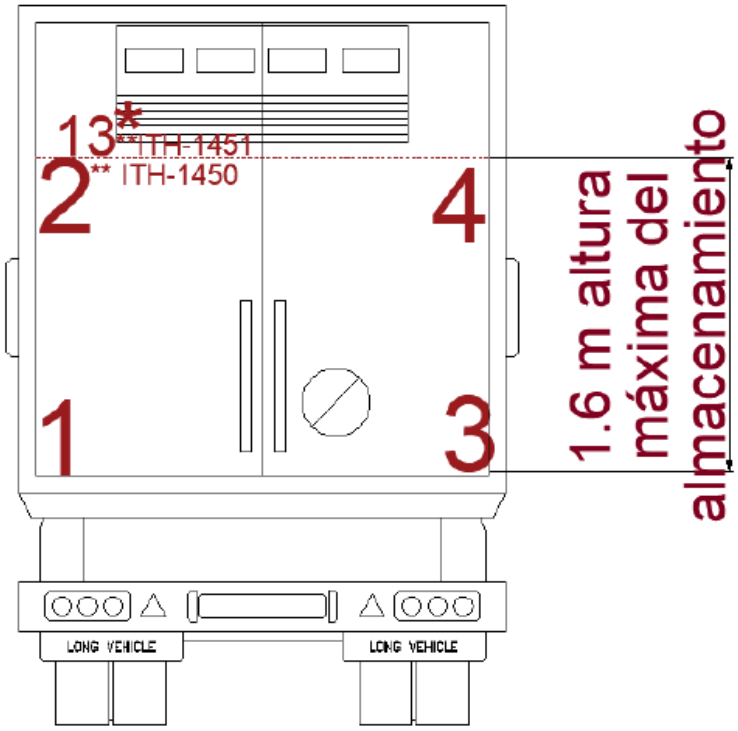


13*
** ITH-1451
2** ITH-1450
4
1
3
1.6 m altura máxima del almacenamiento
LONG VEHICLE
LONG VEHICLE

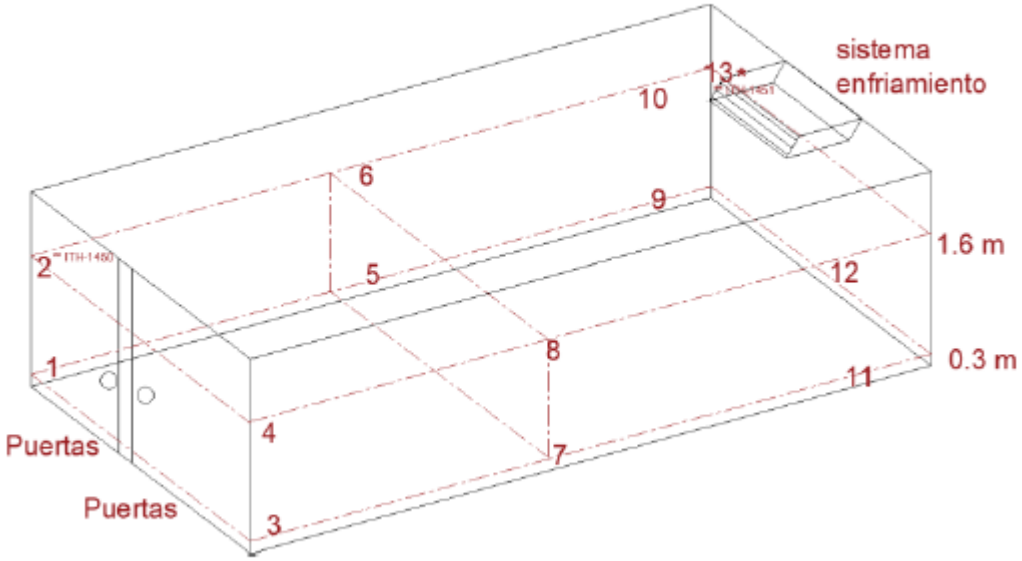
sistema enfriamiento
13*
10
6
9
2** ITH-1450
5
12
1.6 m
1
8
11
0.3 m
4
7
Puertas
Puertas
3

2.2.4 Esterilizaciones

Calificación de autoclaves

- Distribución de temperatura.
- Control del equipo.
- Verificación de sensores.
- Cálculo de la presión.
- Test Bowie Dick.
- Estudio de penetración en la carga y valor Fo.
- Estudio de reproducibilidad.
- Desafío microbiológico.

Horno despirogenización

- Distribución de temperatura.
- Control del equipo.
- Verificación de sensores .
- Cálculo del valor FH (250) para los ciclos evaluados.
- Prueba de LAL.
- Estudio de penetración de calor.
- Estudio de reproducibilidad










2.2.5 Servicio de consultoría

- Evaluación del sistema de gestión de calidad –Resolución 1160 –INVIMA. –Informe 45 OMS anexo 9.
- Informe de diagnóstico con análisis de necesidades y expectativas de la empresa.
- Desarrollo de Planes de calificación, calibración y validación.
- Asesoría continua:
- Informes de seguimiento y recomendaciones periódicas durante la implementación.
- Mesas de trabajo con los Stakelhoders

Nuestros principales clientes:

3. Publicaciones (Blog) – Fácil de cargar...

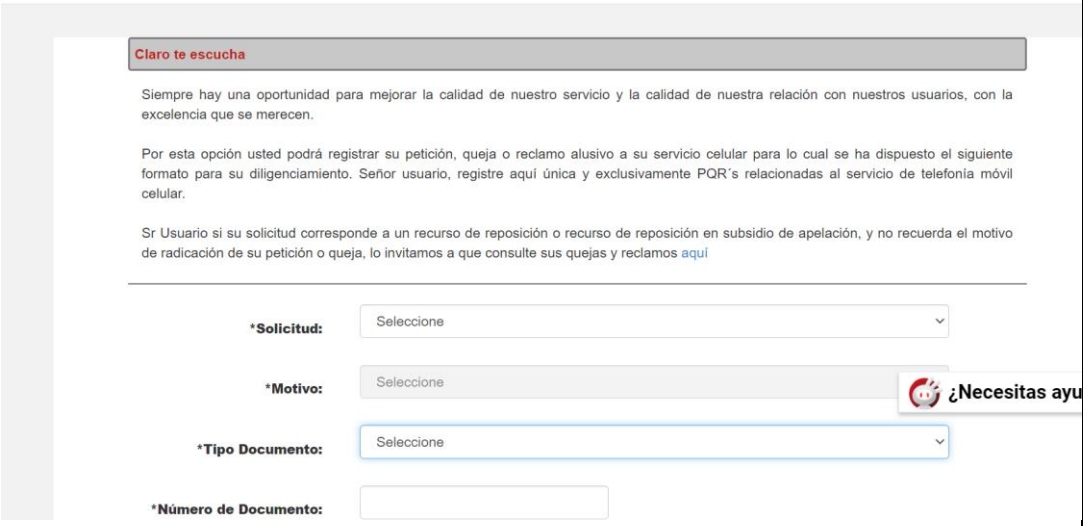	4. Registro y Login: CONTACTANOS -Nombre -apellidos -email-telefono-pais. Empresa-cargo-detalle de solicitud. Espacio para PQR Área: Laboratorio de Calibraciones Laboratorio de Ensayos Laboratorio de temperatura y humedad relativa (lista despegable) • Solicitud: (lista desplegable) Petición- Queja/ reclamo • Motivo: campo para colocar descripción • Descripción de la solicitud; Campo para colocar la descripción • Tipo de documento (lista desplegable) Cedula de ciudadanía- Cedula de extranjería – NIT -Pasaporte. • Numero de documento: campo para colocar descripción • Nombre: campo para colocar descripción • Cargo: campo para colocar descripción • Empresa: campo para colocar descripción Ejemplo  	
7		N.A.
8	Paginas web de referencia : https://cercal.cl/quienes-somos/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtZK1BhDuARIsAAy2Vzs9k2VJ6B5TLi2rhD-Br9YUSTvieZpmGHgjJEciq23_Tklk1emJ_OkaAgdVEALw_wcB	N.A.

	https://www.qbd.lat/calificacion-instalacion-iq/?v=42983b05e2f2	

4.10 Normatividad

Ítem	Descripción	Observaciones
1	Resolución exenta1242 Aprueba guía para la calificación de vehículos de transporte refrigerados	N.A.
2	Resolución exenta 1541 aprueba guía para la calificación de contenedores de transporte	N.A.
3	Annex 9: Model guidance for storage and transport of time – and – temperature – sensitive pharmaceutical products WHO Technical report seires, No. 961,2011 – supplement 7 – Supplement 8 – supplement 9 Qualification of temperature – controlled storage areas.	N.A.
4	USP vigente - Farmacopea de estados unidos de América, Capitulo <659> "requisitos de envasado y almacenamiento" capitulo <1079> "buenas prácticas de almacenamiento y distribución"	N.A.
5	ISPE 2012 Controlled temperatura chamber mapping a concep paper by the spe packaking community of practice	N.A.
6	Informe 45 de la OMS: Anexo 2 Buenas prácticas de la OMS para los laboratorios de microbiología farmacéutica.	N.A.
7	Resolución No.1160:2016 Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de Inspección de Laboratorios o Establecimientos de Producción de medicamentos, para la obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.	N.A.

4. Firmas de Ms Sinergy SAS

Revisión por parte de Ms Sinergy SAS

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
María Alejandra Granada Maria Alejandra Granada Maria Alejandra Granada (Sep 3, 2024 07:11 CDT)	Director administrativo		2024-08-28
Revisado por:	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
José Luis Rodríguez	Director de operaciones		2024-08-28

Aprobación del proveedor del módulo de servicios:

Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Aprobado por:	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Andrés Felipe Rodriguez Andres Felipe Rodriguez Andres Felipe Rodriguez (Sep 3, 2024 07:15 CDT)	Ingeniero de Sistemas		2024-08-28
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: este documento solamente aplica para la aprobación del módulo de servicios los demás módulos se irán aprobando de acuerdo a la solicitud de Ms Sinergy SAS.