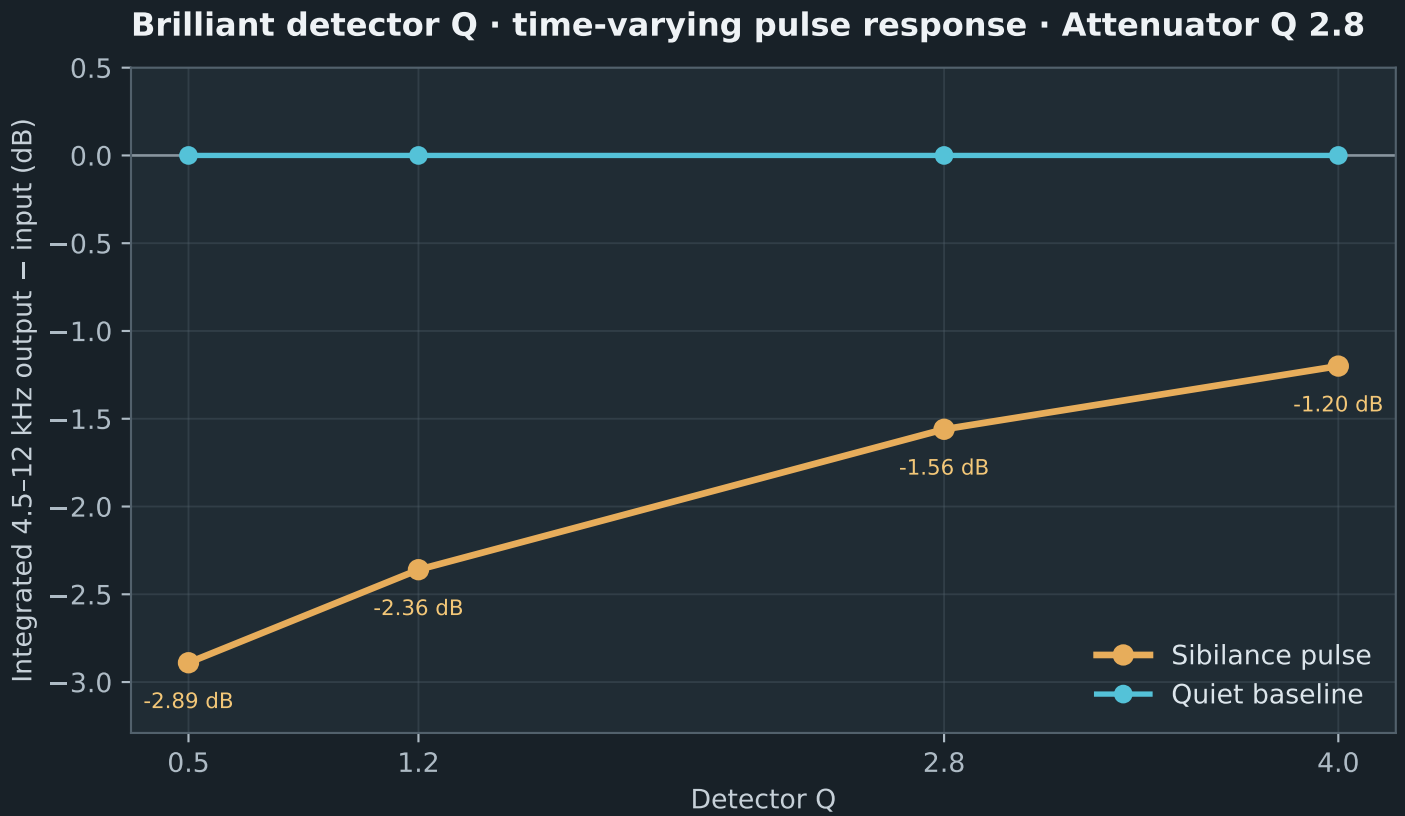
Brilliant detector Q · time-varying pulse response · Attenuator Q 2.8
Integrated 4.5–12 kHz output − input (dB)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
-2.89 dB
-2.36 dB
-1.56 dB
-1.20 dB
Sibilance pulse
Quiet baseline
0.5
1.2
2.8
4.0
Detector Q