

30 sec

PCR Box
Zephyrus

Elisabeth
Pharmakon

10:00
20.01.2018

BOOT

OK →

1. Manualni zap. Δ
dekontaminace ▽

2. Automat. zap. Δ
dekontaminace ▽

3. Nast. Casu Δ
zahajeni dek. ▽

4. Nast. delky Δ
dekontaminace ▽

5. Aktivni Δ
dekontaminace ▽

6. Ostatni Δ
nastaveni ▽

7. Posledni dek. :
01:01 01.01.2010

1 Ok

Man. zap. dek :
Vypnuta ☐

-Ok-

Man. zap. dek :
Casovana ☐

-Ok-

Man. zap. dek :
Okamzita ☐

→Ok→

(A) ← 5sec

Casovana dekon-
taminace vypnuta

zavrete viko
pro pokracovani

5 sekund

Dekonda prerusena
Pokracovat? ☐

Ok ☐

↓

Dekon. prerusena
Prerusit? ☐


Ok

↓


Dekon. prerusena

↓
5sec


(A)




30sec → A





30sec → A



} sipka Δ mění hodnotu

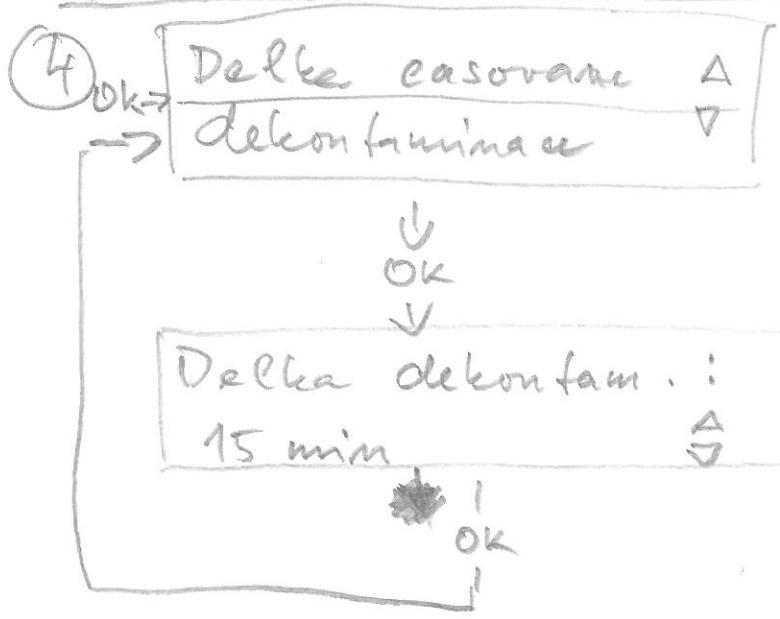

- krok Δ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15...



- krok 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15...

~~pokrač.~~ ④

str 4

~~Ok~~

⑤ Ok → Stav:
Zapnutí bez UV ⬆

Ok
↓

Režim:
Otevření kryt ⬆ → Ok → ⑤

▼

Režim
Zavření kryt ⬆ → Ok → ⑤

▼

Režim
Pri dekontaminaci ⬆ - Ok → ⑤

▼

Režim
Stale ⬆ - Ok → ⑤

30 sec.

↓
A

⑥ OK →

UV zarivky	Δ
	▽

→ OK

Aktualni stav	Δ
UV zarivek	▽

→ OK

Posledni	Δ
vymena	▽

-OK

~~OK~~ ▽

Nastaveni	Δ
zivotnosti UV	▽

→ OK

Provozni	Δ
hodiny	▽

-OK

OK ▽

Nulovani pro-	Δ
voznich hodin	▽

→ OK

Posledni vymena	
01.01.2001	

Upozorneni na	Δ
vymenu UV	▽

→ OK

Doba sviceni :	
0000 hod.	

▽ OK
↓

Sledovani ziv. :	
Zapunto	Δ

→ OK

Zadejte zivot. :	
8000 hod	Δ

(krok 5000, 5500, 6000,
6500, 7000, 7500,
8000, 8500, 9000, 5000)

Sledovani ziv. :	
Vypunto	Δ

→ OK

Vynulovat hod. !	
Potvrdit ? (OK)	

-OK

30 sec. → (A)

⑥ - Ok →

Merem funkce	Δ
UV	▽

Ok

Merem:	
Vypnutí	Δ ▽