

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTE

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

Página 1 de 2

No. CL232357

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico
LUGAR CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termómetro Digital
FABRICANTE : KEX GERMANY
MODELO : RT-803E
NÚMERO DE SERIE : AF003349
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-048/NEVERA LACTARIO - UCI NEONATO
INTERVALO DE MEDICIÓN : -50 °C a 70 °C
RESOLUCIÓN : 0,1 °C
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-10-16
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-18

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento P MC TE v08, basado en la norma NT VVS 103 : 1994-09.

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025:2017 o Institutos Nacionales de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	21,9	20,3
Humedad Relativa (%hr):	58,1	47,3

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Bloque Seco	TP MC 24	Temperatura	CL227859	METROCARIBE S.A.	2025-01-31	12 meses
Termómetro Digital con Sensor PRT	TP MC 31	Temperatura	IM-TEM-24-0566	INGOBAR	2024-10-24	18 meses

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nurys Morales O.

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: Tigo. Yonasis Chiquillo B.
Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

INSTRUMENTO : Termómetro Digital

FABRICANTE : KEX GERMANY

MODELO : RT-803E

NÚMERO DE SERIE : AF003349

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-048/NEVERA LACTARIO - UCI NEONATO

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-18

PROCEDIMIENTO: P MC TE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTE

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08


Página 2 de 2

No. CL232357

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Factor de Cobertura k
2,30	2,02	-0,28	0,18	2,05
6,20	5,94	-0,26	0,19	2,00
8,30	7,93	-0,37	0,19	2,00

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

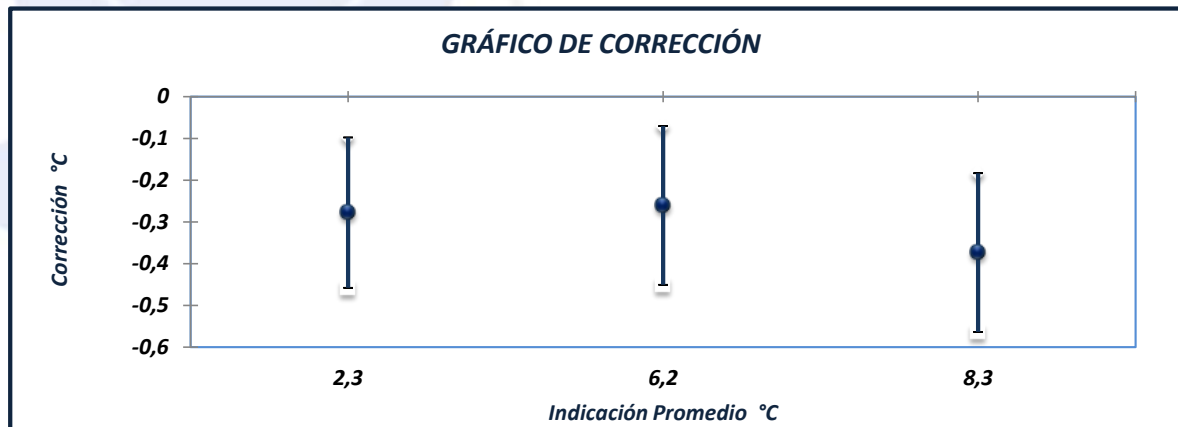

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO