



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2025-11-01

VERSIÓN: 10

Página 1 de 2

No. CL235486-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : UNI-T
MODELO : A12T
NÚMERO DE SERIE : C242766818
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-161
INTERVALO DE MEDICIÓN : 20 %hr a 95 %hr
RESOLUCIÓN : 1 %hr
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-04-28
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-05

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,3	20,8
Humedad Relativa (%hr):	51,3	43,2

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.
Coordinadora de Laboratorio

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A05	Humedad Relativa	CL-2119	AINSER	2026-03-20	12 Meses

Calibrado Por:

Tigo. Nelson De Ávila G.
Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Dirección: Calle 64 No 47 - 102 Tel: (605) 3425181 Barranquilla - Colombia

E-mail: gerencia@metrocaribe.com - dircomercial@metrocaribe.com

ORT: 20199



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital
FABRICANTE: UNI-T
MODELO: A12T
NÚMERO DE SERIE: C242766818
CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-161
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2026-05-05
PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR
FECHA: 2025-11-01
VERSIÓN: 10
Página 2 de 2

No. CL235486-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
41,0	40,6	-0,4	1,8	23,3	2,00
60,0	60,4	0,4	1,7	23,3	2,00
71,0	70,6	-0,4	1,7	23,4	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
43,1	40,4	-2,7	1,8	23,2	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "*k*", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09

Página 1 de 2

No. CL235486

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS.

DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico

LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNI-T

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C242766818

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-161

INTERVALO DE MEDICIÓN : -10 °C a 50 °C

RESOLUCIÓN : 0,1 °C

FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-04-28

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-04

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cámara Climática	HM MC A 05	Temperatura	CS020944	METROCARIBE S.A.	2026-03-26	12 Meses

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	25,5	21,7
Humedad Relativa (%hr):	54,0	41,4

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: Tigo. Nelson De Ávila G.

Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-022

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNI-T

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C242766818

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-161

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-05-04

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09


Página 2 de 2

No. CL235486

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,35	20,35	0,00	0,48	50,23	2,00
25,10	25,34	0,24	0,47	50,26	2,00
29,95	30,33	0,38	0,43	50,30	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
25,20	25,26	0,06	0,47	50,37	2,00

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "k", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.

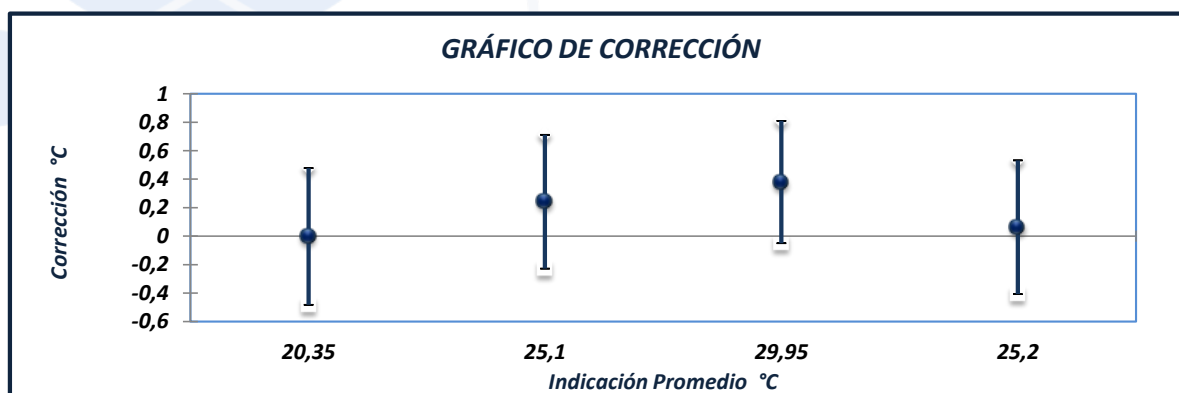

EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO