

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

Página 1 de 2

No. CL232690

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : UNI-T
MODELO : A12T
NÚMERO DE SERIE : C244555128
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-052
INTERVALO DE MEDICIÓN : -10 °C a 50 °C
RESOLUCIÓN : 0,1 °C
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-04
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-11-04

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	21,8	20,2
Humedad Relativa (%hr):	44,9	42,6

FIRMA AUTORIZADA
Autorizado Por:**Tigo Nury Morales O.**

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: **Tigo Gladys Parejo O.**

Auxiliar de Metrología

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Temperatura	HM MC A 04	Temperatura	CL227300	METROCARIBE S.A.	2024-12-23	12 Meses

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ORT: 18990



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNI-T

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C244555128

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-052

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-11-04

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08


Página 2 de 2

No. CL232690

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,15	20,29	0,14	0,46	50,79	2,00
24,90	25,28	0,38	0,40	50,41	2,00
29,80	30,27	0,47	0,40	50,45	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
25,00	25,43	0,43	0,40	50,38	2,00

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

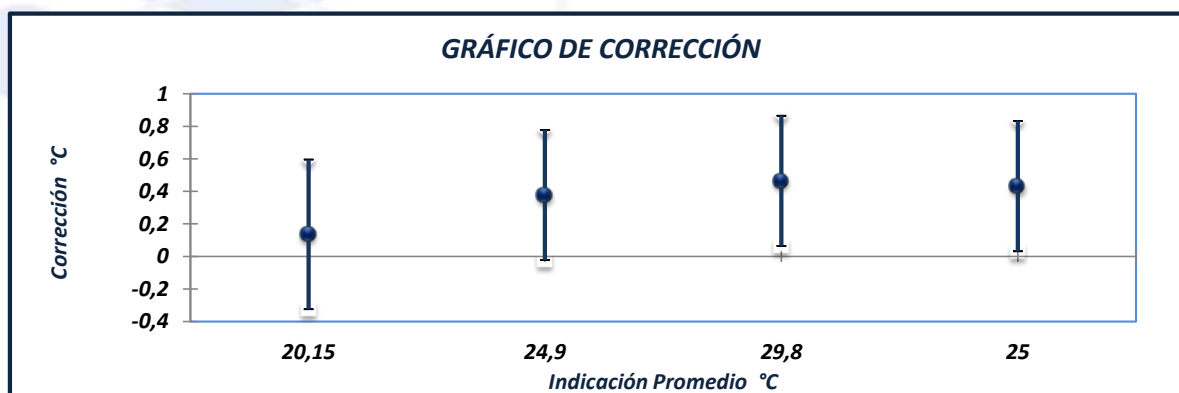

EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO

Dirección: Calle 64 No 47 - 102 Tel: (605) 3425181 Barranquilla - Colombia

E-mail: gerencia@metrocaribe.com - dircomercial@metrocaribe.com

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 1 de 2

No. CL232690-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : UNI-T
MODELO : A12T
NÚMERO DE SERIE : C244555128
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-052
INTERVALO DE MEDICIÓN : 20 %hr a 95 %hr
RESOLUCIÓN : 1 %hr
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-04
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-11-05

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,3	20,7
Humedad Relativa (%hr):	63,0	45,0

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.
Coordinadora de Laboratorio**PATRONES**

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A04	Humedad Relativa	HM1412-24	SET&GAD	2024-12-20	12 Meses

Calibrado Por:

Tigo. Gladys Parejo O.
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ORT: 18990



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: UNI-T

MODELO: A12T

NÚMERO DE SERIE: C244555128

CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-052

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025-11-05

PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 2 de 2

No. CL232690-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
40,2	40,7	0,5	1,3	23,3	2,00
59,0	60,5	1,5	1,4	23,2	2,00
73,0	70,5	-2,5	1,4	23,3	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
41,0	40,7	-0,3	1,3	23,5	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO