

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64536-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64536-26

Página 1 de 4



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Máquina de Anestesia
Instrument

Fabricante: Mindray
Manufacturer

Modelo: WATO EX-65
Model

Serie No. ER-57003420
Serial No.

Inventario: AF002420
Stocktaking

Fecha de Recepción: 15 de agosto de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 15 de agosto de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Cirugía, Quirófano 3
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón
Calibration method simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Sofía Isabel García Calvo
Directora Laboratorio Calibración
Calibration Laboratory Director



Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha: 2026.08.24
15:51:20 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64536-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64536-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	20 °C	23 °C	3 °C
Humedad Relativa	51 %	52 %	1 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Analizador de Flujos de Gases	CALIBRAR-010	L5208	Biosancta	6/05/2025

Resultados de la calibración

Calibration Results

Volumen Tidal (Vt)

Valor Programado (ml)	Valor Medido (ml)	Error (ml)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
200	189,43	-10,57	3,5
400	347,17	-52,83	4,9
600	582,70	-17,30	3,5

Presión Inspiratoria (Pinsp)

Valor Programado (cmH ₂ O)	Valor Medido (cmH ₂ O)	Error (ml)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
10,0	7,60	-2,40	0,36
15,0	14,73	-0,27	0,13
20,0	17,73	-2,27	0,22

Presión Positiva al Final de la Espiración (PEEP)

Valor Programado (cmH ₂ O)	Valor Medido (cmH ₂ O)	Error (cmH ₂ O)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
6	3,87	-2,13	0,13
9	8,17	-0,83	0,13
12	11,20	-0,80	0,19

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64536-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64536-26

Página 3 de 4


Frecuencia Respiratoria RPM

Valor Programado (RPM)	Valor Medido (RPM)	Error (RPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
16	16,00	0,00	0,11
14	14,00	0,00	0,11
12	12,00	0,00	0,11


Relación I:E

Valor Programado	Valor Medido	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
1:2	1:1,78	-0,22	0,35


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
 V_t

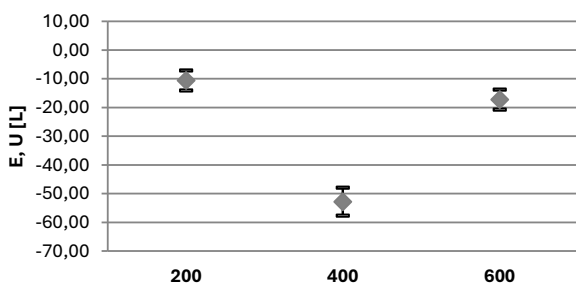


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
 P_{insp}

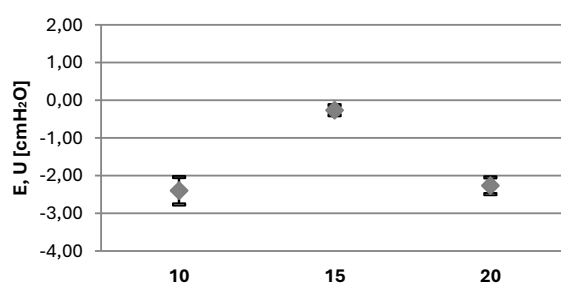

ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PEEP

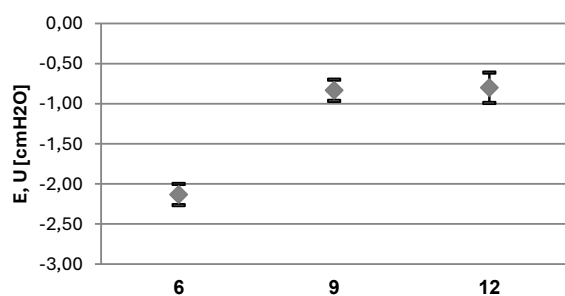


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
FRECUENCIA RESPIRATORIA

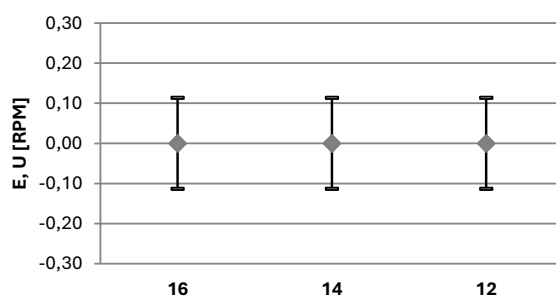

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-64536-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-64536-26

Página 4 de 4

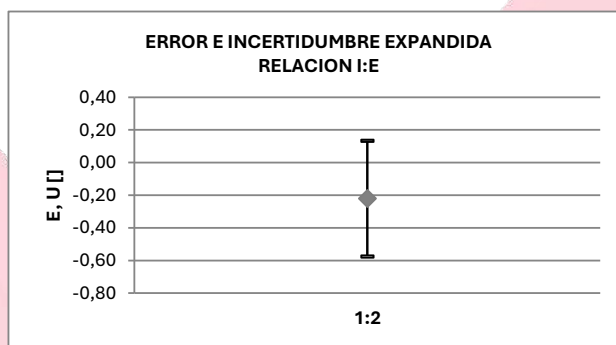

Observaciones

Remarks

FIN DEL CERTIFICADO