

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-09024-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-09024-26

Página 1 de 3



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Servocuna
Instrument

Fabricante: Ningbo David
Manufacturer

Modelo: HKN-93B
Model

Serie No. 24160101001
Serial No.

Inventario: AF003456
Stocktaking

Fecha de Recepción: 02 de septiembre de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 02 de septiembre de 2026
Date of Calibration

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador, con base en lo indicado en el procedimiento para calibración o
Calibration Method caracterización de medios isotermos con aire como medio termostático PC-018 Indecopi 2009 Segunda edición.

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: UCI Neonatal
Place

Este informe de validación no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo

Directora Laboratorio Calibración
Calibration Laboratory Director

Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha:
2026.09.03
16:47:00 -05'00'



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-09024-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-09024-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición
Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales
Environmental Conditions

	Inicial	Final	Δ
Temperatura	21 °C	23 °C	2 °C
Humedad Relativa	42 %	45 %	3 %

Trazabilidad
Trazability


Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Serie	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Datalogger de temperatura	EFI2491017 40	GJ8905-25	Set & Gad	2/05/2025
Datalogger de temperatura	T12260	NC-25-04-25-050	Set & Gad	18/04/2025
Datalogger de temperatura	T50224	NC-25-12-17-073	Madgetech	10/12/2025
Datalogger de temperatura	T30253	NC-25-05-28-116	Madgetech	23/05/2025
Datalogger de temperatura	T12260	NC-25-04-25-050	Set & Gad	18/04/2025

Resultados de la Calibración
Results of Calibration

Distribución de los Sensores
Sensor Layout

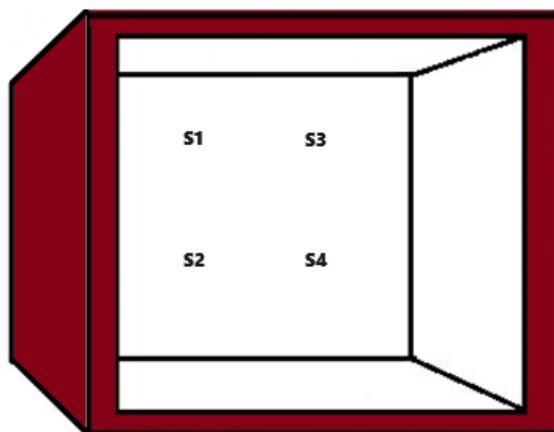

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-09024-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-09024-26


Página 3 de 3

Temperatura en °C

Temperature in °C

Temperatura Programada en el Medio Isotérmico				35,7
Valor del Indicador Por el Medio Isotérmico	Valor Medido con Sensores Patrones	Error	Incertidumbre Expandida ±U EXP	
35,60	35,788	-0,185	0,029	
Otros Parámetros		Valor Obtenido	Incertidumbre Expandida ±U EXP	
Uniformidad del Medio Isotérmico		4,7996	0,0031	
Estabilidad del Medio Isotérmico		4,15	0,297	
Temperatura Mínima Medida		31,6	2,4	
Temperatura Máxima Medida		39,9	2,3	
Desviación de Temperatura en el Tiempo		8,30	0,0020	
Desviación de Temperatura en el Espacio		1,01	0,015	

Gráfico de Estabilidad y Uniformidad

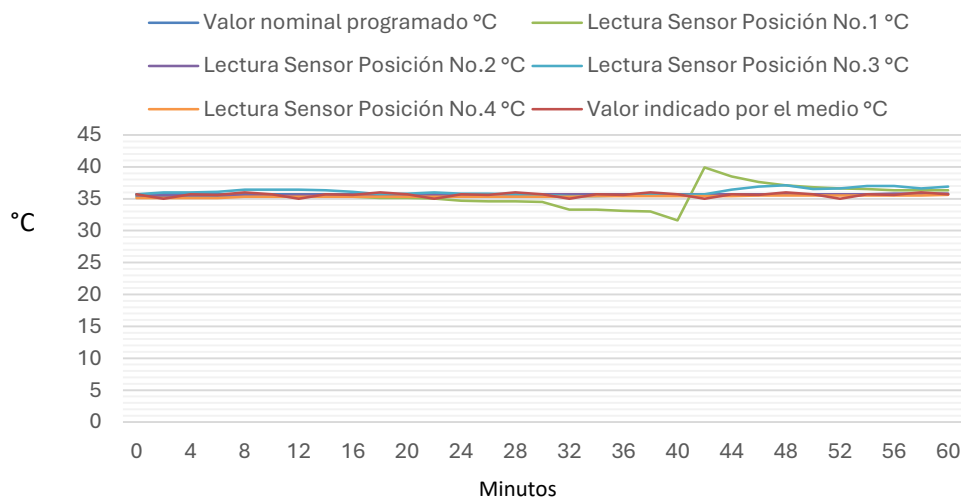

FIN DEL CERTIFICADO