

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74461-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74461-26

Página 1 de 3



Cliente:
Customer
Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas

Dirección:
Address
Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo

Ciudad:
City
Barranquilla, Atlántico

Instrumento:
Instrument
Pulsioxímetro

Fabricante:
Manufacturer
Edan

Modelo:
Model
H100B

Serie No.
Serial No.
360101-M21710080032

Inventario:
Stocktaking
No Identificado

Fecha de Recepción:
Reception Date
02 de septiembre de 2026

Lugar de Calibración:
Calibration Place
Instalaciones Del Cliente

Fecha de Emisión:
Issue Date
03 de septiembre de 2026

Fecha de Calibración:
Calibration Date
02 de septiembre de 2026

Ubicación:
Place
Maternidad, Sala de Partos

Método de calibración:
Calibration method
Comparación directa con patrón simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo
Director Laboratorio
Laboratory Director

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74461-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74461-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Inicial	Final	Δ
Temperatura	20,0 °C	21,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	49,0 %	52,0 %	3,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de Saturación de Oxígeno Marca Fluke Biomedical Modelo Spot Light Serie 2300046	CALIBRAR-009	L4772	Biosancta	12/06/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Saturación Parcial De Oxígeno



Valor Programado Patrón (%)	Valor Medido Equipo (%)	Error (%)	K	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
85,0	86,1	-1,1	1,97	2,7
90,0	91,4	-1,4	1,97	2,4
95,0	95,7	-0,7	1,97	2,4
99,0	99,7	-0,7	1,97	2,3

Pulso Cardíaco

Valor Programado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	K	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
60,0	60,1	-0,1	1,97	1,8
80,0	80,0	0,0	1,97	1,8
120,0	119,7	0,3	1,97	1,8
150,0	148,5	1,5	1,97	1,8

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74461-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74461-26

Página 3 de 3

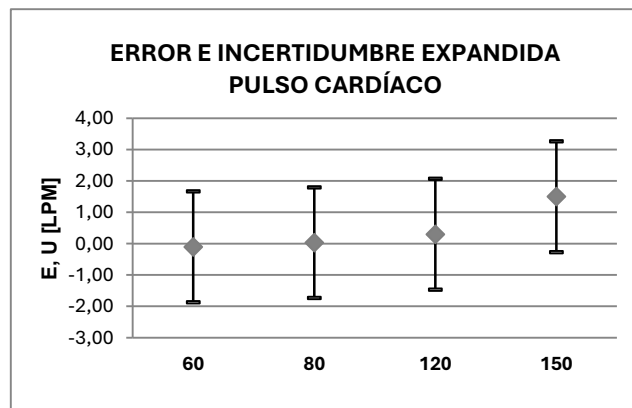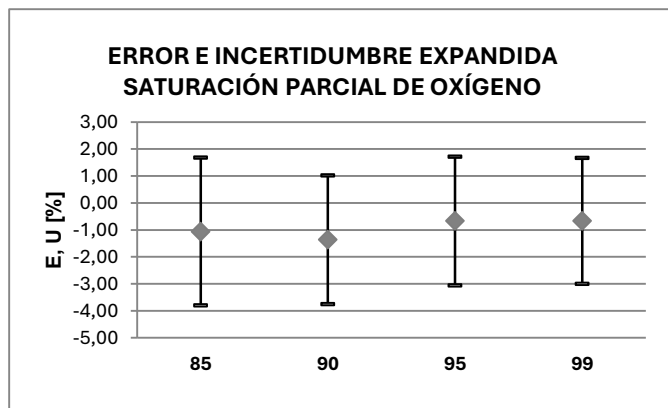

FIN DEL CERTIFICADO