

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74459-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74459-26

Página 1 de 2



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Doppler Fetal
Instrument

Fabricante: Edan
Manufacturer

Modelo: Sonotrax
Model

Serie No. 560054-M22101230091
Serial No.

Inventario: AF002721
Stocktaking

Fecha de Recepción: 02 de septiembre de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 02 de septiembre de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place


Ubicación: Maternidad, Sala de Control
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón
Calibration method simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Sofía Isabel García
Directora Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director

Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL GARCIA CALVO
Fecha:
2026.09.03
16:52:09 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-74459-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-74459-26

Página 2 de 2

Incertidumbre de medición
Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura

Mínima	Máxima	Δ
21,0 °C	22,0 °C	1,0 °C
49,0 %	52,0 %	3,0 %

Humedad Relativa

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón

Simulador fetal

Código Interno

CALIBRAR-020

Certificado No.

L5681

Emitido por

Biosancta


Fecha de Calibración

20/04/2026

Resultados de la calibración

Calibration Results

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
60	60,00	0,00	1,2
90	89,80	-0,20	1,3
120	119,80	-0,20	1,2
150	150,00	0,00	1,1
180	180,00	0,00	1,5
210	209,80	-0,20	1,9

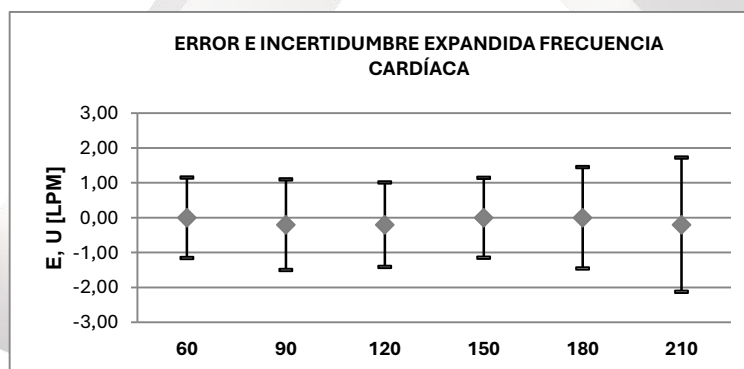

FIN DEL CERTIFICADO