

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138055-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138055-26

Página 1 de 3




Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer:
Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address:
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City:
Instrumento: Monitor de Signos Vitales
Instrument:
Fabricante: Mindray
Manufacturer:
Modelo: uMEC10
Model:
Serie No. KN-7A0515217
Serial No.:
Inventario: AF000804
Stocktaking:
Fecha de Recepción: 05 de junio de 2026
Reception Date:
Fecha de Calibración: 05 de junio de 2026
Calibration Date:
Fecha de Emisión: 05 de junio de 2026
Issue Date:
Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place:
Ubicación: Urgencias Ginecológicas
Place:
Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method:

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager

Firmado digitalmente por
ALFONSO
ENRIQUE ORTIZ
BARRIOS
Fecha: 2026.06.13
06:07:45 -05'00'



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138055-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138055-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición
Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura	Inicial	Final	Δ
	22,0 °C	24,0 °C	2,0 °C
Humedad Relativa	50,0 %	52,0 %	2,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de saturación de oxígeno	CMB-044	L4772	Biosancta	07/06/2024
Simulador de Presión no Invasiva	CMB-111	L3997	Biosancta	08/02/2023
Analizador de desfibrilación	CMB-003	L4806	Biosancta	16/07/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Saturación Parcial De Oxígeno (SpO₂)

Valor Simulado Patrón (%)	Valor Medido Equipo (%)	Error (%)	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
85	83,8	-1,2	2,8
90	89,1	-0,9	2,6
95	94,4	-0,6	2,5
99	98,6	-0,4	2,4

Frecuencia Cardíaca

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
60	60,0	0,0	1,0
80	80,0	0,0	1,0
100	100,0	0,0	1,0
120	120,0	0,0	1,0
140	140,0	0,0	1,0


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138055-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138055-26

Página 3 de 3


Presión No Invasiva

Valor Simulado Patrón (mmHg)		Valor Medido Equipo (mmHg)		Error (mmHg)		Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP	
Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica
60	30	58,35	31,13	-1,65	1,13	0,79	0,79
120	80	117,20	81,77	-2,80	1,77	1,1	2,1
150	100	145,62	101,99	-4,38	1,99	1,1	1,1
200	150	195,46	151,83	-4,54	1,83	0,81	0,94


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO

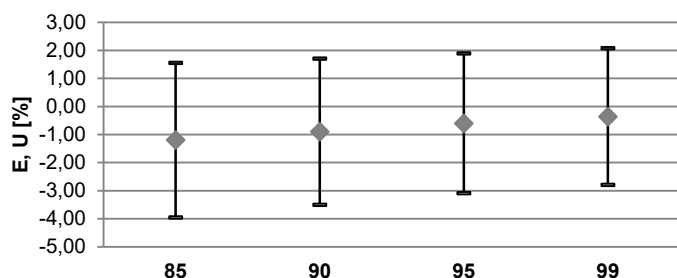


ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA FRECUENCIA CARDÍACA

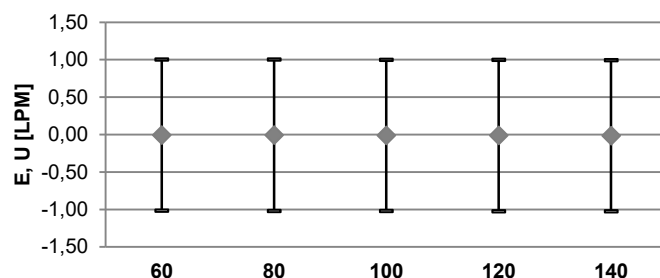

ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PRESIÓN SISTÓLICA NO INVASIVA

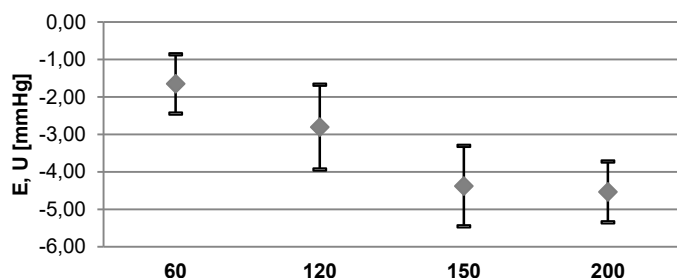

ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA PRESIÓN DIASTÓLICA NO INVASIVA

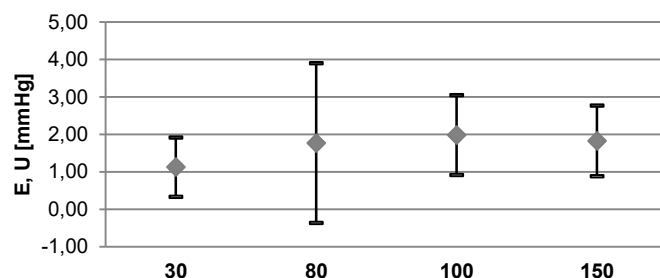

FIN DEL CERTIFICADO