

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138132-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138132-26

Página 1 de 2



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Doppler Fetal
Instrument

Fabricante: Edan
Manufacturer

Modelo: Sonotrax II Pro
Model

Serie No. 560054-MM25911470070
Serial No.

Inventario: AF004388
Stocktaking

Fecha de Recepción: 20 de agosto de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 20 de agosto de 2026
Calibration Date

Lugar de Calibración: Laboratorio de Metrología Calibrar S.A.S.
Calibration Place


Ubicación: Consulta Externa - Consultorio 7
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Sofía Isabel García
Directora Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director



Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha: 2026.08.24
15:46:31 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138132-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138132-26

Página 2 de 2

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura	Mínima 22,0 °C	Máxima 23,0 °C	Δ 1,0 °C
Humedad Relativa	50,0 %	52,0 %	2,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).


This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador fetal	CALIBRAR-020	L5681	Biosancta	20/04/2026

Resultados de la calibración

Calibration Results

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
60	60,00	0,00	1,2
90	90,00	0,00	1,2
120	120,00	0,00	1,1
150	149,40	-0,60	1,2
180	180,00	0,00	1,5
210	209,00	-1,00	1,9

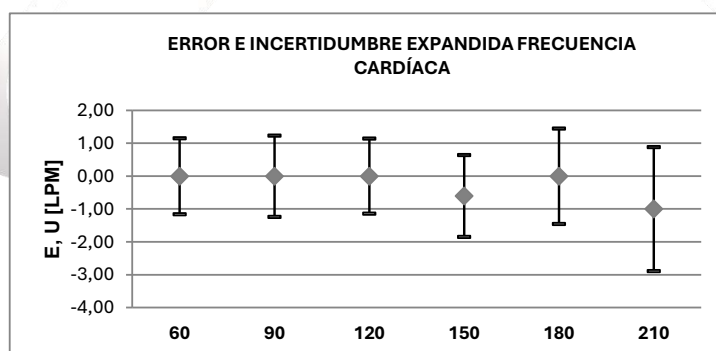

FIN DEL CERTIFICADO