

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138130-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138130-26

Página 1 de 3



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Monitor de Signos Vitales
Instrument

Fabricante: Mindray
Manufacturer

Modelo: uMEC 100
Model

Serie No. FT4-4C015285
Serial No.

Inventario: No Identificado
Stocktaking

Fecha de Recepción: 20 de agosto de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 20 de agosto de 2026
Calibration Date

Fecha de Emisión: 21 de agosto de 2026
Issue Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Hospitalización Piso 5 Torre B -
Place Toma de signos

Método de calibración: Comparación directa con
Calibration method patrón simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo
Directora Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director


Firmado digitalmente por
SOFIA ISABEL
GARCIA CALVO
Fecha: 2026.08.24
16:28:30 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138130-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138130-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	22,0 °C	23,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	50,0 %	51,0 %	1,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Serie No	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de Presión no Invasiva Fluke Biomedical	CALIBRAR-002	L5743	Biosancta	11/05/2026
Cufflink SN 1051006 Simulador de saturación de oxígeno Fluke Biomedical Spot	CALIBRAR-008	L4772	Biosancta	07/06/2024
Light SN 2300046 Simulador de signos vitales	CALIBRAR-007	L5680	Biosancta	20/04/2026
Contec MS 400 SN 23090400026				

Resultados de la calibración

Calibration Results

Saturación Parcial De Oxígeno (SpO₂)

Valor Simulado Patrón (%)	Valor Medido Equipo (%)	Error (%)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
85	83,8	-1,2	2,8
90	89,1	-0,9	2,6
95	95,5	0,5	2,5
99	98,6	-0,4	2,4

Frecuencia Cardíaca

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
60	59,9	-0,1	0,95
90	89,8	-0,2	1,0
120	119,8	-0,2	1,0
150	149,7	-0,3	1,1
180	179,6	-0,4	1,1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-138130-26


CALIBRATION CERTIFICATE No CD-138130-26

Página 3 de 3


Presión No Invasiva

Valor Simulado Patrón (mmHg)		Valor Medido Equipo (mmHg)		Error (mmHg)		Incertidumbre Expandida ±U EXP	
Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica
60	30	58,88	32,74	-1,12	2,74	0,79	0,72
120	80	117,73	79,82	-2,27	-0,18	1,1	0,79
150	100	144,26	103,36	-5,74	3,36	0,58	0,58
200	150	195,92	150,84	-4,08	0,84	0,72	0,79


**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO**

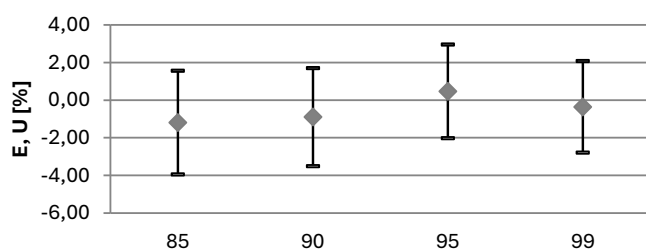


**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
FRECUENCIA CARDÍACA**

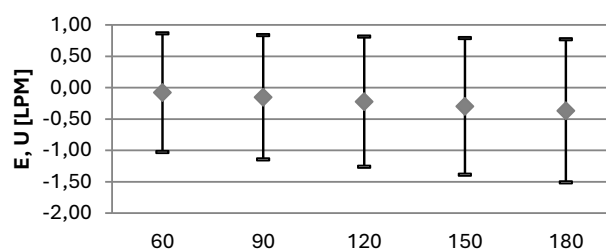

**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PRESIÓN SISTÓLICA NO INVASIVA**

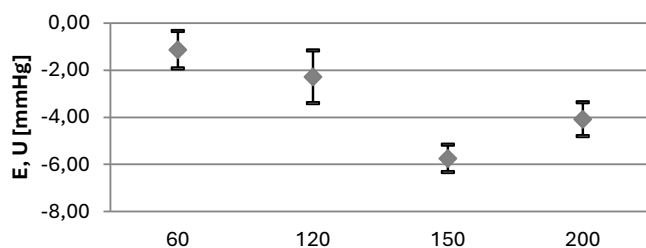

**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PRESIÓN DIASTÓLICA NO INVASIVA**

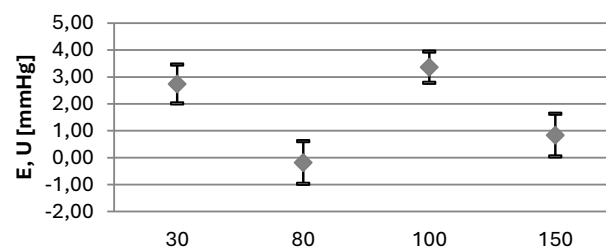

FIN DEL CERTIFICADO