

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-39170-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-39170-26

Página 1 de 2



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer

Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City

Instrumento: Esfigmomanómetro
Instrument

Fabricante: Riester
Manufacturer

Modelo: Metpak
Model

Serie No. 180822963
Serial No.

Inventario: No Identificado
Stocktaking

Fecha de Recepción: 31 de marzo de 2026
Reception Date

Fecha de Calibración: 31 de marzo de 2026
Calibration Date

Fecha de Emisión: 06 de abril de 2026
Issue Date

Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place

Ubicación: Maternidad
Place

Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador, siguiendo los lineamientos de los numerales 5.1.1 y A.1 de la recomendación internacional: OIML R 16-1:2002
Calibration method

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios

Gerente General
General Manager



Firmado
digitalmente por
ALFONSO ENRIQUE
ORTIZ BARRIOS
Fecha: 2026.04.11
11:35:57 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-39170-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-39170-26

Página 2 de 2

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre expandida de medición reportada se calculó multiplicando la incertidumbre de medida estándar con el factor de cobertura k conforme a los grados de libertad calculados para una distribución t de student con un 95% de nivel de confianza.

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura: $(22,5 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$

Humedad relativa: $(50,5 \pm 0,5) \% \text{ RH}$

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

**Código
Interno**

Equipo Patrón

Certificado No.

Emitido por

**Fecha de
Calibración**

CMB-030

Manómetro Digital

C0803-24

Set & Gad


7/03/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Presión IBC	Presión Promedio Patrón	Error IBC	Incertidumbre Expandida $\pm U \text{ EXP}$
mmHg			
0,00	0,00	0,00	0,11
50,00	51,50	-1,50	0,37
100,00	101,45	-1,45	0,21
150,00	151,40	-1,40	0,11
200,00	201,95	-1,95	0,88
250,00	253,00	-3,00	0,11
300,00	303,60	-3,60	0,71

El factor de conversión de unidades utilizado en esta calibración es: $1 \text{ mm} \cdot \text{Hg} = 133,322 \text{ Pa}$, conforme con NIST SP811

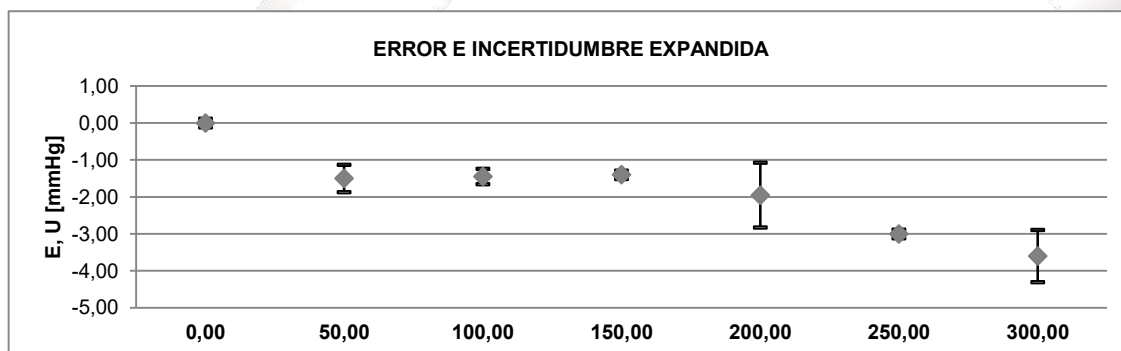

FIN DEL CERTIFICADO