

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-39172-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-39172-26

Página 1 de 2



Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer:
Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address:
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City:
Instrumento: Esfigmomanómetro
Instrument:
Fabricante: Riester
Manufacturer:
Modelo: Metpak
Model:
Serie No. 191220016
Serial No.:
Inventario: No Identificado
Stocktaking:
Fecha de Recepción: 31 de marzo de 2026
Reception Date:
Fecha de Calibración: 31 de marzo de 2026
Calibration Date:
Fecha de Emisión: 06 de abril de 2026
Issue Date:
Lugar de Calibración: Instalaciones Del Cliente
Calibration Place:
Ubicación: UCI Adulto
Place:
Método de calibración: Comparación directa con patrón simulador, siguiendo los lineamientos de los numerales 5.1.1 y A.1 de la recomendación internacional: OIML R 16-1:2002
Calibration method:

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By


Ing. Alfonso Ortiz Barrios

Gerente General
General Manager

Firmado digitalmente por
ALFONSO
ENRIQUE ORTIZ
BARRIOS
Fecha: 2026.04.11
11:36:51 -05'00'

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-39172-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-39172-26

Página 2 de 2

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre expandida de medición reportada se calculó multiplicando la incertidumbre de medida estándar con el factor de cobertura k conforme a los grados de libertad calculados para una distribución t de student con un 95% de nivel de confianza.

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura: $(22,5 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$
Humedad relativa: $(50,5 \pm 0,5) \% \text{ RH}$

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).


Código Interno	Equipo Patrón	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
CMB-030	Manómetro Digital	C0803-24	Set & Gad	7/03/2024

Resultados de la calibración

Calibration Results

Presión IBC	Presión Promedio Patrón	Error IBC	Incertidumbre Expandida $\pm U \text{ EXP}$
mmHg			
0,00	0,00	0,00	0,11
50,00	50,00	0,00	0,11
100,00	98,25	1,75	0,13
150,00	147,75	2,25	0,21
200,00	197,00	3,00	0,11
250,00	247,40	2,60	0,26
300,00	298,20	1,80	0,59

El factor de conversión de unidades utilizado en esta calibración es: $1 \text{ mm} \cdot \text{Hg} = 133,322 \text{ Pa}$, conforme con NIST SP811

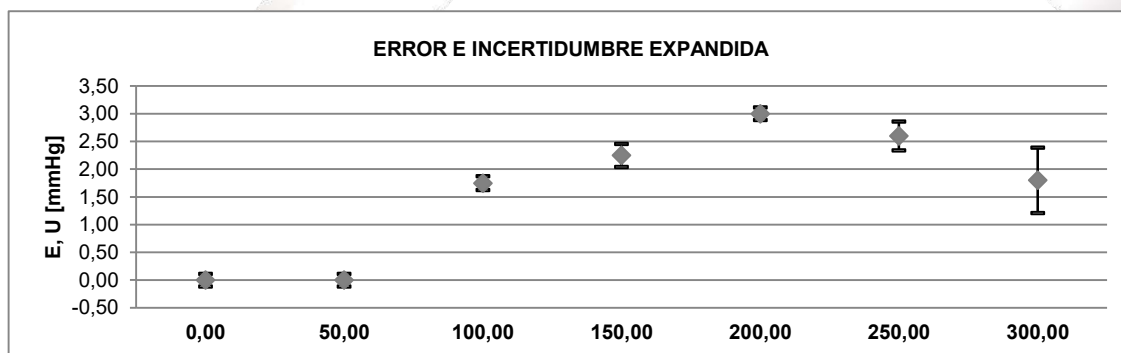

FIN DEL CERTIFICADO