

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40052-26
VALIDATION REPORT No CD-40052-26

Página 1 de 4




Cliente: Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Customer:
Dirección: Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Address:
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
City:
Instrumento: Autoclave
Instrument:
Fabricante: STERIS
Manufacturer:
Modelo: 250L
Model:
Serie No. 0307815-55
Serial No.:
Inventario: AF002555
Stocktaking:
Fecha de Recepción: 02 de junio de 2026
Reception Date:
Fecha de Validación: 02 de junio de 2026
Date of Validation:
Lugar de Validación: Instalaciones Del Cliente
Validation Place:
Ubicación: Área de esterilización
Place:
Método de validación: Comparación directa con patrón simulador, con base en lo indicado en la norma técnica colombiana NTC 4618
Method of Validation:

Este informe de validación no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Validado Por: Ing. Krysty Marcela Tarazona Sanchez
Validated By:

Aprobado Por:
Approved By:


Ing. Alfonso Enrique Ortiz Barrios
Gerente General
General Manager

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40052-26

VALIDATION REPORT No CD-40052-26

Página 2 de 4

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Inicial	Final	Δ
Temperatura	26 °C	27 °C	1 °C
Humedad Relativa	49 %	52 %	3 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).


Equipo Patrón	Código Interno	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Datalogger de presión	CMB-015	NC-20-09-22-186	Madgetech	25/09/2020
Datalogger de temperatura	CMB-021	NC-21-02-22-032	Madgetech	22/02/2021
Datalogger de temperatura	CMB-022	E13101-21	Set & Gad	28/01/2021
Datalogger de temperatura	CMB-024	NC-20-09-25-007	Set & Gad	25/09/2020
Datalogger de temperatura	CMB-017	E12901-21	Set & Gad	28/01/2021
Datalogger de temperatura	CMB-020	E8801-21	Set & Gad	20/01/2021

Resultados de la Validación

Results of Validation

Distribución de los Sensores

Sensor Layout

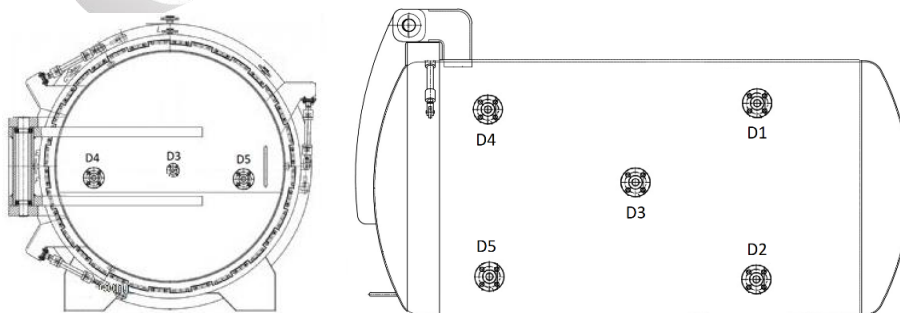

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40052-26

VALIDATION REPORT No CD-40052-26

Página 3 de 4

Calificación Operacional

Operational Qualification

Temperatura en °C

Temperature in °C


Temperatura Programado en Autoclave			121
Valor del Indicador del Autoclave	Valor Medido con Sensores Patrones	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
122,00	125,09	-3,09	0,58
Otros Parámetros		Valor Obtenido	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
Uniformidad del Autoclave		0,545	0,046
Estabilidad del Autoclave		1,54	0,17
Temperatura Mínima Medida		122,67	0,26
Temperatura Máxima Medida		125,83	0,25
Desviación de Temperatura en el Tiempo		3,0700	0,0020
Desviación de Temperatura en el Espacio		0,26	0,045

Presión en psi


Pressure in psi

Valor del Indicador del Autoclave	Valor Medido con Sensores Patrones	Error	Incertidumbre Expandida $\pm U_{EXP}$
19,25	19,25	0,00	0,04

TEMPERATURA DEL CICLO COMPLETO

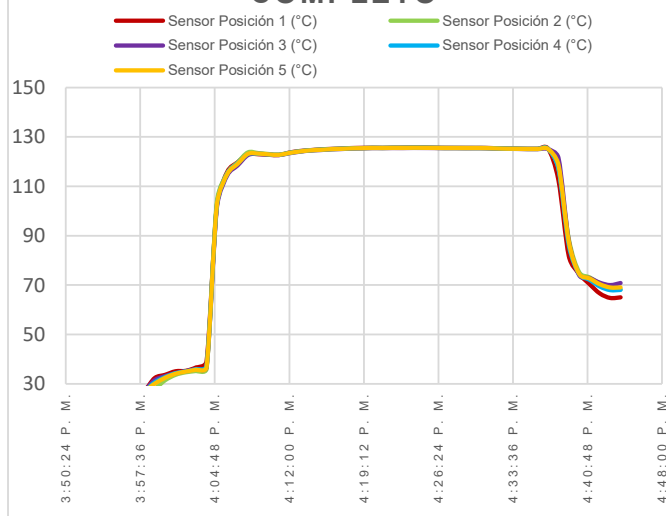

TEMPERATURA EN LA MESETA DE ESTERILIZACIÓN

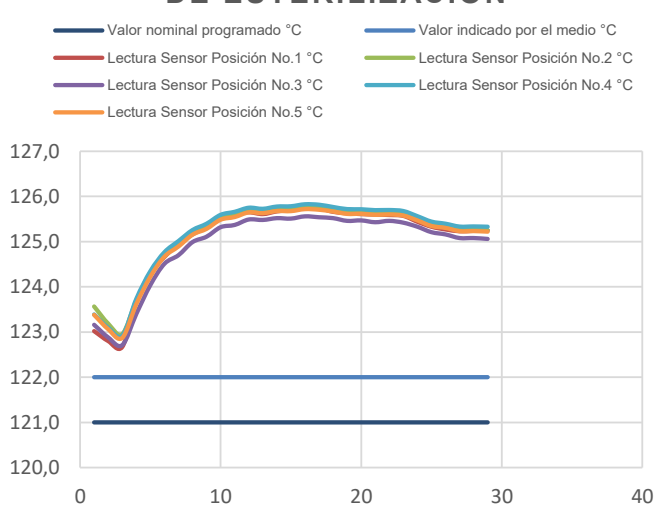

INFORME DE VALIDACIÓN No CD-40052-26
VALIDATION REPORT No CD-40052-26

Página 4 de 4

Análisis del Agua
Water analysis

Magnitud	Unidad de medida	Valor Medido Patrón	Criterio de Aceptación	Cumplimiento
Conductividad Eléctrica	$\mu\text{S/cm}$	45	$\leq 50 \mu\text{S/cm}$	Pasa
Salinidad y Dureza	mg/l	15	$\leq 21 \mu\text{S/cm}$	Pasa
Grado de Acidez o Alcalinidad (pH)	N/A	8	6.5 a 8	Pasa

Prueba de Control Biológico
Biological Control Test

Para la prueba de control de biológico se utiliza **Indicador biológico independiente** de la marca **STERIS** modelo **VERIFY** el cual contiene esporas de **Geobacillus stearothermophilus** y **Bacillus atrophaeus** e **Incubadora de indicadores biológicos** con 6 puestos de la Marca **STERIS** con **Serial No. 16451029** la cual nos da la lectura final del indicador después de 24 horas para la esterilización mediante vapor.

Incubadora de Indicadores Biológicos



Resultado del control biológico

Indicador Biológico Independiente



Pasa

FIN DEL CERTIFICADO