



# Classification

$$P_{iso} = (0.04, 0.96)$$
$$P_{sig} = (0.84, 0.16)$$

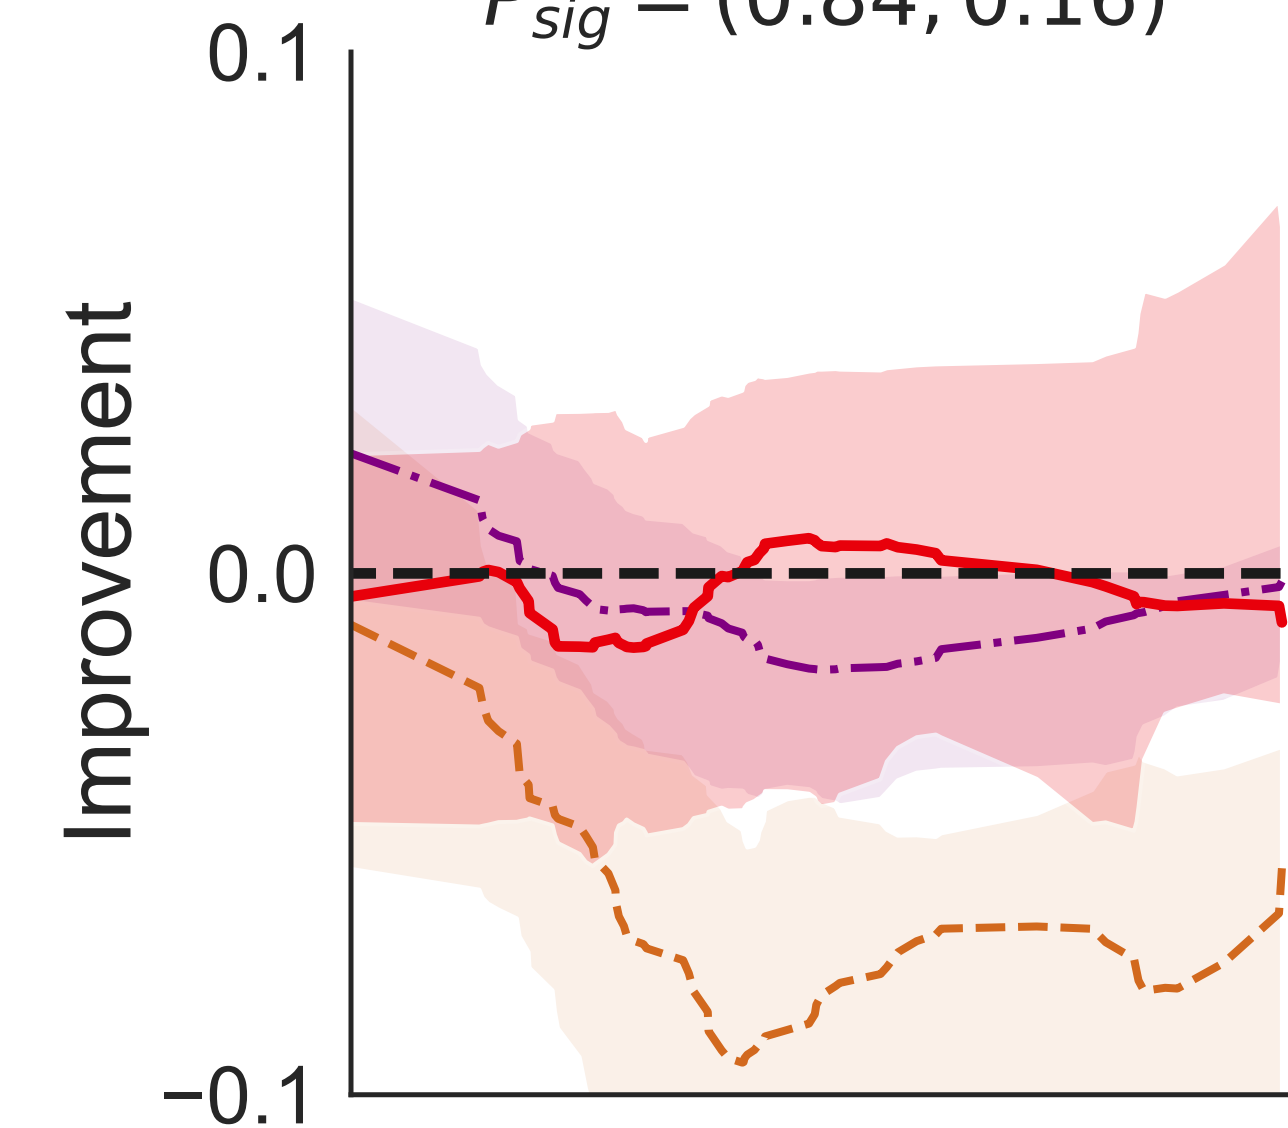


# ID Calibration

$$P_{iso} = (0.70, 0.30)$$
$$P_{sig} = (0.20, 0.80)$$

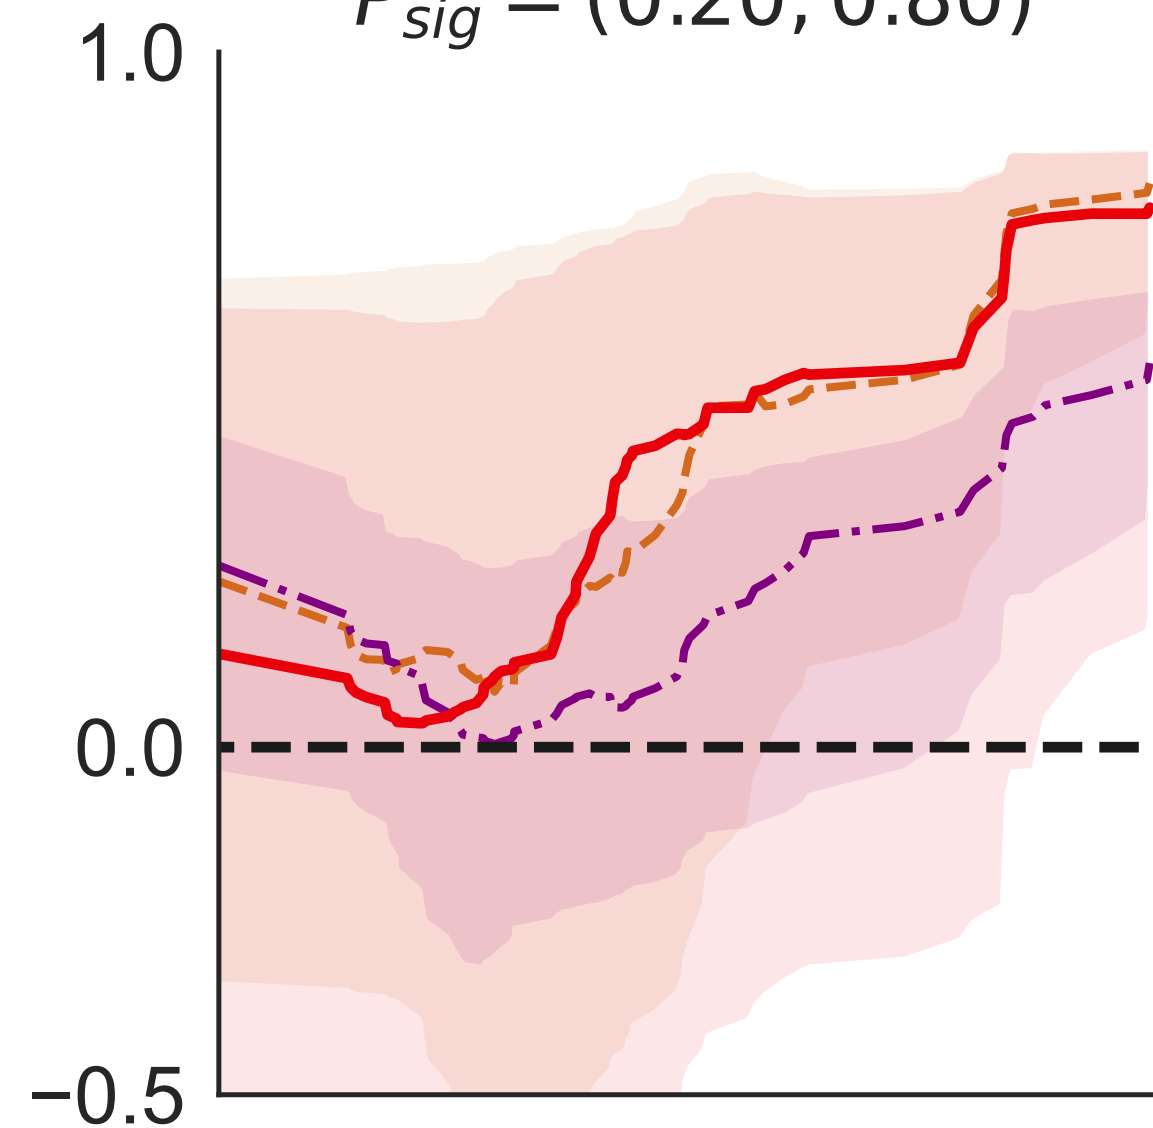


# OOD Calibration

$$P_{iso} = (2.22e-11, 1.0)$$
$$P_{sig} = (7.21e-11, 1.0)$$

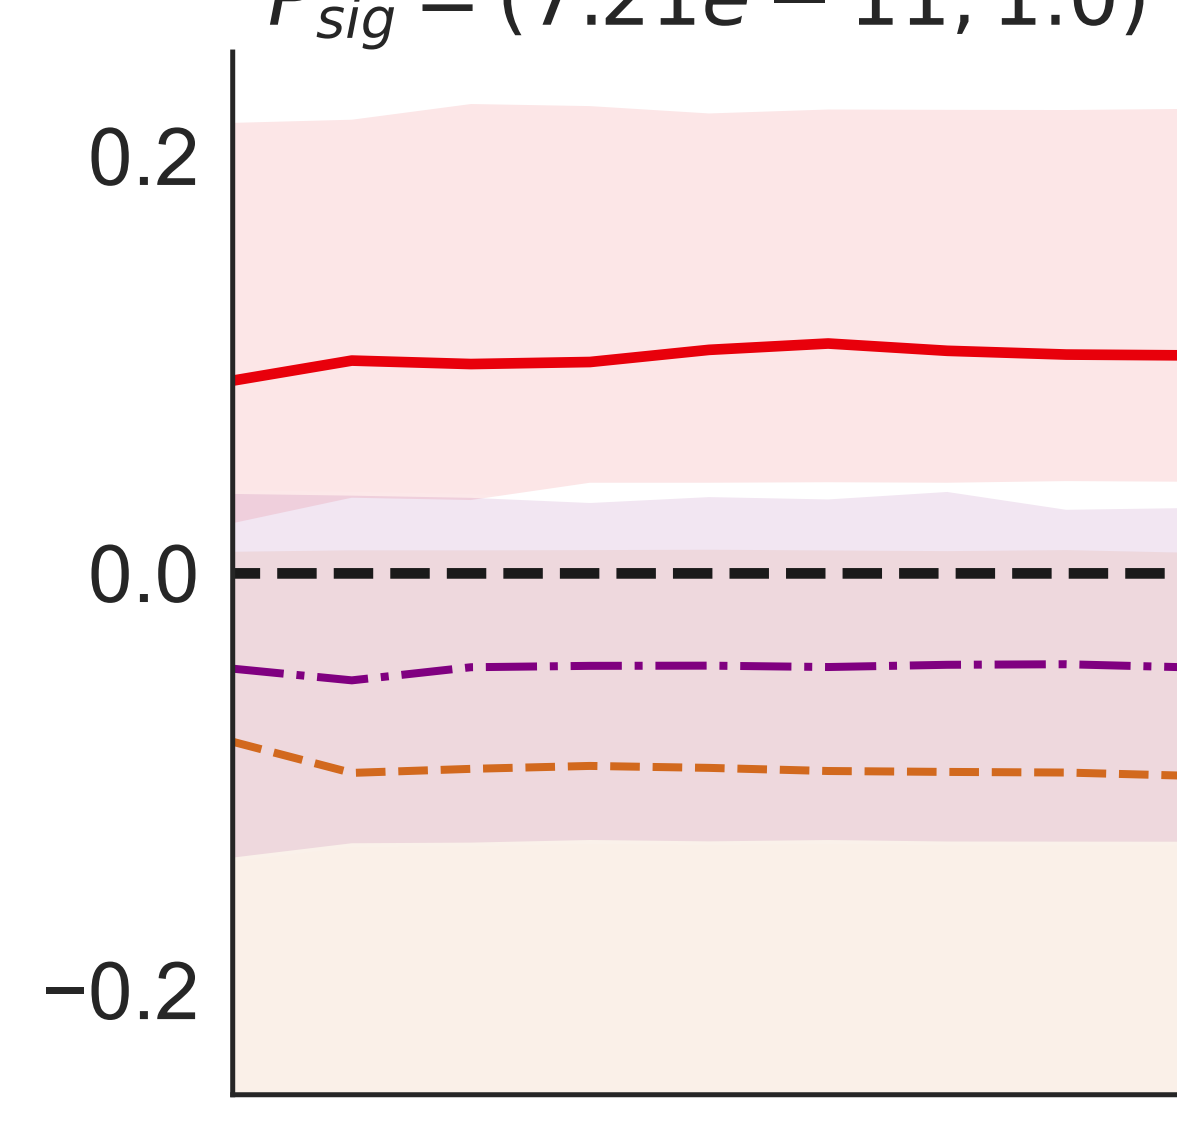


- KDF
- Isotonic RF
- Sigmoid RF
- Parent RF


$$P_{iso} = (3.16e-3, 1.0)$$
$$P_{sig} = (0.01, 0.99)$$

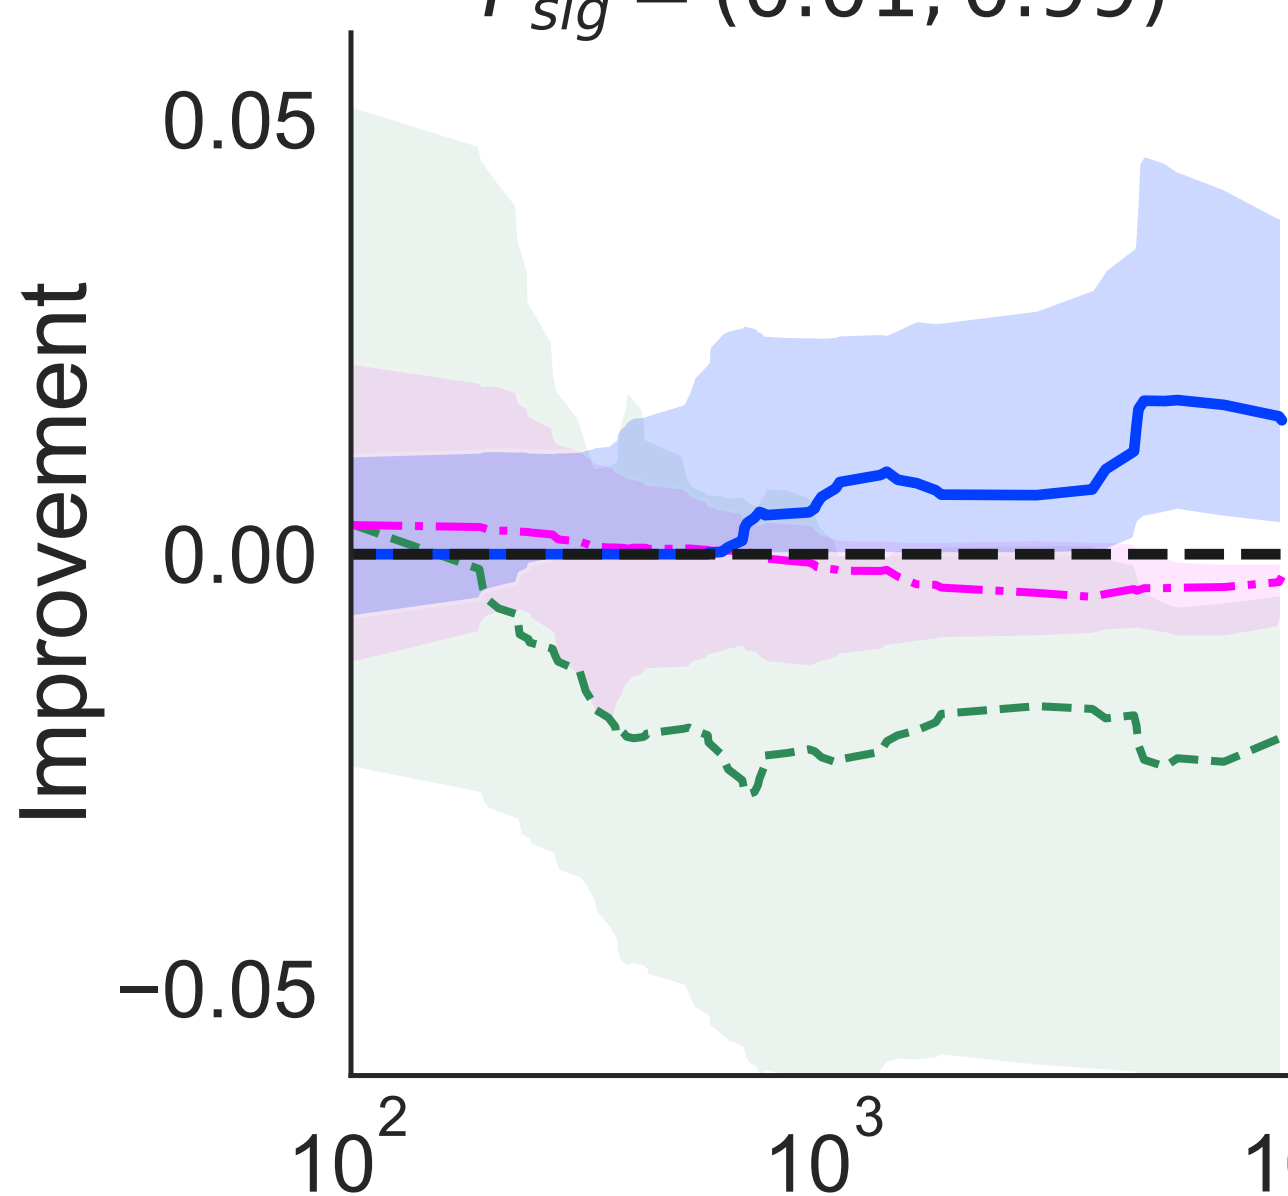

$$P_{iso} = (0.38, 0.62)$$
$$P_{sig} = (0.34, 0.66)$$

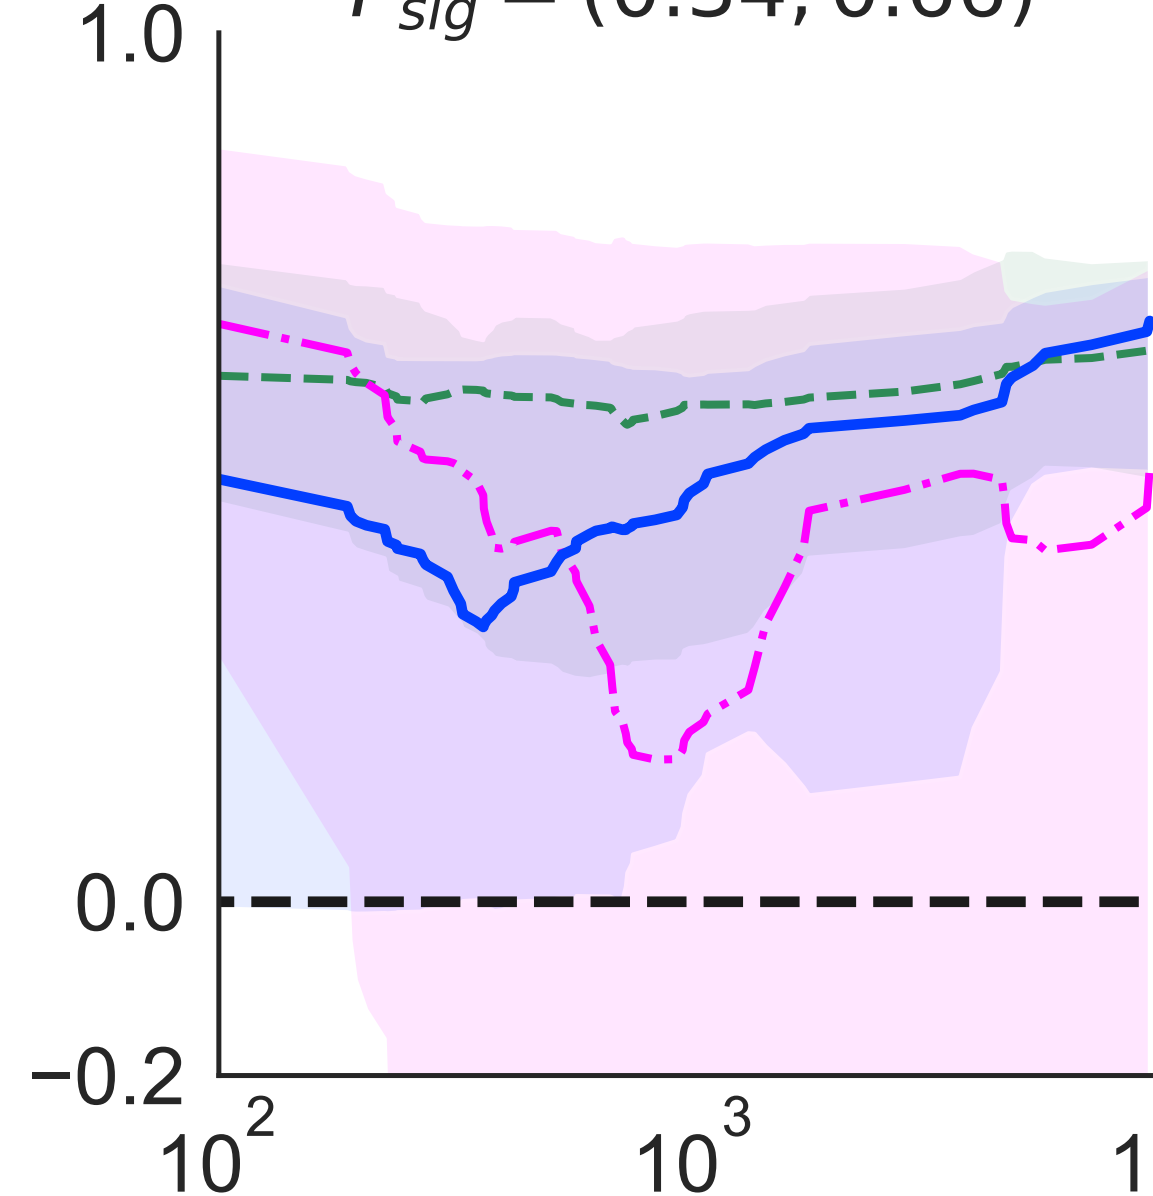

$$P_{iso} = (1.93e-14, 1.0)$$
$$P_{sig} = (9.73e-12, 1.0)$$

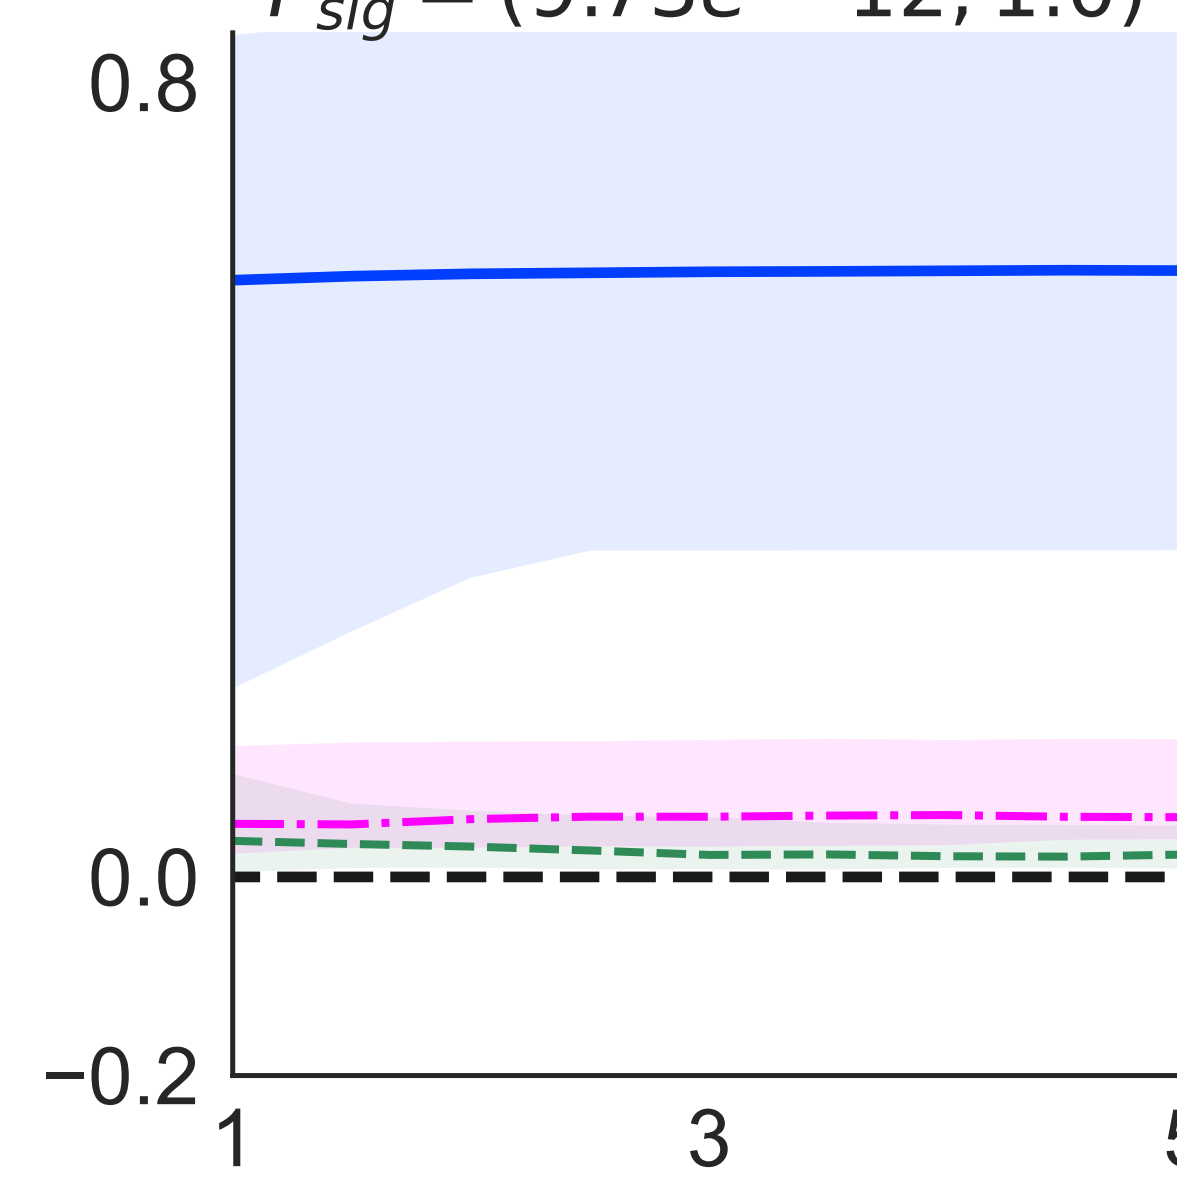

- KDN
- Isotonic DN
- Sigmoid DN
- Parent DN