



Mobilité

V1 04/2020

Traçabilité de l'oxygène

Résultat sur M 3

Prérequis

Impression d'une
étiquette immo

Pour imprimer une étiquette IMMO pour une bouteille d'O2
Ouvrez la fonction "**disponible imprimer détail**" dans le navigateur, menu impression étiquettes
Notez le numéro de la bouteille dans les cases "**Numéro de lot**" puis faire **Suivant**



M3 Disponible. Imprimer Détail - MMS640/E GROUPE ASTERA OXY...

Actions Options Associées Outils Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Zoom Aide

Sélection

Début Fin

Dépôt: 01X 01X

Emplacement: -

Numéro Immo: 1900316406 1900316406

Fermer Sélection Suivant

Tous les champs de ce nouvel écran doivent être renseignés. PRTOX est le nom par défaut de l'imprimante des étiquettes. Format état : **2-No lot**

Faire **Suivant**

Un encarre s'affiche indiquant que le travail d'impression est en cours, faire **OK** —————
L'étiquette doit être collée sur un porte étiquette et celui doit être placé sur la poigné de transport de la bouteille.

ATTENTION: ce porte étiquette doit être retiré lors du retour de la bouteille au fournisseur

M3 Disponible. Imprimer Détail - MMS640/F GROUPE ASTERA OXY...

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Zoom Aide

Sélection


Edition design: ☒

Format état: 2-No lot

Imprimante étiquette: PRTOX

Fermer Sélection Sélection

5

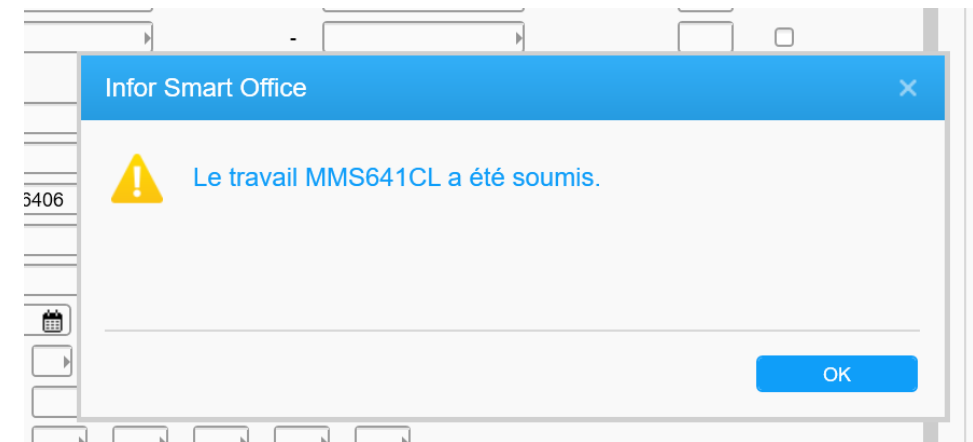

Scannez le numéro de la bouteille ou
notez son numéro grâce au clavier du PDA

N° Appareil

DECONN RETOUR SUIV

MobiControl Agent 14:17

Datamatrix

Code Article DT280L

Libellé OXYGENE MED OXAL CH3,2M

N° Appareil 2000344077

La bouteille est renseignée

DECONN RETOUR SUIV

Scannez le datamatrix de la bouteille

MobiControl Agent 14:17



Datamatrix


Code Article DT280L

Libellé OXYGENE MED OXAL CH3,2M

N° Appareil 2000344077

DECONN RETOUR SUIV



MobiControl Agent 14:23

Code Barre

Code Article DT280L

Libellé article OXYGENE MED OXAL C

N° Appareil 2000344077

Lot fournisseur 2012030417X00054UF

Date 030422

DECONN RETOUR

La ref lot 1 est renseignée
ainsi que la date d'expiration

Scannez le code barres se trouvant sur le corps de la bouteille, puis faire **Suivant**

MobiControl Agent 14:23

Code Barre

Code Article DT280L



Libellé article OXYGENE MED OXAL C


N° Appareil 2000344077

Lot fournisseur 2012030417X00054UF

Date 030422

DECONN RETOUR

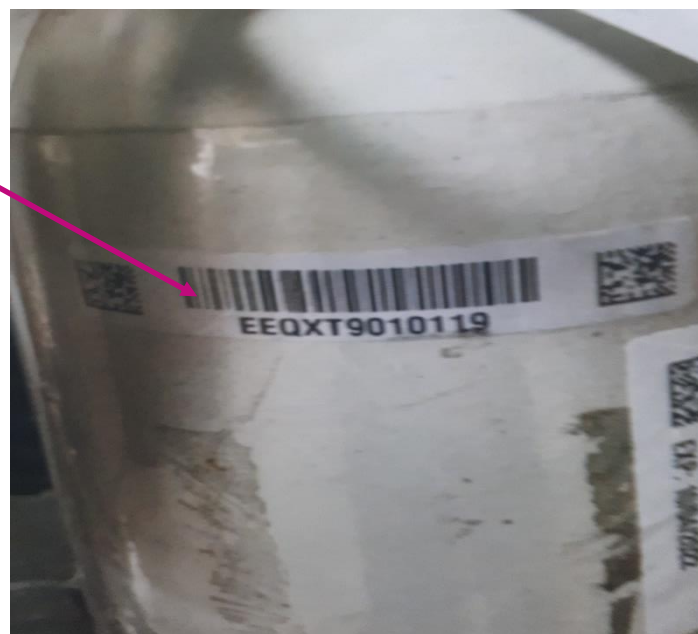

Info appareil 14:24

Code Barre

Code Article DT280L

Libellé article OXYGENE MED OXAL C

N° Appareil 2000344077




Lot fournisseur 2012030417X00054UF

Date 030422

N° série EEQXT9010119

Le n° de série fab est renseigné

DECONN RETOUR SUIV

Les informations de traçabilités sont renseignées dans M3

M3 Numéro Lot/Série. Ouvrir/Connecter Art - MMS235/E GROUPE AS... | _ □ ×

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher

Zoom ? Aide

[En-tête d'écran](#)

Code art: DT280L OXYGENE MED OXAL CH3,2M3 B15

Numéro immo: 2000344077

[Informations de base](#)

Etablissement: 01X ST ETIENNE

Affectable: ☒

Type de lot: 2-Saisi, no série ▾

N° série fab: EEQXT9010119 *

Date Expiration: 030422 📅

Date péremption: 📅

Ref Lot 1: 2012030417X00054UF

Ref Lot 2:

✕ Fermer B Parcourir E Informations de base < Suivant >

