

PULSE

V1 - Jan 2024





Les préalables



Les préalables


- Toute saisie doit être faite dans M3
 - Consommable
 - Echange de DM
- puis importer dans PULSE




Les visites de suivi respi



Regarder le planning des techniciens

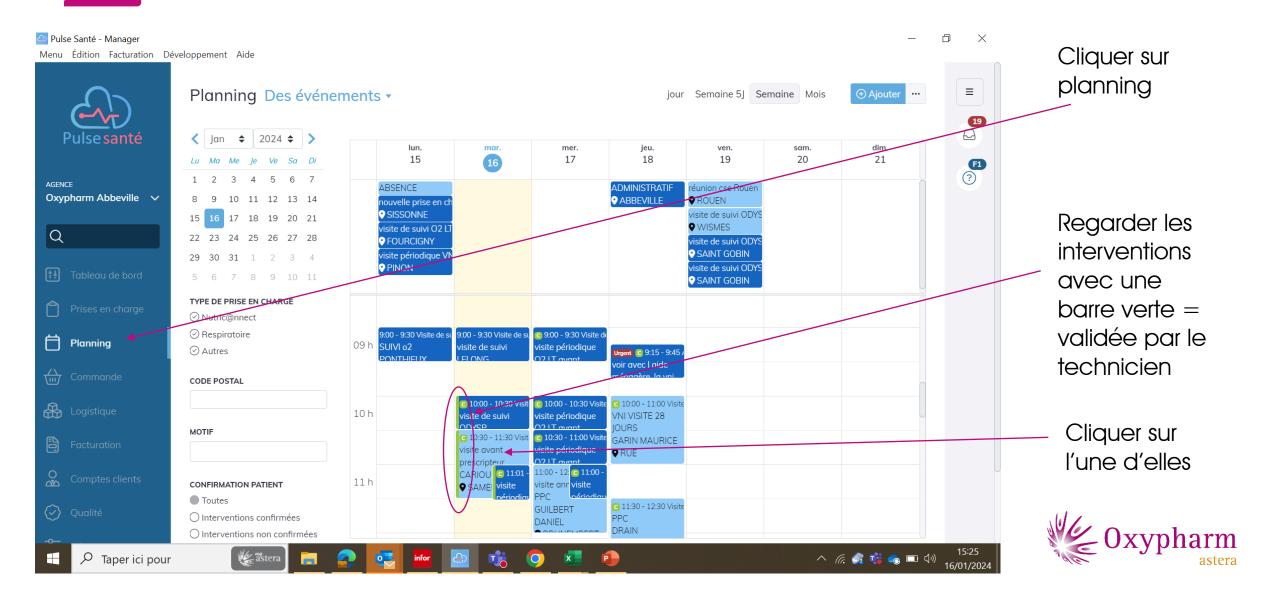


Sélectionner une intervention

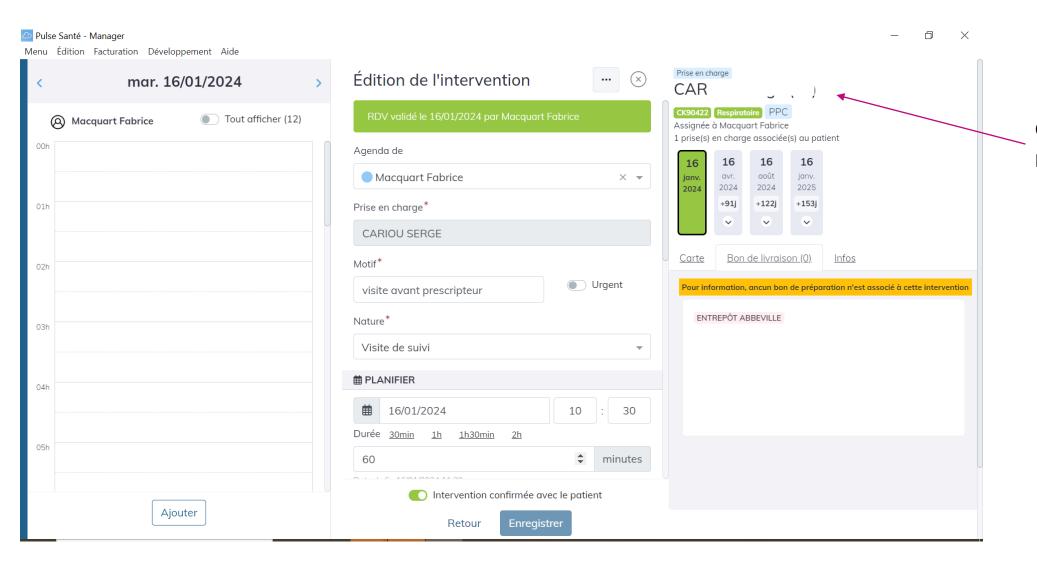

Cliquer sur le nom du patient




Regarder l'intervention sur le dossier patient

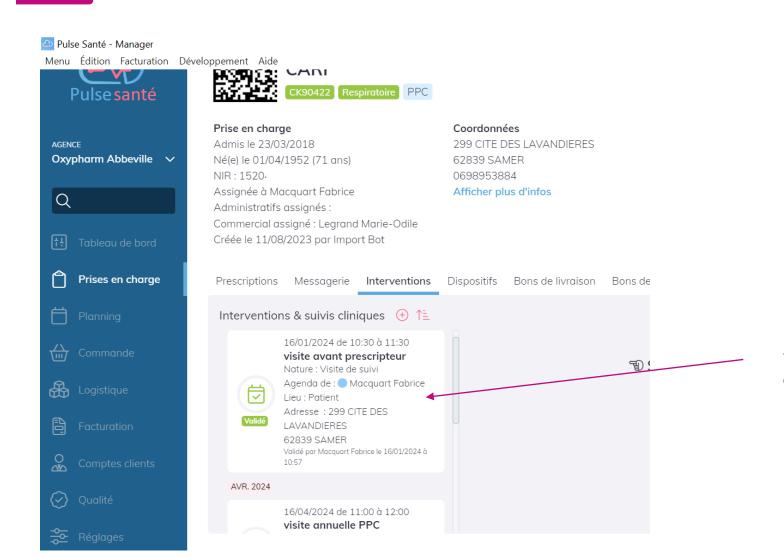

Sélectionner l'intervention en cliquant dessus



Consulter l'intervention

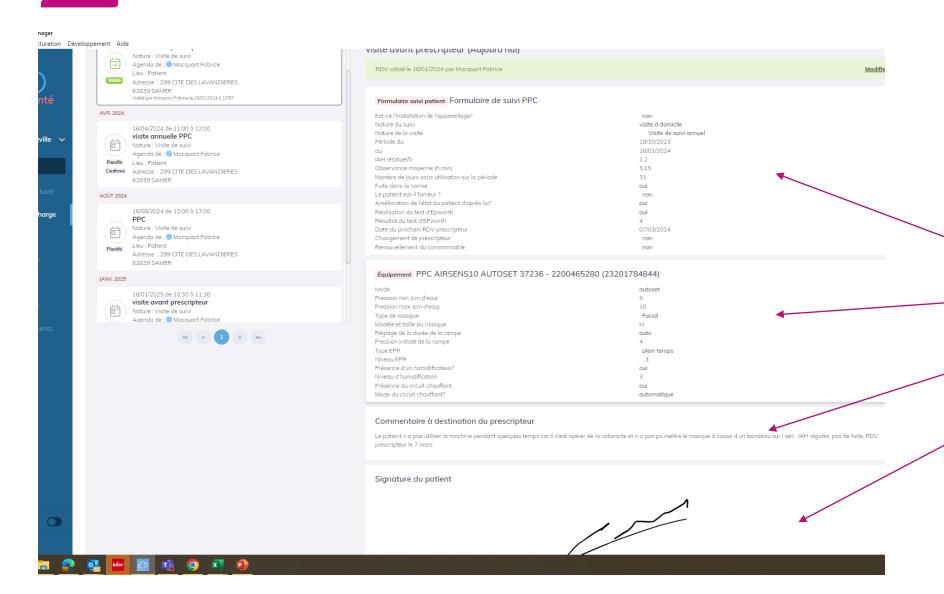


Les informations renseignées par le tech apparaissent avec :


- Le questionnaire patient
- Le questionnaire machine
- Le commentaire
 au prescripteur
- La signaturepatient



Rédiger le CR 02

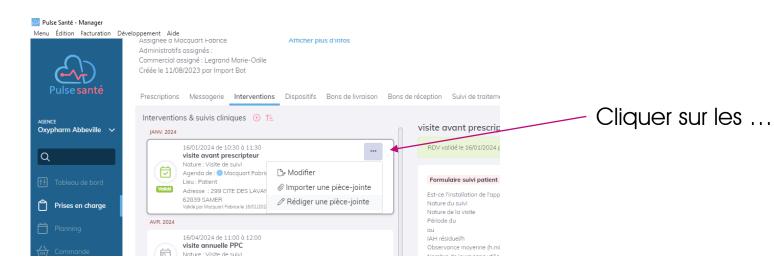


Puis sélectionner le CR que vous souhaitez rédiger

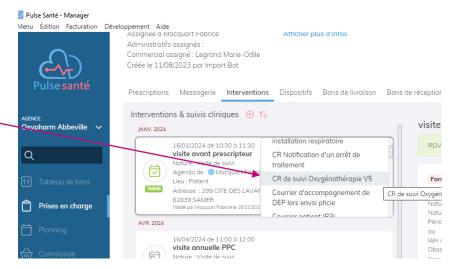



Rédaction du CR 02

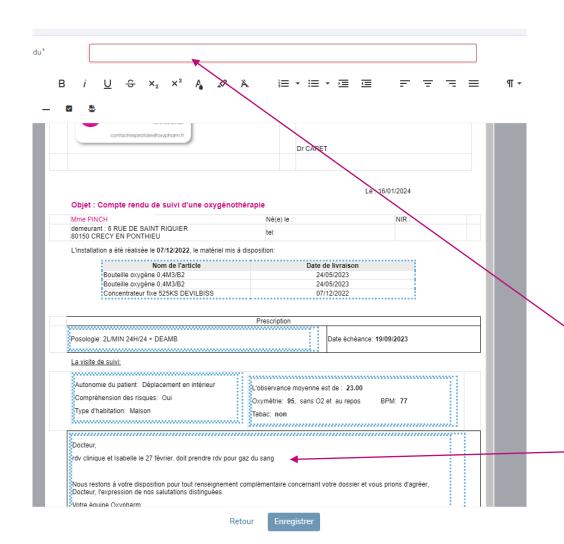

Les champs bleus sont des champs qui remontent automatiques les infos saisies dans les suivis de tech ou le questionnaire médicale


Vérifier la syntaxe et l'orthographe des éléments, corriger si nécessaire

Nommer le document: CR du XX/XX/XX

Puis enregistrer




Vue après réalisation CR 02

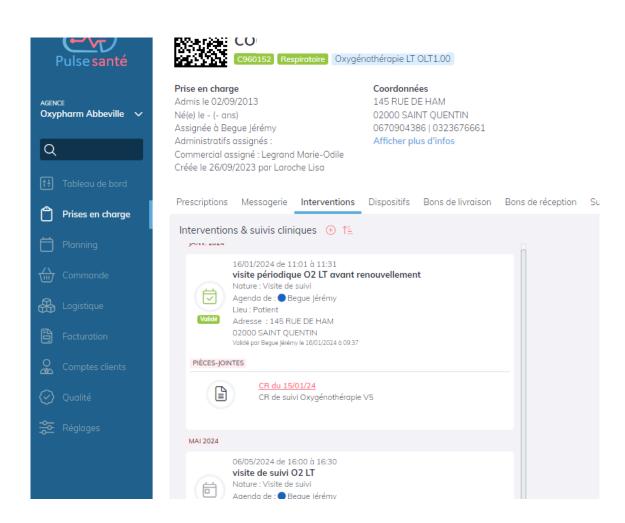

Le CR reste ainsi lié à l'intervention concernée



Editer le CR PPC/VNI

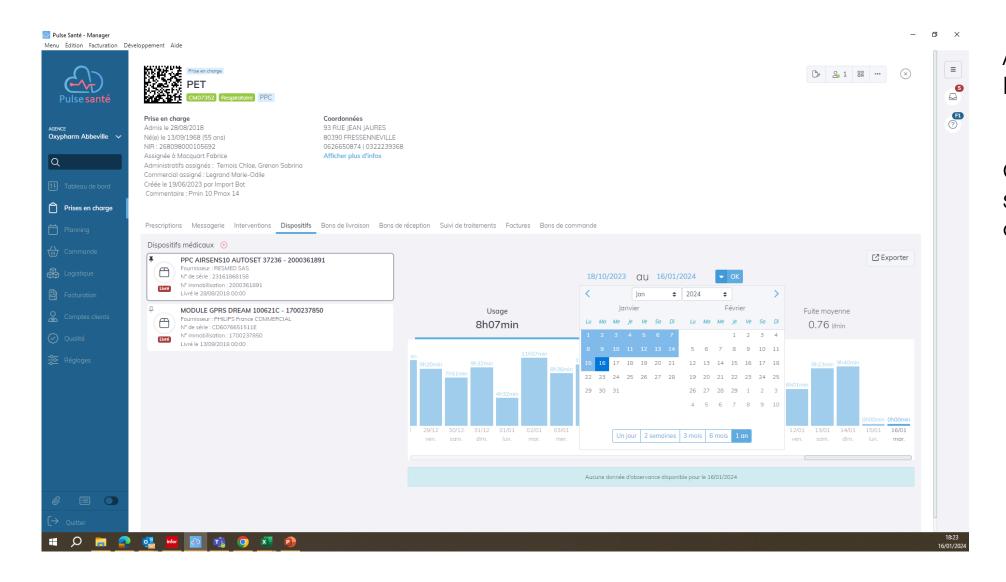


Aller sur l'onglet Dispositif

Choisir la période souhaitée (par défaut 1 an)




Editer le CR PPC/VNI

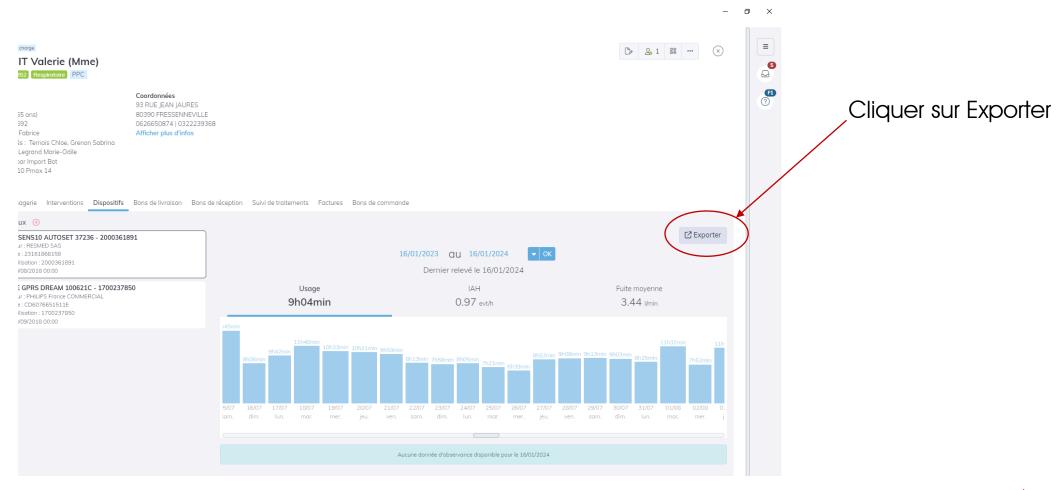



Editer le CR PPC/VNI

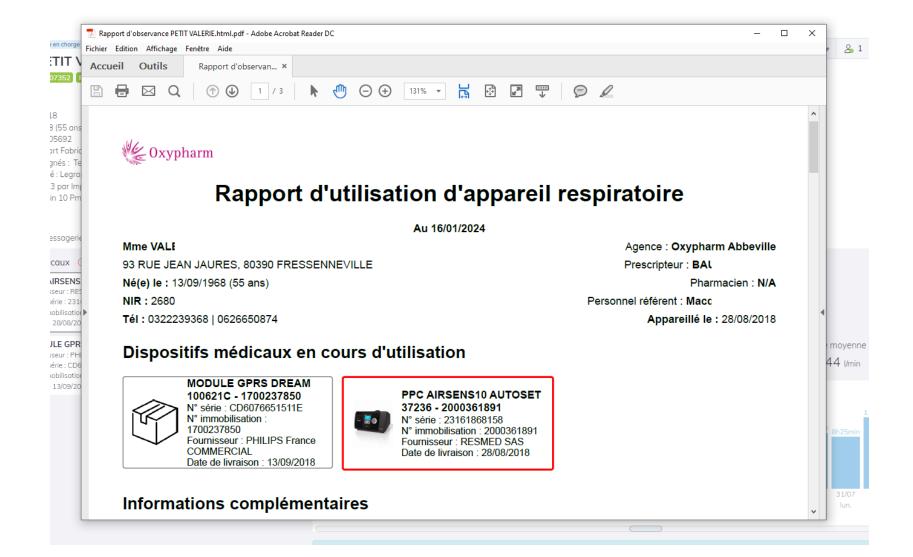

Le CR se crée

Vérifier la dernière page avec le CR du technicien, le modifier sur le suivi d'intervention si besoin et rééditer un CR





