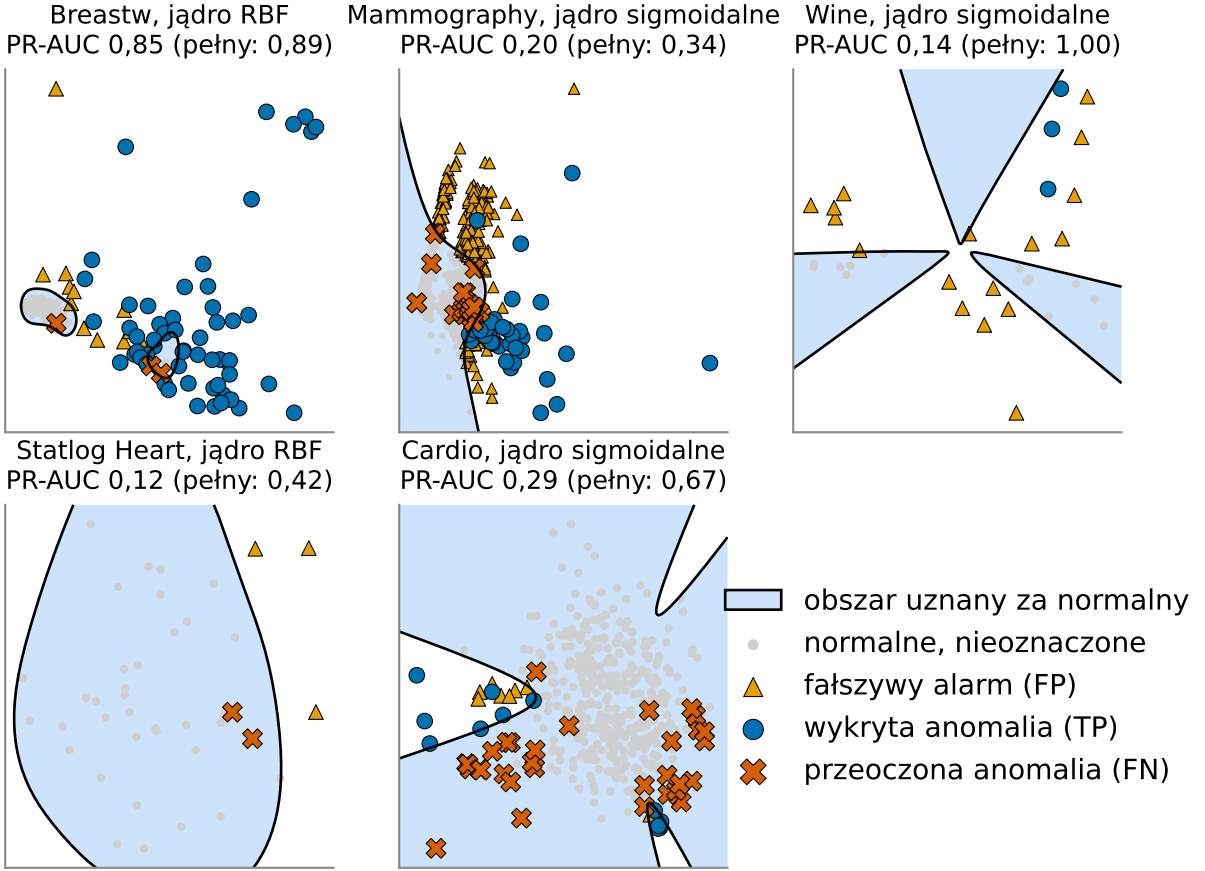

Breastw, jądro RBF
PR-AUC 0,85 (pełny: 0,89)
Mammography, jądro sigmoidalne
PR-AUC 0,20 (pełny: 0,34)
Wine, jądro sigmoidalne
PR-AUC 0,14 (pełny: 1,00)
Statlog Heart, jądro RBF
PR-AUC 0,12 (pełny: 0,42)
Cardio, jądro sigmoidalne
PR-AUC 0,29 (pełny: 0,67)
obszar uznany za normalny
normalne, nieoznaczone
fałszywy alarm (FP)
wykryta anomalia (TP)
przeoczona anomalia (FN)