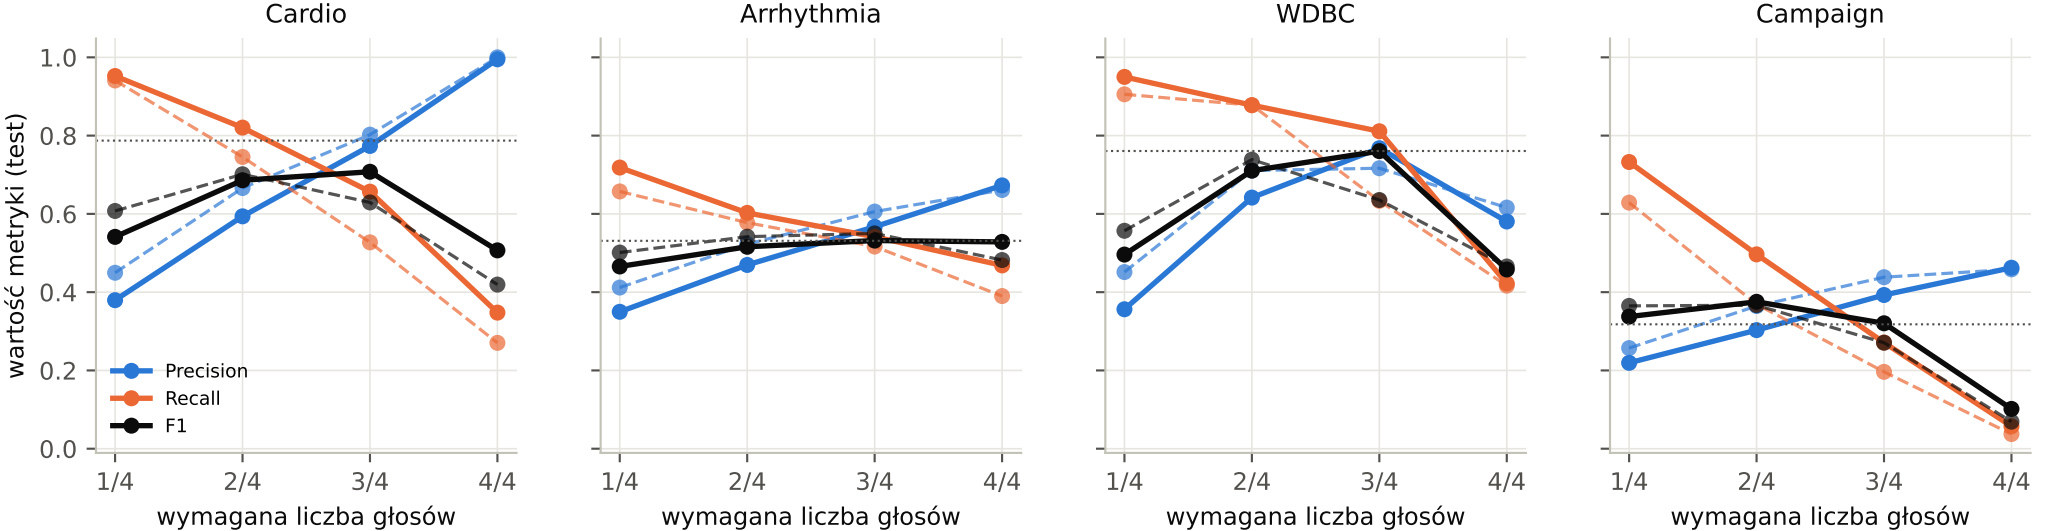
Cardio
Arrhythmia
WDBC
Campaign
wartość metryki (test)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Precision
Recall
F1
1/4
2/4
3/4
4/4
wymagana liczba głosów