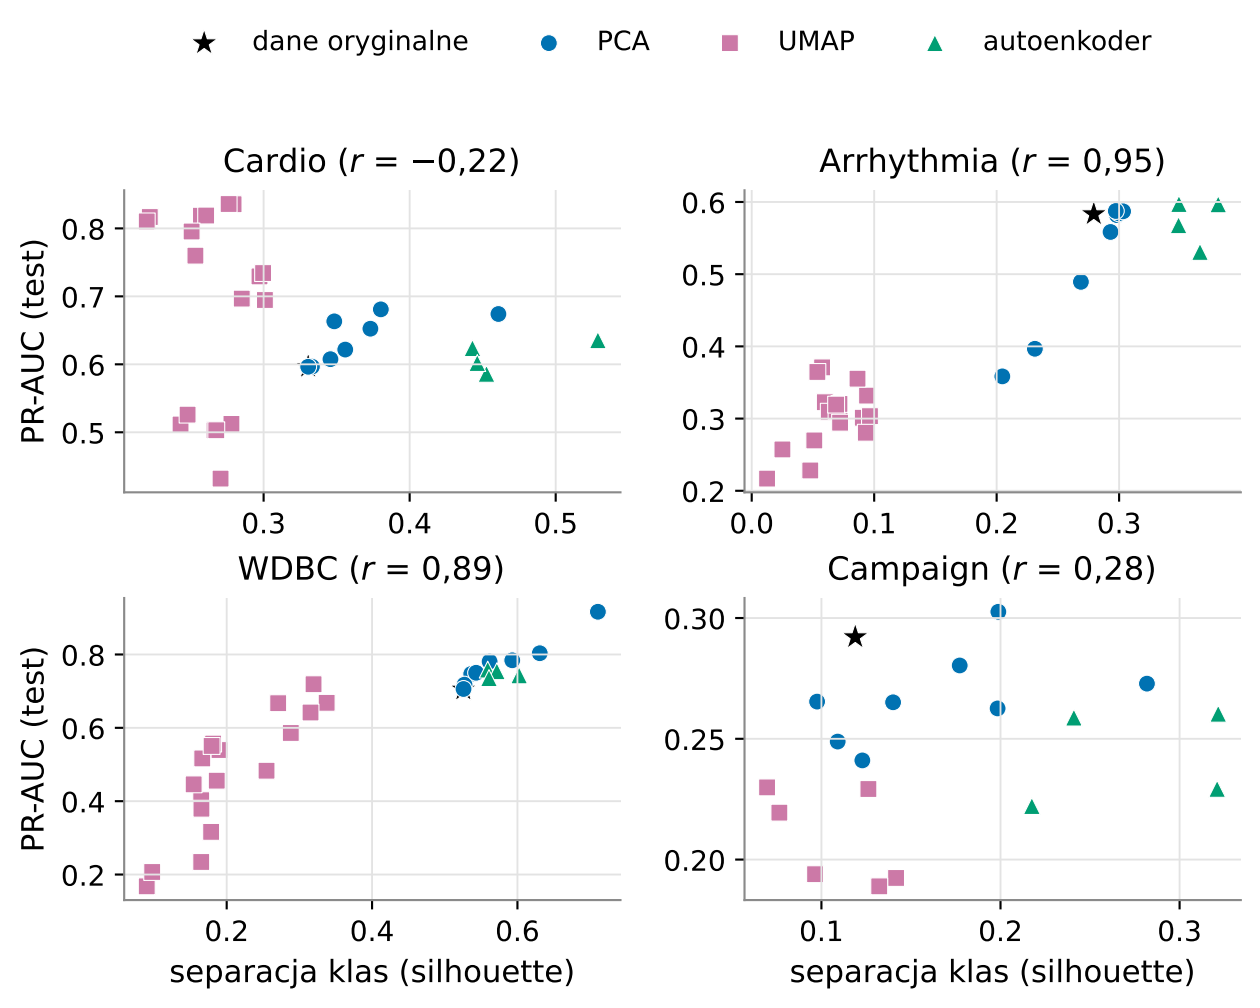
dane oryginalne
PCA
UMAP
autoenkoder
Cardio (r = −0,22)
Arrhythmia (r = 0,95)
WDBC (r = 0,89)
Campaign (r = 0,28)
PR-AUC (test)
PR-AUC (test)
separacja klas (silhouette)
separacja klas (silhouette)