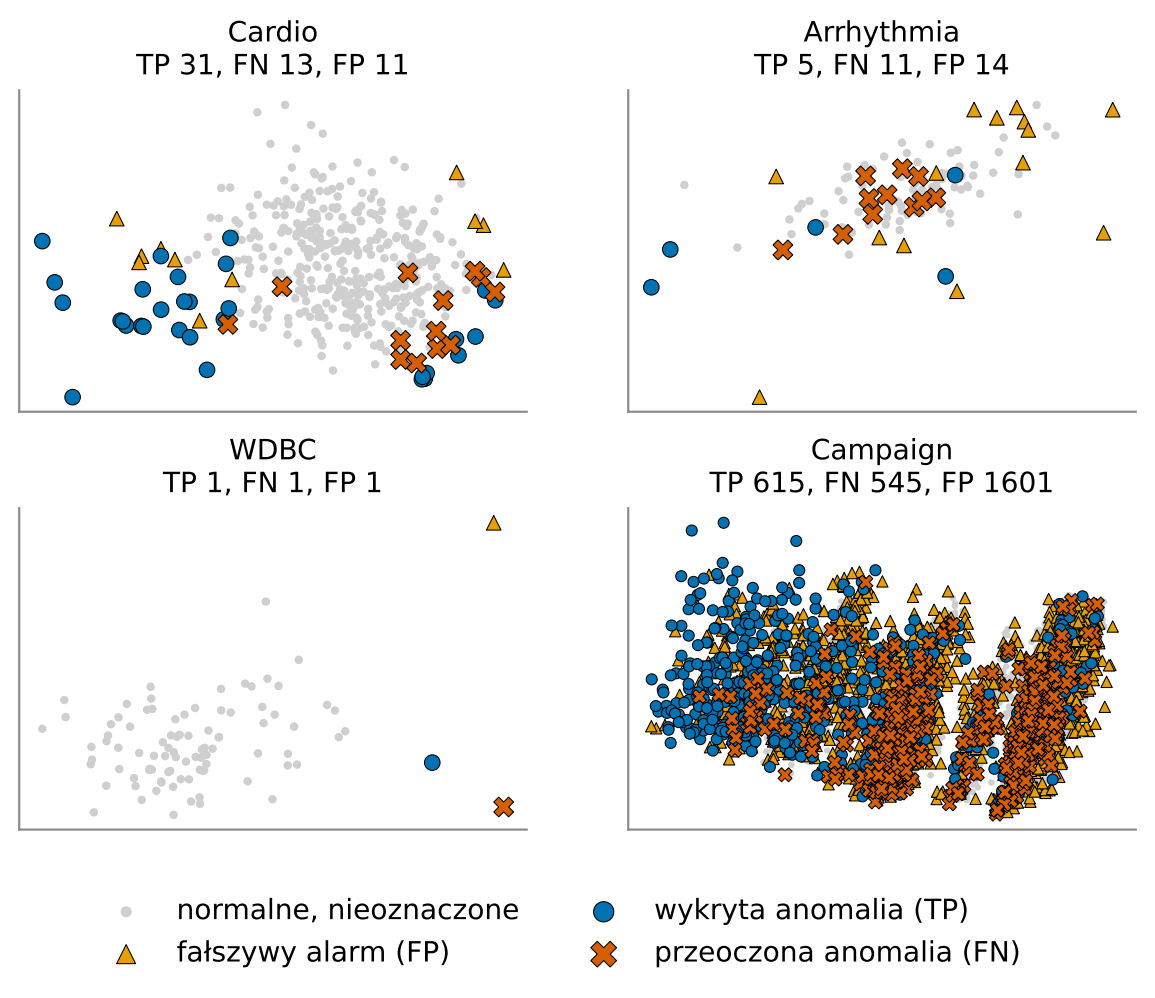

Cardio
TP 31, FN 13, FP 11
Arrhythmia
TP 5, FN 11, FP 14
WDBC
TP 1, FN 1, FP 1
Campaign
TP 615, FN 545, FP 1601
normalne, nieoznaczone
wykryta anomalia (TP)
fałszywy alarm (FP)
przeoczona anomalia (FN)