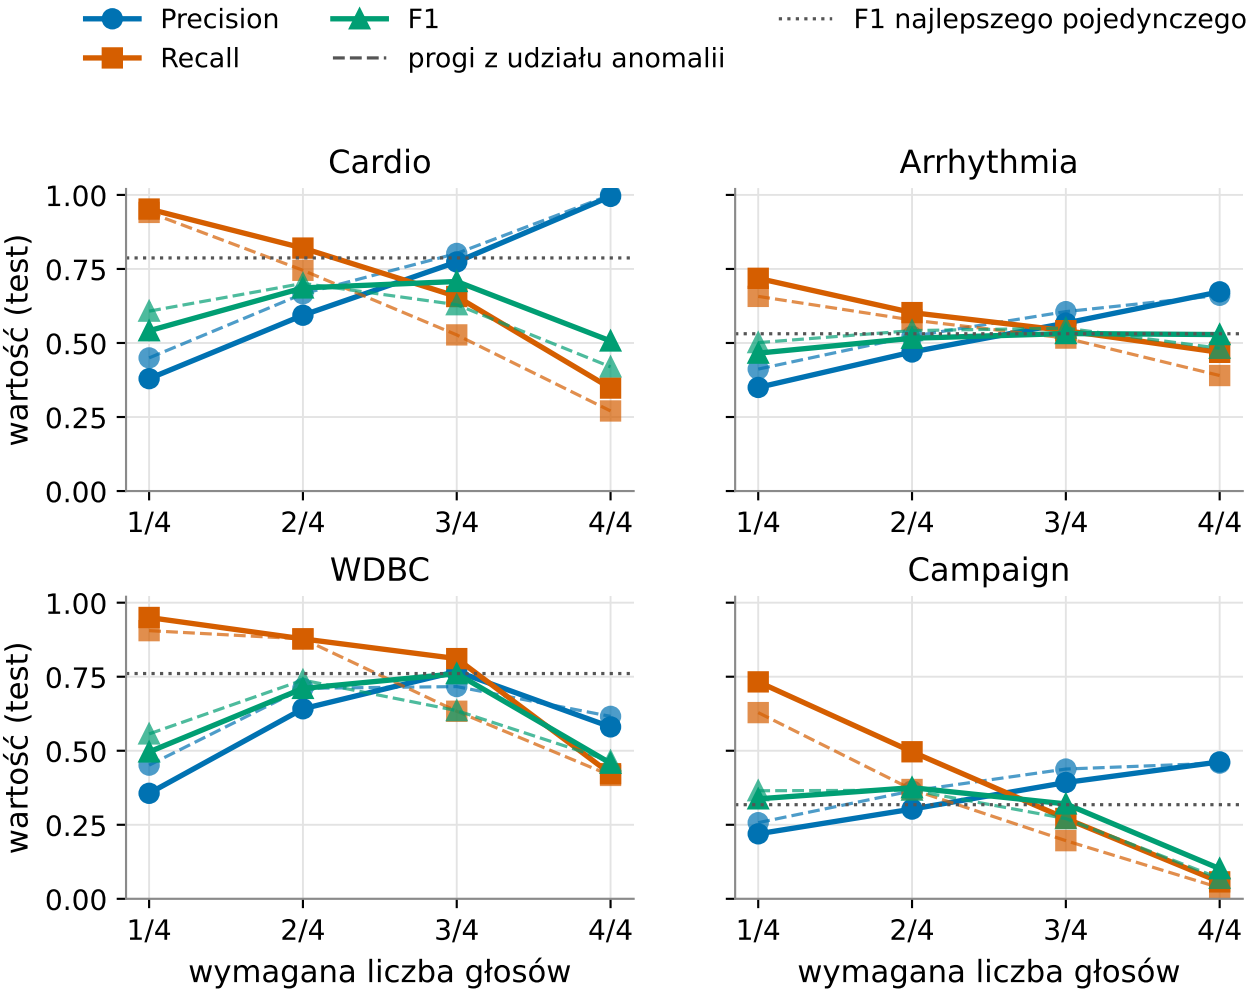
Precision
Recall
F1
progi z udziału anomalii
F1 najlepszego pojedynczego
Cardio
Arrhythmia
WDBC
Campaign
wartość (test)
wartość (test)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1/4
2/4
3/4
4/4
wymagana liczba głosów
wymagana liczba głosów