PHILIPS

OmniWire

Pressure guide wire

Models:
89185/89185J



Instructions for use


Intentionally left blank.

符号	标准	参考	标题	说明
	ISO 15223-1	5.1.5	批次代码	指示制造商的批次代码，可由此识别批次。
	ISO 15223-1	5.1.6	产品目录号	指示制造商的产品目录号，可由此识别医疗设备。
	ISO 15223-1	5.1.7	序列号	指示制造商的序列号，可由此识别具体的医疗设备。
	ISO 15223-1	5.1.1	制造商/经销商	指示符合欧盟指令 90/385/EEC、93/42/EEC 和 98/79/EC 的医疗设备制造商信息。
	ISO 15223-1	5.2.8	如果包装损坏，请勿使用	指示如果包装已经损坏或打开，则不应使用该医疗设备。
	ISO 15223-1	5.2.3	环氧乙烷灭菌	指示医疗设备已经过环氧乙烷灭菌。
	ISO 15223-1	5.3.4	保持干燥	指示需要防潮的医疗设备。
	ISO 15223-1	5.3.2	远离阳光	指示医疗设备需要避光。
	ISO 15223-1	5.4.2	不得重复使用	指示医疗设备仅供一次性使用，或在单次手术中用于同一患者。
	ISO 15223-1	5.2.6	请勿重复灭菌	指示医疗设备仅供一次性使用，或在单次手术中用于同一患者。
	ISO 15223-1	5.6.3	无热原	指示医疗设备无热原。
	ISO 7000	3500	电子版使用说明书	在产品或产品包装上注明产品使用的相关信息以电子形式提供，不提供或不同时提供纸质打印的形式。
	ISO 15223-1	5.1.4	在此日期前使用	指示医疗设备应停止使用的日期。
	IEC 60878	2794	包装内容物： 带接头和扭矩装置的压力导丝；一 (1) 条 备用扭矩装置；一 (1) 件	指示包装内容物。
	IEC 60601-1	Table D.2, Symbol 10	遵照使用说明	参见说明手册/小册子。
	IEC 60417	6049	生产日期和原产国（哥斯达黎加）	标明生产日期和原产国
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	适用	仅凭处方购买	小心：美国联邦法律严格限制由医师销售或订购本设备。

符号	标准	参考	标题	说明
	不适用	不适用	非天然胶乳制成	非天然胶乳制成。
	不适用	不适用	部件号	部件号
	不适用	不适用	唯一设备标识符	唯一设备标识符
	不适用	不适用	医疗设备	医疗设备
	ASTM-F2503-13	7.3.3/3.1.14	MR 不安全	对 MR（磁共振）环境中的患者、医务人员或其他人员造成不可接受风险的物品。
	不适用	不适用	长度	长度
	不适用	不适用	外径	外径
	不适用	不适用	进口商	指示将医疗设备进口到本地的实体。
	不适用	不适用	直形头端	直形头端
	不适用	不适用	形头端	形头端

使用说明
OmniWire 压力导丝

Chinese (PRC)/简体中文

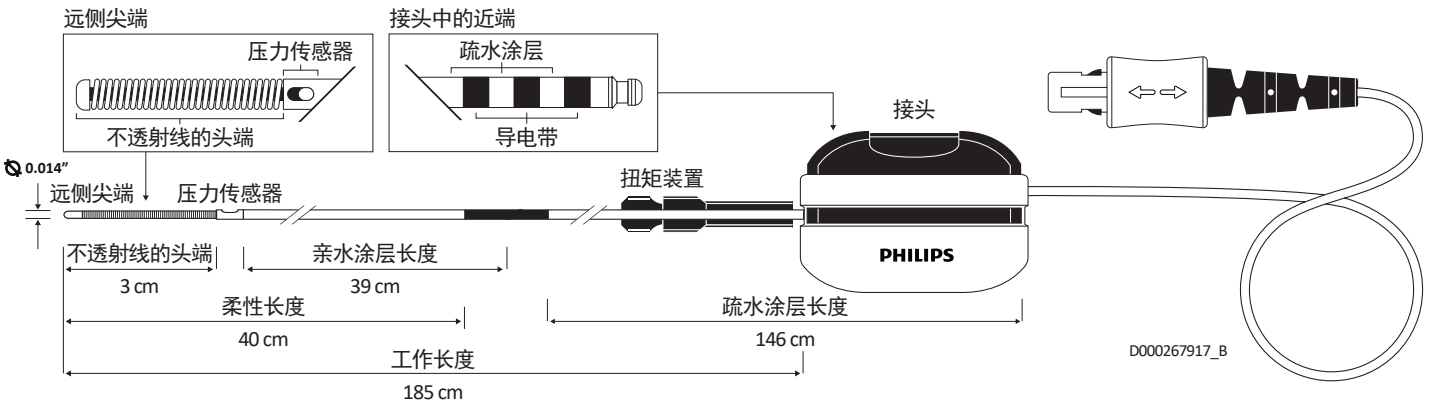

小心：

1. 美国联邦法律严格限制由医师销售、使用或订购本设备。
2. 使用之前，请完整阅读本包装说明书。

使用说明：

OmniWire 压力导丝适用于在诊断性血管造影和/或介入程序中测量血管内压，包括冠状动脉和外周血管。其也可辅助在冠状动脉和外周血管中放置导管以及其他介入设备。血压测量为血管疾病的诊断和治疗提供血液动力学信息。

说明：

OmniWire 压力导丝（以下简称“压力导丝”）是一种可操纵导丝，在距离头端附近 3 cm 处装有压力传感器。压力导丝在与 IntraSight 和 Core 系列系统配合使用时测量压力，旨在用于适合接受血管内手术的成年患者。压力导丝的直径为 0.014” (0.36 mm)，长度为 185 cm，有直形或预成型头端可供选择。其远端部分涂有亲 水涂层（长度 39 cm），以减少表面摩擦并增强润滑性。此外，其近端部分涂有 疏水涂层（长度 146 cm），以减少表面摩擦。压力导丝在包装时已经连接接头，并配有 OmniWire 专用扭矩装置，以便于在血管间导航。

OmniWire 的临床应用是检测血液动力学显示的显著狭窄。使用压力导丝作为引导经皮介入的辅助程序可以限制与非必要的介入手术（例如支架植入术）相关的不良事件，并且与只进行血管造影术相比可以改善临床结局。

禁忌：

OmniWire 压力导丝不可与旋切设备配合使用，也不可用于通过完全血管闭塞。

不良反应：

与所有导管插入术一样，使用压力导丝也可能引起并发症。冠状动脉造影术和冠状动脉成形术的主要风险包括：冠状动脉夹层、闭塞、穿孔、栓塞、痉挛、局部和/或全身感染、气胸、严重心律失常、计划外血管内和/或外科手术、穿刺部位无菌性炎症或肉芽肿、肺 栓塞、肺梗死、心肌栓塞、心肌梗死、栓塞性脑卒中、脑梗死、组织坏死和死亡。外周血管造影术和外周血管成形术的主要风险包括：夹层、突然闭塞、穿孔、栓塞、痉挛、计划外血管内和/或外科手术、穿刺部位无菌性炎症或肉芽肿、肺栓塞、肺梗死，心肌栓塞、心肌梗死、栓塞性脑卒中、脑梗死、组织坏死和死亡。

如果发生了与设备相关的严重事件，则应报告给制造商和用户和/或患者所在成员国的主管部门。严重事件是指直接或间接导致、可能已经导致或再次发生时可能导致以下任何情况的任何事件：患者、用户或其他人死亡；患者、用户、胎儿或其他人健康状况的暂时性或永久性严重恶化，或严重公共卫生威胁。

警告：

- OmniWire 压力导丝的使用应该仅限于熟悉并经过培训、可以执行该设备预期操作的专业人员。
- 本产品以无菌形式提供。如果包装袋在使用前意外打开或损坏而破坏了无菌屏障，请丢弃产品。
- 压力导丝仅供一次性使用。该产品不能重新消毒或重复使用。重复使用和/或对未使用的产品进行再消毒可能会导致但不限于以下风险：
  - 由于设备分离、材料变形或感染/败血症而对患者造成严重伤害；
  - 由于压力传感器损坏导致的压力读数不准确；
  - 机械性能下降（包括但不限于扭转性和跟踪性）
- 请勿使用过期产品。如果产品过期，请丢弃。
- 尚未确定该设备用于神经血管区的安全性和有效性。
- 随附的 OmniWire 扭矩装置仅可与 OmniWire 压力导丝配合使用。
- 请勿推进、扭转或撤回遇到阻力的压力导丝。
- 该设备远端涂有亲水涂层，长度为 39 cm，近端涂有疏水涂层，长度为 146 cm。有关如何准备和使用该设备以确保其按预期运行的更多信息，请参阅读“使用说明”一节。不遵守本标签中的警告可能导致设备涂层损坏，可能必须进行干预或引发严重不良事件。

注意事项：

- 请勿使用存在任何形式损坏的产品，因为可能导致血管损伤、压力测量不准确和/或机械性能不良。
- 为了尽可能降低患者风险，在支架血管内使用压力导丝时应小心谨慎。在支架血管内推进或撤回压力导丝时，如果支架未完全贴附血管壁，压力导丝可能会缠绕在一根或多根支架支杆上。这可能导致压力导丝卡住、压力导丝损坏和/或支架脱位。
- 请勿使用干纱布擦拭压力导丝远端的亲水涂层部分，该操作可能损坏设备涂层。
- 不得使用酒精、抗菌溶液或其他溶剂对压力导丝进行预处理，该操作可能导致涂层发生不可预测的变化，从而影响设备的安全性和性能。
- 推荐按照当地标准血管造影方案并由医生自行决定是否使用抗凝剂，以防止形成血栓。
- 不建议将压力导丝与电外科设备同时使用。
- 请勿将设备暴露于磁共振环境。设备可能无法按预期运行，可能给患者带来额外的风险。
- 已使用 5 French 导引导管证实了压力导丝的性能。当使用任何诊断或导引导管时，应避开侧孔，并小心冲洗所有残留的造影剂，以确保 iFR/FFR 可靠。


局限性：

- 该压力导丝仅与 0.014” (0.36 mm) 辅助设备兼容。

使用说明：

标准工作流程

- 使用无菌技术打开压力导丝包装袋，将托盘放在无菌区内平整表面上。

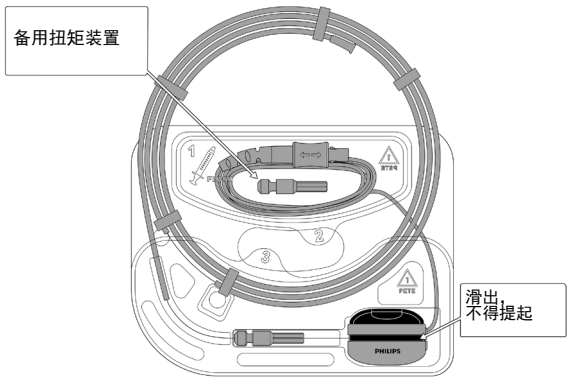


警告： 如果设备的任何部分（导丝、扭矩装置或接头）与非无菌区或非无菌人员接触，则应丢弃。

- 按照托盘上的数字准备待用的压力导丝：

1. 导丝冲洗：通过螺旋套上的导丝冲洗端口，用无菌肝素化生理盐水（标记为 #1）冲洗压力导丝。

2. 导丝调零：抬起带编号的标签，取下盖子（标记为 #2），撤回电缆和备用扭矩装置。将备用扭矩装置置于无菌区内。从盒中取出电缆和备用扭矩装置时应多加小心，因为其并未固定到位。将插头连接至兼容的器械。该操作将自动使压力导丝归零。在调零过程中，导丝应保持静止并位于平整表面上。有关系统操作，请参阅相关的“操作手册”。

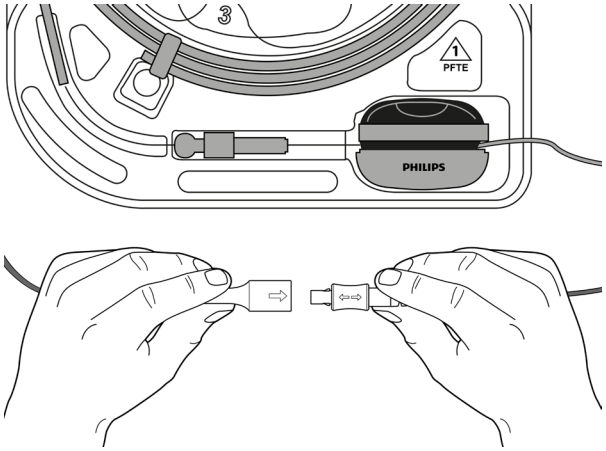

3. 从托盘中取出产品：抬起带编号的标签，取下托盘上的盖子（标记为 #3）。小心地将接头从托盘中滑出，并将导丝滑出螺旋套。导丝和接头置于无菌区。 注意事项：从螺旋套中撤回导丝时，保持接头和导丝处于同一平面，以避免导 丝扭结。

注意事项： 从螺旋套中撤回导丝时，保持接头和导丝处于同一平面，以避免导丝扭结。

注意事项： 请勿抓住压力导丝的头端将其从螺旋套中取出。该操作可能导致压力传感器损坏


- 根据医生的判断，可按照标准头端塑形操作方法小心地对 1 cm 可塑形压力导丝头端进行塑形。为获得最佳效果，请沿传感器护套开口方向对头端进行塑形。请勿使用具有锐缘的塑形器械。头端塑形时应多加小心。请勿握住传感器护套，否则可能损坏压力传感器。
- 通过适当的导引器组件和导引导管将压力导丝插入所需血管。在透视下缓慢推进压力导丝头端，注射造影剂以确认位置。
- 确保头端可自由旋转，并且在施加扭矩时未感觉到阻力。
- 如果感觉到阻力，在取出设备时应小心，并更换新的设备以完成手术。
  注意事项： 如果遇到阻力，不得推进或撤回压力导丝。不得强行将导丝推进血管或从血管中撤回。任何时候遇到阻力时，应在透视引导下缓慢撤回导丝。在某些情况下，导丝可能扭结，必须取出。
- 将压力传感器（距离头端 3 cm 处）放置在与导引导管头端相邻的位置，并使用仪器执行标准化程序。有关系统操作，请参阅相关系统的“操作手册”。
- 如果压力导丝“无法识别”，挤压接头并重新对齐压力导丝（更多说明请参见“将压力导丝连接至接头”一节）。
- 将压力传感器推进至所需测量位置，确保传感器位于狭窄远端，使用仪器进行压力测量。有关如何进行压力测量的详细信息，请参阅“操作手册”。
- 每次手术后，缓慢撤回压力导丝，直至压力传感器恰好位于导引导管头端的远端。确认压力导丝和通过导引导管测得的压力相等。
- 如果需要存放导丝以备后续测量，则将导丝置于无菌区铺巾下方。在重新插入以进行多次测量之前，使用无菌肝素化生理盐水沾湿纱布擦拭导丝。
- 手术完成后，撤回压力导丝，将压力导丝、扭矩装置和接头作为生物危害废物按照当地法规处置

从接头中取出压力导丝

- 可将压力导丝与接头的连接断开，以便于操纵导丝，并使导管和其他辅助设备可以沿导丝的近端推进。

注意：如果插头与器械保持连接，则无需再次调零和标准化。

- 要取出压力导丝，挤压接头，小心地将导丝近端从压力导丝通道中提起。

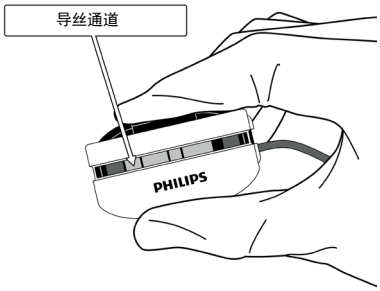

警告：未插入接头时，请勿弯曲压力导丝的近端（电气接头）。过度弯曲可能损坏或破坏内部组件。

- 必要时，松开扭矩装置并将其从压力导丝的近端撤回。

注意事项：卸下扭矩装置时，应多加小心防止涂层损坏。

导管输送

- 沿压力导丝输送导管，注意不要扭结导丝近端的导电带。

警告：当压力导丝与辅助设备配合使用时（例如支架植入术），器械推进/撤回不正确可能影响压力导丝的机械性能、损坏其涂层或产生阻力。

警告：小心不要在压力导丝传感器上部署任何介入装置，该操作可能导致传感器损坏和压力测量不准确。

注意事项：沿导丝安装或卸下辅助设备时，应多加小心防止涂层损坏。

- 有关导管输送，请参阅相应导管设备的《使用说明》。

连接压力导丝与接头

- 在压力导丝的近端安装扭矩装置。由于导丝在接头主体内可自由旋转，接头不能有效地扭转压力导丝。

警告：使用随附的扭矩装置以外的扭矩装置将损坏导丝。如果主扭矩装置不可用（例如无菌性受损），则可使用提供的备用扭矩装置。

注意事项：重新安装扭矩装置时，应多加小心防止涂层损坏。


警告：包装中提供的接头仅可与其连接的压力导丝配合使用，不得与任何其他压力导丝配合使用。使用不同的接头将导致压力测量数据不准确。

- 用无菌肝素化生理盐水清洁压力导丝的近端。在重新连接之前，用干净的干布擦干压力导丝的近端。


警告：未插入接头时，请勿弯曲压力导丝的近端（电气接头）。过度弯曲可能损坏或破坏内部组件。

注意事项：不擦干压力导丝的近端将导致压力测量数据不准确。


- 挤压接头以露出压力导丝通道。
- 握住压力导丝，使其与接头略微成角，并将其放入通道中，使压力导丝从接头中伸出约 0.5 英寸 (1.3 cm)。
- 保持角度不变，拖动压力导丝穿过通道，直到压力导丝对齐凹槽卡入接头上的锁定夹。该操作将对齐压力导丝。

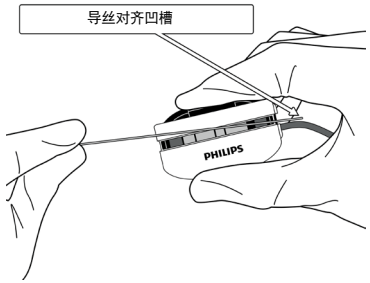

- 将压力导丝放入通道中。

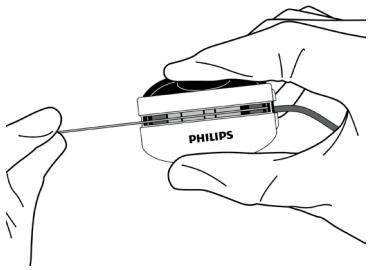

- 松开接头，将压力导丝锁定到位

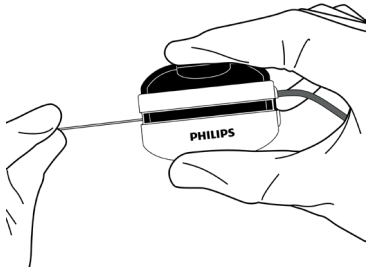

- 此时，显示仪器上将显示压力信号。只要未从仪器中取出模块插头，则无需重复调零和标准化。
- 如果压力导丝“无法识别”，挤压接头并重新对齐压力导丝。

技术规格

工作范围	压力范围：-30 至 +300 mmHg
压力精确度	±3 mmHg，范围为 -30 至 +100 mmHg ±3 %，范围为 +100 至 +300 mmHg

储存和处理：

产品应在室温下以其原始包装储存在室内。

有限保修：

根据本文所述的责任条件和限制，飞利浦保证 OmniWire 压力导丝（“导丝”）在发货时材质上符合飞利浦当时执行的导丝质量标准。**飞利浦有关导丝或性能的任何担保、疏忽、严格赔偿责任或其他理论责任仅限于导丝更换，如果更换不足以作为补救措施或者飞利浦认为提供与该导丝费用等值的抵用额度不切实际。除上述内容外，导丝按“原样”提供，没有任何种类的明示或暗示的保证，包括但不限于任何适用性、可销性、特定用途适用性或非侵权性的保证。此外，飞利浦不对导丝或书面材料的使用或使用结果的正确性、准确性、可靠性进行任何担保、保证或作任何陈述。**许可证持有者了解，飞利浦对飞利浦以外的任何人提供的任何物品或服务概不负责，也不承担任何责任。飞利浦对超出其合理控制范围的延误或故障概不负责。此外，如果出现以下情况，则本保证不适用：

1. **导丝的使用方式与飞利浦在导丝随附的《使用说明》中描述的方式不同，或者导丝被误用、使用时疏忽或发生意外。**
2. **导丝的使用方式不符合购买规范或《使用说明》中包含的规范。**
3. **重复使用或重复消毒导丝。**
4. **未经飞利浦授权的人员或未经飞利浦授权通过任何方式对导丝进行修理、更改或修改。**
5. **未按照“在此日期前使用”或“失效日期”在有效期内使用导丝，或者如果包装在使用之前被打开或损坏。**

如果有必要根据本保修提出索赔，请联系飞利浦以获取有关说明和发放退回材料授权号码的信息（如要退回导丝）。除非得到飞利浦的退货授权，否则不接受将设备退货保修。

专利：www.philips.com/patents

要获取上述说明的电子版，可访问：
www.philips.com/IFU

本产品仅授权客户单次使用。
有关此产品的其他问题，应直接向美国飞利浦公司咨询。

合法制造商：
Volcano Corporation
3721 Valley Centre Drive, Suite 500
San Diego, CA 92130 USA
(800) 228-4728
IGTD.CustomerInquiry@philips.com


美国和加拿大：
(800) 228-4728
IGTD.CustomerInquiry@philips.com

国际：
vecomplaints@philips.com 或
IGTD.CustomerInquiry@philips.com

澳大利亚赞助商：
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road
North Ryde, NSW Australia 2113

中文说明书附页

1. 产品储运温度: -18℃ ～ +60℃；湿度条件：15% RH ～ 90%

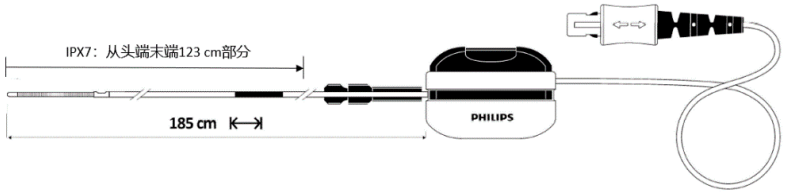

2. 防进液等级:
导丝远端 123cm 部分为 IPX7;

3. 按防电击程度分类：不适用（本产品整体为应用部分，取决于主机设备）

4. 配合主机使用，主机输入电源：见适配主机的说明书，标签铭牌信息；

5. 技术参数:

工作范围	压力范围：-30 至 +300 mmHg
压力精确度	±3 mmHg，范围为 -30 至 +100 mmHg ±3 %，范围为 +100 至 +300 mmHg
漂移	导丝漂移小于6 mmHg/小时
警示：超出工作范围，将不会显示压力读数。	

6. 电磁兼容的要求

对于本设备，需采取有关电磁兼容性（EMC）的特别预防措施，并且必须根据本说明书中规定的电磁兼容信息进行安装和使用。压力导丝符合以YY 0505-2012要求且根据GB 4824-2019分类属于的1组A类。

医用电气设备需要特殊的电磁兼容预防措施，并且需按照此文件中规定的电磁环境下安装使用。便携式和移动式射频通信设备对本设备可能会有影响。

压力导丝自带连接器以及固定于连接器上的压力导丝连接器电缆（长度1.8米，非屏蔽线缆）

警示：除作为内部元器件的备件出售的电缆（换能器）外，使用规定外的附件和电缆（换能器）可能导致压力导丝发射的增加或抗扰度的降低。

压力导丝不应与其它设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。指南和制造商的声明：

指南和制造商的声明：

指南和制造商的声明 – 电磁发射		
压力导丝预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用：		
发射试验	符合性	电磁环境-指南
射频发射 GB 4824	1 组	压力导丝仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。
射频发射 GB 4824	A 类	压力导丝适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用。
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	

指南和制造商的声明 - 电磁抗扰度			
压力导丝预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用：			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电 GB/T 17626.2	±6kV 接触放电 ±8kV 空气放电	±6kV 接触放电 ±8kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少 30%
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线	不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
浪涌 GB/T 17626.5	±1kV 线对线 ±2kV 线对地	不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	<5% UT，持续 0.5 周期 （在 UT 上，>95%的暂降） 40% UT，持续 5 周期 （在 UT 上，60%的暂降） 70% UT，持续 25 周期 （在 UT 上，30%的暂降） <5% UT，持续 5s （在 UT 上，>95%的暂降）	不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果压力导丝的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐压力导丝采用不间断电源或电池供电
工频磁场（50 Hz/60 Hz） GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注：UT 指施加试验电压前的交流网电压。			

指南和制造商的声明--电磁抗扰度			
压力导丝预期在下列规定的电磁环镜中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环镜中使用:			
抗扰度试验	IEC 60601试验电平	符合电平	电磁环境--指南
射频传导 GB/T17626.6	3V (有效值) 150kHz~80MHz	3V(有效值)	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近压力导丝的任何部分使用，包括电缆。该距离由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 d=1.2 √P
射频辐射 GB/T17626.3	3V/m 80 MHz~2.5GHz	3V/m	d= 1.2 √P 80 MHz~800MHz d= 2.3 √P 800MHz~2.5GHz 式中: P--根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W)为单位; d--是推荐的隔离距离，单位为米(m)。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所勘测 [a] 来确定，在每个频率范围 [b] 都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。
注1: 在80 MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。 注2: 这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			
[a] 固定式发射机，诸如:无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环挠，应考虑电磁场所的勘测。如果测得压力导丝所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测压力导丝以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整压力导丝的方向或位置。 [b] 在150kHz~80MHz整个频率范围，场强应低于3V/m。			

便携式及移动式射频通信设备和压力导丝之间的推荐隔离距离

压力导丝预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和压力导丝之间最小距离来防止电磁干扰

发射机的最大额定输出功率 W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150kHz ～80MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80MHz～800MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800MHz ～ 2.5GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。

注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率点上，采用较高频范围的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

警告：本设备不能与高频手术设备同时使用。

如附页中的内容与说明书正文中的内容有不一致之处，请以此附页为准

一、 产品名称：

中文名称：一次性使用压力导丝
英文名称：Pressure Guide Wire

二、 注册人/生产企业名称：Volcano Corporation 火山公司

注册人住所 3721 Valley Centre Drive, Suite 500, San Diego, California, 92130, USA

生产地址： Coyol Free Zone & Business Park, B37, Alajuela, Costa Rica

注册人/生产企业联系方式：（800）228-4728，（916）638-8008

三、 代理人名称：飞利浦（中国）投资有限公司代理人住所：上海市静安区灵石路 718 号 A1 幢代理人联系方式： 800 810 0038
四、医疗器械注册证/产品技术要求编号：国械注进20233030202.
五、规格型号：89185, 89185J
六、生产日期 ，使用期限或失效日期：见外包装标签

七、产品包装灭菌有效期：3 年

八、 产品结构、性能、用途、适用范围、禁忌症、使用方法、注意事项、警告、存储条件、有效期限等信息详见所附的产品使用说明书。
九、【说明书编制日期】 2023年9月

Intentionally left blank.

Intentionally left blank.

Intentionally left blank.

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com/IGTdevices
Revision date: 12/2023
300011927241.B