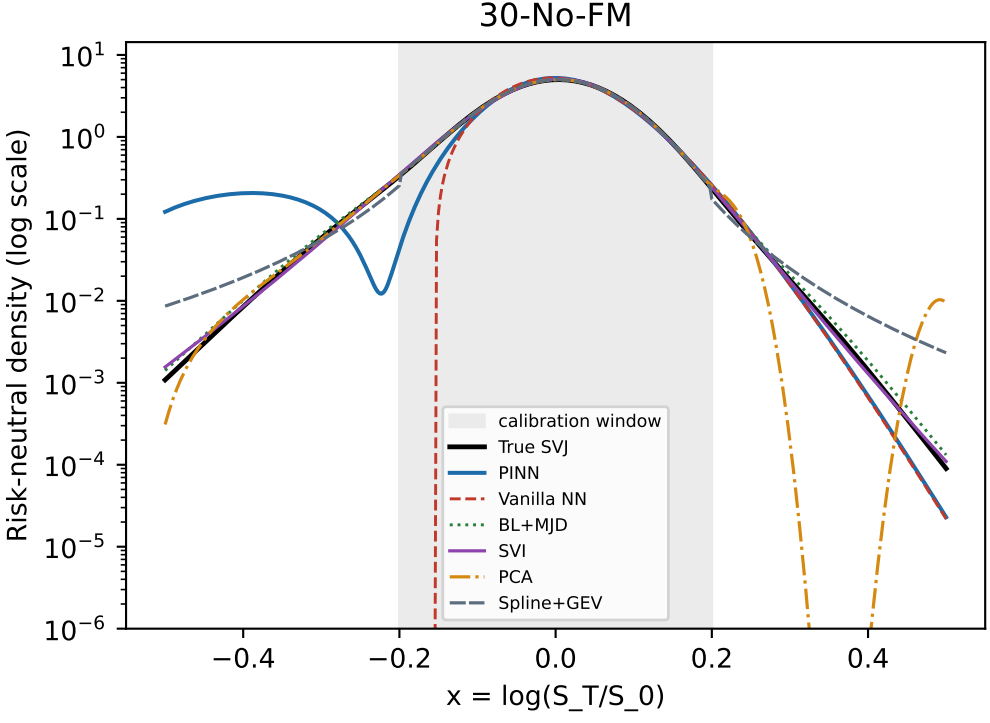
30-No-FM
Risk-neutral density (log scale)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
x = log(S_T/S_0)
calibration window
True SVJ
PINN
Vanilla NN
BL+MJD
SVI
PCA
Spline+GEV