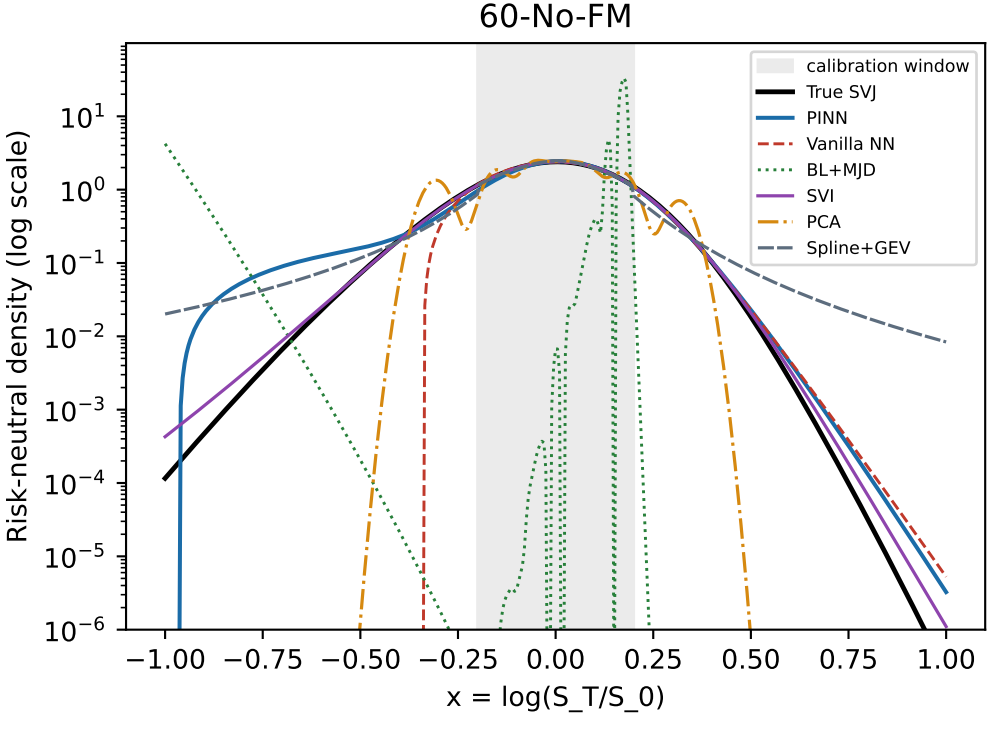
60-No-FM
calibration window
True SVJ
PINN
Vanilla NN
BL+MJD
SVI
PCA
Spline+GEV
Risk-neutral density (log scale)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x = log(S_T/S_0)