
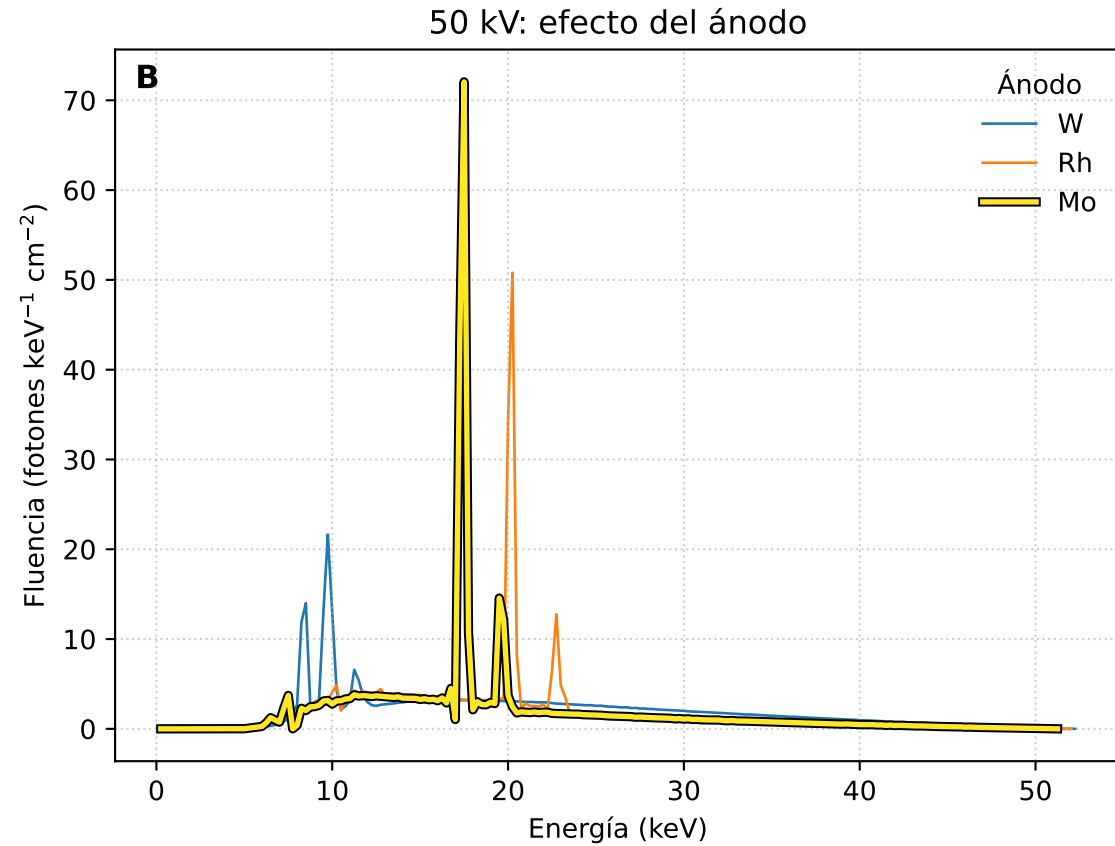


# Espectros de mamografía: efecto del kV y del material de ánodo

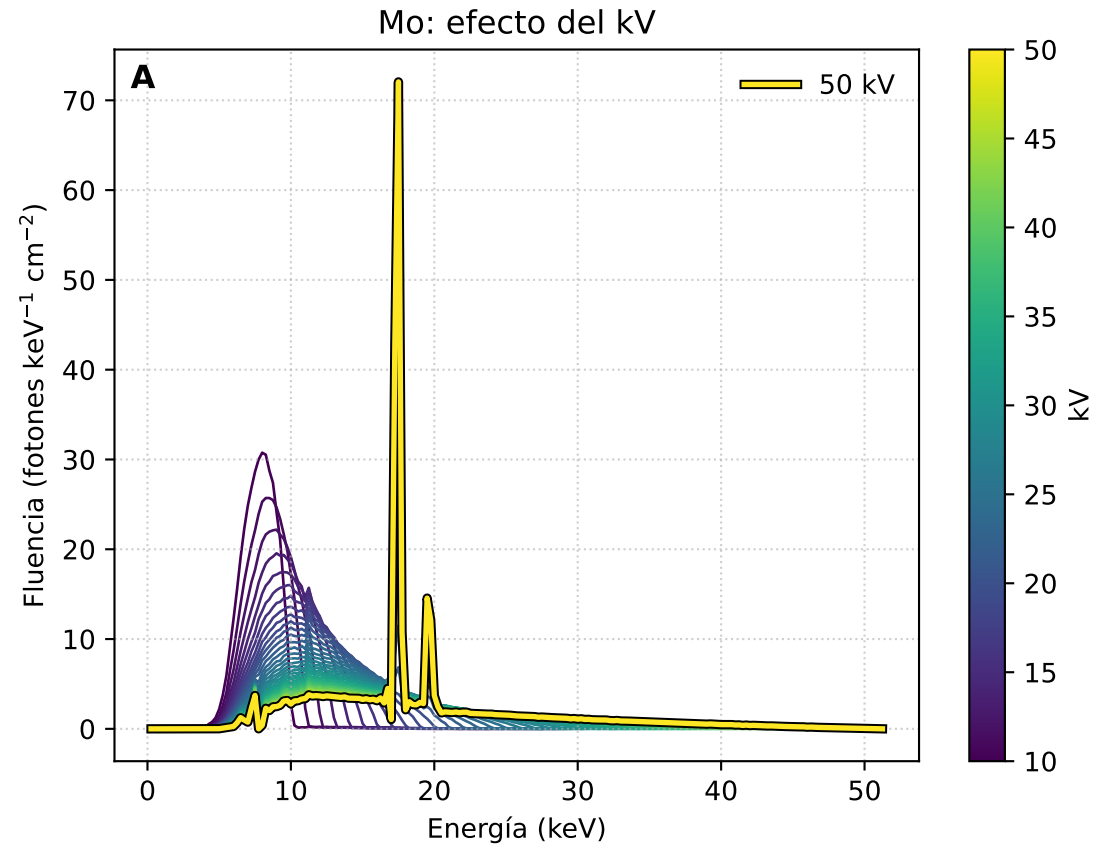

18.11.2020  
unfiltered x-ray spectrum  
measured at: PTB, Braunschweig  
anode: molybdenum  
tube voltage: 50 kV  
anode angle: 26  
inherent filtration: 1 mm Be  
measured in air at 100 cm distance from the focus  
bin width: 0.25 keV