

Formulario COMPLETO · Rayos X (Unidad 2.1 + exámenes)

ING340 · PPT + Time Outs + quizzes + EX1 / Final
+ tablero Miro · valores de gráficas =
aproximados

① Constantes y unidades

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$E_0 = m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = 6.242 \times 10^{18} \text{ eV}$$

h : Planck ; c : velocidad de la luz ; e : carga del electrón ; E_0 : energía en reposo del e^-

$$\text{kV} \times \text{mA} = \text{W}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

$\dot{N}_e$: electrones por segundo ; I en A (100 mA → $6.24 \times 10^{17} \text{ e}^-/\text{s}$)

- $\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$ · $\text{pm} = 10^{-12} \text{ m}$ · $25 \text{ ms} = 0.025 \text{ s}$ · $1 \text{ mm} = 0.1 \text{ cm}$

elemento	Z	elemento	Z
H	1	Ca (hueso)	20
O	8	Mo (mamo)	42
Al	13	W (tungsteno)	74
Cu	29	Pb	82

② Fotones

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

$$\lambda_{\min}(\text{nm}) = \frac{1.24}{\text{kVp}}$$

$$f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} = \frac{E_{\max}}{h}$$

λ : longitud de onda ; f : frecuencia ; E : energía del fotón ; λ en METROS si usas c

- rayos X : $0.01 \text{ a } 10 \text{ nm} \rightarrow 3 \times 10^{16} \text{ a } 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$
→ $124 \text{ eV a } 124 \text{ keV}$

$$N_{\text{fot}} = \frac{E_{\text{total}}}{E_{\text{fotón}}}$$

$$\dot{N}_{\text{fot}} = \frac{P_X}{E_{\text{fotón}}}$$

n° de fotones (o por segundo) ; E del fotón en J
($\text{keV} \times 1.602 \times 10^{-16}$)

③ Tubo de rayos X

- cátodo : filamento W ($Z = 74$, 2200°C) + copa de enfoque ; 100 a 1000 mA
- ánodo : Cu / Mo / W , blanco de W ; 15 a 180 kV ; 99 % → calor , 1 % → rayos X

Energía máxima

$$E_{\max} = eV$$

$$E_{\max}(\text{keV}) = V(\text{kV})$$

→ “los más energéticos” = $E_{\max} = kVp$

Potencia y calor

$$P = \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}}$$

$$H = w P t_s$$

$\beta = 0.71$ monofásico ; 0.96 trifásico

$w = 1 \rightarrow \text{joules}$; $w = 1.4 \rightarrow \text{HU}$

power rating = potencia máxima a 0.1 s

$$H = w \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}} t_s$$

- trifásico en HU : $w \cdot \beta = 1.4 \times 0.96 = 1.344$

112 kV , 500 mA , 2 s , $3\phi \rightarrow H = 150\,528 \text{ HU}$ (no 151 200)

$$t_{\max} = \frac{H_{\max}}{w P}$$

$$I_{\max} = \frac{H_{\max}}{w \beta V t}$$

tiempo o corriente máxima para no pasar la capacidad del ánodo

Eficiencia

$$\eta = k Z V$$

$$V = \frac{\eta}{k Z}$$

$k \approx 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$; V en VOLTIOS ; η típica $< 1\%$

$$P_X = \eta V I = k Z I V^2$$

$$E_X = \eta V I t$$

P_X : potencia en rayos X [W] ; E_X : energía en rayos X [J] ; I en A

→ el mA NO cambia η ; η sube con Z y con V

Exposición del haz


$$X \propto \text{mA} \cdot t \cdot \text{kVp}^2$$

$$\text{mAs} = \text{mA} \times t_s$$

$$I \propto \frac{1}{d^2} \quad \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

ley del inverso del cuadrado ; d : distancia al foco

Mancha focal y cobertura

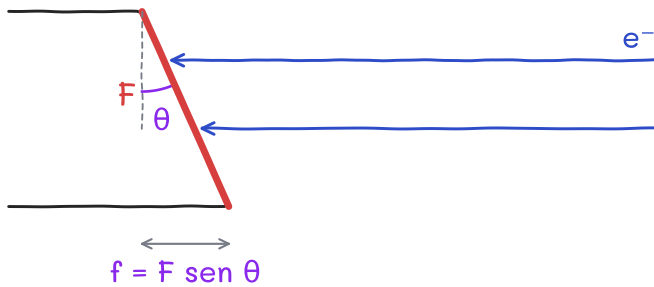

$$f = F \sen \theta$$

$$\text{cobertura} = 2 D \tan \theta$$

f : mancha efectiva ; F : ancho real ; θ : bisel 8 a 17° (12 a 15°) ; D : foco - detector

- f ≤ algo → θ ≤ ... (sen crece) ; cobre ≥ algo → θ ≥ ... (tan crece)

→ si $\theta_{\min} > \theta_{\max}$ no se puede : cambiar F , D o aceptar f mayor

4 Calor del ánodo

Con la curva de enfriamiento (Final 24-2)

- 1) H del disparo con $H = w \beta \text{ kV mA t}$
- 2) ubicar H en la curva → leer su tiempo t_0
- 3) tiempo para enfriar = $t(0 \text{ HU}) - t_0$ (NO es el total de la curva)
- 4) disparos cada Δt : después de cada disparo ir a $t_0 + \Delta t$ en la curva , leer H , sumar el siguiente disparo ; parar si pasa $H_{\max}$

Con modelo exponencial

$$H(t) = H_0 e^{-t/\tau}$$

$$r = e^{-\Delta t/\tau}$$

$$H_n = H_d \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

$$H_\infty = \frac{H_d}{1 - r}$$


$$\Delta t_{\min} = -\tau \ln \left(1 - \frac{H_d}{H_{\max}} \right)$$

H_d : calor por disparo ; H_n : calor justo después del disparo n ; τ : constante de enfriamiento

$$n_{\text{sin enfriar}} = \frac{H_{\max}}{H_d}$$

→ redondear hacia ABAJO

5 Espectro

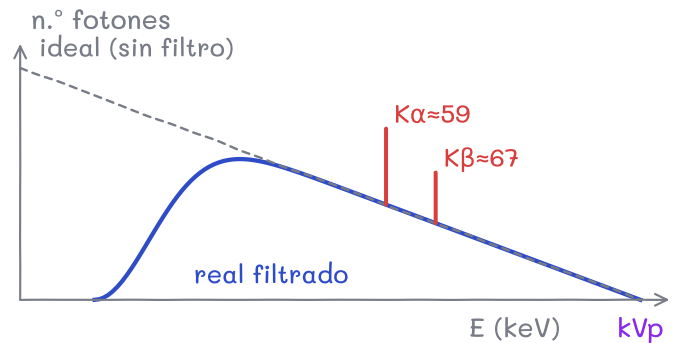

Bremsstrahlung (Kramers , recta)

$$I(E) = K Z I (E_{\max} - E)$$

$$I_{\text{total}} = K Z I \frac{E_{\max}^2}{2}$$

$$I_{\text{total}} \propto Z I V^2$$

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(\frac{E_{\max} - E_c}{E_{\max}} \right)^2$$

área del triángulo ; E_c : corte del filtro ; ×2 kVp → ×4 intensidad

$$N(E) = \frac{I(E)}{E}$$

$$\bar{E} = \frac{\int I(E) dE}{\int N(E) dE}$$

N : n.º de fotones por keV ; $\bar{E}$: energía media del haz

Característicos

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$

- solo si kVp > E_K ; dependen SOLO del material del ánodo

ánodo	E_K	Kα	Kβ
W (74)	69.5	≈ 59	≈ 67
Mo (42)	20.0	17.5	19.6
cambio	cantidad	E máx	forma
↑ mA o t	↑ lineal	igual	igual
↑ kVp	↑ ≈ kVp ²	↑	más ancho
↑ filtro	↓ bajas E	igual	E media ↑
↑ Z ánodo	↑	igual	otros picos

Energía efectiva (tabla EX1 25-2)

kVp	25	50	100	135	180
E_{ef} (keV)	18	30	42	60	82

$$E = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1} (E_2 - E_1)$$

interpolación lineal : 120 kVp → 52.3 keV ; regla rápida $E_{ef} \approx 1/3$ a $1/2$ del kVp

6 Interacciones

efecto	cuándo	resultado
fotoeléctr.	E baja , Z alto	se absorbe
Compton	E media / alta	se desvía
Rayleigh	$\approx 5\%$	sin ΔE
pares	$E > 1.022$ MeV	$e^- + e^+$

Fotoeléctrico

$$E = E_b + T_e$$

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 \left(\frac{E_2}{E_1}\right)^3$$


E_b : ligadura ; T_e : energía del fotoelectrón → da el CONTRASTE (Z^3)

$$T_e = E - E_K$$

$$E_2 = E_1 \frac{Z_2}{Z_1}$$

si $E > E_K$ interactúa con K ; misma probabilidad PE para otro Z

Compton

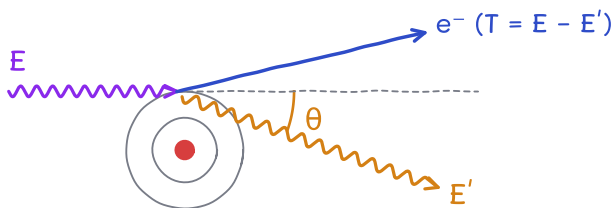

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

$E_0 = 511$ keV

$$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos \theta}{E_0}$$

$$T_e = E - E'$$

$$\frac{1}{E} = \frac{1}{E'} - \frac{1 - \cos \theta}{E_0}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} \right)$$

$$E'_{90^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}}$$

$$E'_{180^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$$

$180^\circ \rightarrow E'$ mínima y T máxima ; $\theta = 0 \rightarrow E' = E$; $\Delta \lambda = 2.43$ pm $(1 - \cos \theta)$


$$T_{\max} = \frac{E(2E/E_0)}{1 + 2E/E_0}$$

$$\Delta \lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \text{ pm} ; \lambda' = \lambda + \Delta \lambda$$

E (keV)	E'_{90°	E'_{180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1
150	116.0	94.5	55.5

7 Atenuación

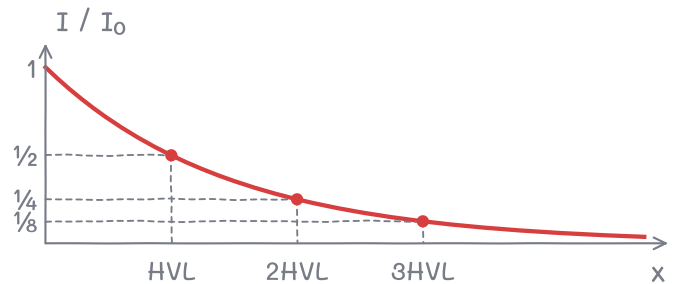

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I = I_0 \alpha^{-x}$$

$$\alpha = e^\mu, \mu = \ln \alpha \text{ (diap. 29)}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$\mu = \frac{\ln(I_1/I_2)}{x_2 - x_1}$$

con dos medidas a espesores distintos

- prueba de ley exponencial : el cociente entre capas iguales es constante ($= \alpha$)

$$abs = 1 - e^{-\mu x}$$

$$abs_n = e^{-\mu(n-1)}(1 - e^{-\mu})$$

fracción absorbida en x ; fracción de I_0 absorbida en el n-ésimo cm

$$I = I_0 \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 e^{-\mu x}$$

distancia + atenuación juntas

HVL, TVL

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

$$TVL = \frac{2.303}{\mu} = 3.32 HVL$$

$$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{x/HVL}$$

$$x_{99\%} = \frac{4.61}{\mu}$$

queda	x / HVL	queda	x / HVL
50 %	1	5 %	4.32
25 %	2	1 %	6.64
12.5 %	3	0.1 %	9.97
10 %	3.32	37 %	1.44

$$\lambda_{libre} = \frac{1}{\mu}$$

camino libre medio

$$x = n \cdot HVL$$

$$HVL_m = \frac{0.693}{\mu/\rho} [g/cm^2]$$

n HVL dejan $(1/2)^n$; HVL másica

Varias capas en serie

$$I = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \dots)}$$

→ se SUMAN los exponentes; las I se MULTIPLICAN, nunca se suman

$$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\sum x_i / HVL_i}$$

- si sale $\mu = 0$ en un tramo → ese tramo es aire (Miro: $I_0/4$ y $I_0/2$)

Contraste

$$C = \frac{I_{fondo} - I_{obj}}{I_{fondo}} = 1 - e^{-(\mu_{obj} - \mu_{fondo}) x_{obj}}$$

→ el contraste solo depende de la DIFERENCIA de μ y del espesor del objeto

$$SNR \propto \sqrt{N} \propto \sqrt{mAs}$$

$$CNR = C \cdot SNR$$

$\times 4 \text{ mA} \rightarrow \times 2 \text{ SNR}$; el mA NO cambia C (Final 25-1)

Másico y mezclas

$$\mu = \frac{\mu}{\rho} \cdot \rho$$

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{mez} = \sum w_i \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_i$$

$$\mu_{total} = \mu_{PE} + \mu_C + \mu_R + \mu_{pp}$$

$\rho \approx$ hueso 1.9 · músculo 1.05 · agua 1.0 · grasa 0.92 g/cm³; w: fracción en masa

⑧ Haz polienergético (EX1 26-1)

$$I = \int_0^{E_m} \Phi_0(E) e^{-\int \mu(x,E) dx} dE$$

$$\Phi_0 = \frac{I_0}{2} [\delta(E - E_1) + \delta(E - E_2)]$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} (e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x})$$

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

$$x \rightarrow 0: \mu_{ef} \rightarrow \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

$$x \rightarrow \infty: \mu_{ef} \rightarrow \mu_{min}$$

- endurecimiento: μ_{ef} BAJA con x; 2.º HVL > 1.º HVL; si $\mu_1 \approx \mu_2$ casi no cambia

en el examen usan $\alpha(x, E)$ para el coeficiente: es lo mismo que μ

$$\frac{I}{I_0} = \sum w_i e^{-\mu_i x}$$

$$\mu_{ef}(0) = \sum w_i \mu_i$$

w: fracción de intensidad de cada energía ($\sum w = 1$)

$$T(HVL_1) = \frac{1}{2}$$

$$T(HVL_1 + HVL_2) = \frac{1}{4}$$

$$HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$

1.º y 2.º HVL; HC: coeficiente de homogeneidad (1 = monoenergético, < 1 polienergético)

⑨ kVp ↔ mA (EX1 25-2)

$$I_{\text{det}} \propto mA \cdot kVp^2 \cdot e^{-\sum \mu_i x_i}$$

mA lineal (diap. 18) ; kVp ≈ cuadrático (diap. 19)

$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2} \right)^2 \frac{T_1}{T_2}$$

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-\sum \mu_i x_i}$$

T : transmisión a la energía efectiva de cada kVp ; $T_2 > T_1$ si subes kVp → mA baja

→ si el enunciado dice que I_0 solo depende de la corriente : quitar $(kVp_1/kVp_2)^2$;
ESCRIBIR el supuesto

50 → 120 kV , 20 cm blando + 5 cm hueso : sin kVp² → ≈ 2 μA ; con kVp² → ≈ 0.35 μA

⑩ Sistema 2×2

$$L_k = \ln \left(\frac{I_0}{I} \right)_k = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

$$a_1 x + b_1 y = c_1$$

$$a_2 x + b_2 y = c_2$$

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

$$y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$


→ energías LEJOS (baja = fotoeléctrico , alta = Compton) ; si el determinante ≈ 0 el resultado no sirve

• comprobar con un 3.er dato : predecir I/I_0 y comparar

$$D = \mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}$$

determinante ; $D \approx 0$ → mala elección de energías

⑪ μ de tejidos (diap. 31)

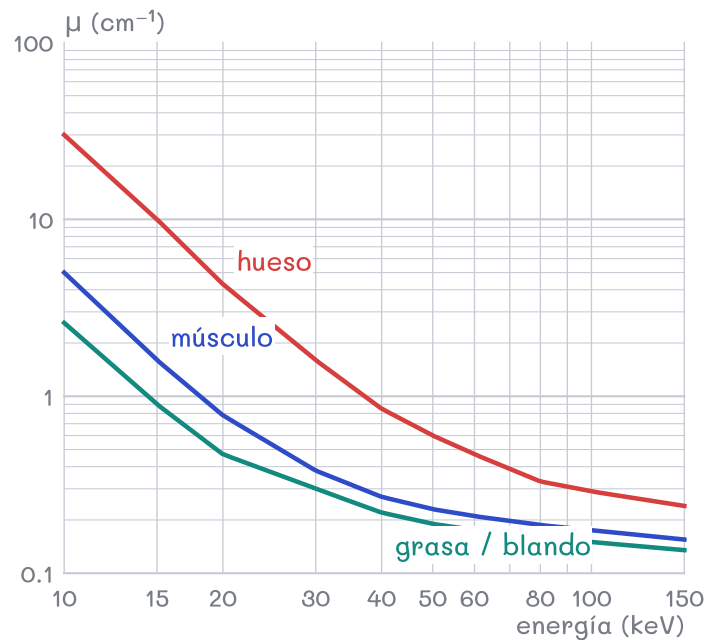

E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
35	1.14	0.316	0.254	2.19 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
52	0.569	0.226	0.187	3.07 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
70	0.389	0.197	0.167	3.51 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
90	0.308	0.181	0.155	3.84 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

μ en cm⁻¹ ; aproximados ; 35 , 52 , 70 y 90 keV interpolados en log-log

$$\log \mu = \log \mu_1 + \frac{\log E - \log E_1}{\log E_2 - \log E_1} (\log \mu_2 - \log \mu_1)$$

→ baja E : hueso ≫ músculo (fotoeléctrico) ;
alta E : casi iguales (Compton)

⑫ Rejilla antidispersión (Miro)

$$GR = \frac{H}{D - t}$$

$$GF = \frac{1}{D}$$

H : altura de láminas ; t : espesor ; D : paso ; D - t : canal libre

$$\tan \theta_{\max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

1) $\theta_{\max}$ con Compton (fórmula inversa de arriba)

2) $GR = 1 / \tan \theta_{\max}$; luego $D - t = H / GR$, D , GF

150 → 149 keV : $\theta = 12.28^\circ$, $GR = 4.60$; típico GR 5:1 (mamo), 8:1 (70–90 kV), 12:1 (> 90 kV)

13 Magnificación (no PPT)

$$M = \frac{SID}{SOD} = \frac{SID}{SID - OID}$$

$$\text{borroso} = f \frac{OID}{SOD}$$

SID : fuente – detector ; SOD : fuente – objeto ;
OID : objeto – detector ; f : mancha focal

corazón a 15 cm, $M \leq 1.1 \rightarrow SID \geq 165$ cm

$$OD = \log_{10} \frac{I_{in}}{I_{out}}$$

$$\gamma = \frac{\Delta OD}{\Delta \log X}$$

densidad óptica de la placa (útil 0.5 a 2) ; γ :
pendiente de la curva H-D

14 ¿Qué dato → qué fórmula?

me dan

uso

kVp

$E_{\max} = kVp$ (keV)

λ o f

$E = hc/\lambda = hf$

kV, mA, t, fase

$P = \beta VI$; $H = wPt$

η , Z

$V = \eta/(kZ)$

F, θ / D, θ

$f = F \sin \theta / 2D \tan \theta$

E, θ o E'

Compton

μ , x

$I = I_0 \exp(-\mu x)$

I/I_0 de 2 haces

sistema 2x2

haz de 2 energías

μ efectivo

tabla kVp → E

kVp ↔ mA

curva del ánodo

receta 4)

H, t, GR

rejilla

15 Recetas

Calor

1) β (1 ϕ 0.71 / 3 ϕ 0.96), w (J 1 / HU 1.4)

2) $H = w \beta kV mA t$ (t en s)

120 kVp, 10 mA, 25 ms, 1 ϕ → 21.3 J

kVp → HVL o % que queda

1) $E = kVp$ (los más energéticos)

2) μ en la gráfica

3) $HVL = \frac{0.693}{\mu}$; $x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$

35 kVp músculo → $\mu \approx 0.32 \rightarrow HVL$ 2.2 cm ; 99% → 14.4 cm

Eficiencia → HVL

1) $V = \frac{\eta}{kZ}$ (voltios)

2) $E_{\max} = V$ en keV

3) $\mu \rightarrow HVL$

0.81 % , W → 87.6 kV → $HVL \approx 38$ mm

Al revés (dan medidas)

1) $-\ln(I/I_0) = \Sigma \mu x$ de cada haz

2) resolver el sistema

3) $\mu \rightarrow$ energía en la gráfica → kVp mínimo

4) $\alpha = e^{\mu}$ si piden la forma de la diap. 29

Espectros

- mismo final → mismo kVp ; mismos picos → mismo ánodo
- todo escalado → otro mA ; falta baja E → filtro
- sin picos → kVp < E_K (W : 69.5 keV)

16 Exámenes resueltos

Final 24-2 Q5 : calor + curva

$H = 1.4 \times 0.96 \times 112 \times 500 \times 2 = 150\,528$ HU
en la curva 150 kHU ≈ 2.1 min → enfriar ≈ 13 min

cada 30 s : 2.° disparo ≈ 288 kHU ✓ , 3.° > 350 kHU X → 2 exposiciones

Final 24-2 Q6 : doble energía

30 keV : $10^{-5} \rightarrow L = 11.51$; 60 keV : $1.4 \times 10^{-2} \rightarrow L = 4.27$

μ del PPT (1.6, 0.38 / 0.47, 0.21) → hueso ≈ 5.1 cm, músculo ≈ 9.0 cm

con μ leídos en el Miro (1.5, 0.4 / 0.5, 0.2) → 5.9 y 6.5 cm

EX1 26-1 Q5 : 2 energías en hueso

(30 , 80 keV) : μ efectivo 0.776 (1 cm) $\rightarrow$ 0.468 (5 cm)
(60 , 80 keV) : μ efectivo 0.398 (1 cm) $\rightarrow$ 0.388 (5 cm)

$\rightarrow$ energías lejanas : endurecimiento fuerte ;
cercanas : casi nada

EX1 25-2 P5 : kVp $\rightarrow$ mA

50 kV $\rightarrow$ 30 keV ; 120 kV $\rightarrow$ 52 keV ; 20 cm
blando + 5 cm hueso
sin kVp² : $I_2 \approx 0.5 \cdot \exp(7 - 12.5) \approx 2 \mu\text{A}$; con
kVp² : $\approx 0.35 \mu\text{A}$

Final 25-1 Q1b : HVL de 2 medios

arriba 2 cm de medio 1 $\rightarrow I_0/4 \rightarrow \text{HVL}_1 = 1 \text{ cm}$
abajo 1 cm medio 1 + 1 cm medio 2 $\rightarrow I_0/2 \rightarrow$
 $\mu_2 = 0$ (aire)

Miro : rejilla

150 $\rightarrow$ 149 keV : $1 - \cos \theta = (511/150)(1/149) \rightarrow$
 $\theta = 12.28^\circ$
 $\text{GR} = 1/\tan \theta = 4.60$; $H = 6 \text{ cm} \rightarrow D - t = 1.31$
cm (no 1.51)

Time Out 3 (diap. 35 , 10 y 1 cm⁻¹) : $I_1 = I_0 e^{-13}$;
 $I_2 = I_0 e^{-31}$; $I_3 = I_0 e^{-4}$

17 Teoría para los incisos

Tubo y calor

- ¿El mA cambia η ? NO : más mA = más rayos X , pero también más potencia eléctrica en la misma proporción ($\eta = kZV$).
- ¿Por qué η sube con V y Z? e⁻ más rápidos y núcleos con más carga $\rightarrow$ más frenado (bremsstrahlung) por electrón.
- ¿3 ϕ da más calor que 1 ϕ (iguales kV , mA , t)? SÍ : $\beta = 0.96 > 0.71$ (voltaje casi constante , menos rizado).
- ¿f chica y cobertura grande a la vez? choque : $f = F \sin \theta$ pide θ chico ; $2D \tan \theta$ pide θ grande $\rightarrow$ alejar el detector , bajar F o aceptar f mayor.
- $\uparrow \theta \rightarrow \uparrow f$ (mancha más grande , imagen menos nítida) ; típico 8 a 17° (12 a 15°).
- Enfriar desde H : la curva vale para cualquier inicio ; se arranca donde la curva vale H (no desde 350 kHz).

- El ánodo se enfría más rápido cuando está más caliente (curva exponencial).
- W : Z alto + fusión alta ; copa de enfoque dirige los e⁻ ; vacío : sin choques con aire ; ánodo giratorio + aceite reparten y sacan el calor.

Espectro

- ¿Duplicar el mA duplica E máx? NO : E máx = kVp ; el mA solo cambia la cantidad de fotones.
- ¿Por qué no hay picos? kVp < energía de la capa K (W : 69.5 keV) : el e⁻ no puede arrancar un e⁻ de la capa K.
- ¿Por qué los picos no se mueven con mA , filtro o kVp? son diferencias de energía entre capas del ÁNODO (K-L , K-M).
- Filtro : quita baja E $\rightarrow$ haz más duro , E media $\uparrow$, HVL $\uparrow$, menos dosis en piel , contraste un poco $\downarrow$.
- ¿Mayor E media? el de más kVp o más filtrado. ¿Mayor contraste? el de MENOR E media (más fotoeléctrico).
- ¿Por qué $\times 4$ al duplicar kVp? en el triángulo de Kramers se duplican base y altura.
- ¿Por qué el filtro "se come" menos a más kVp? el corte es fijo y el triángulo más grande : pierde una fracción menor.
- Mo (mamografía) : picos 17.5 y 19.6 keV , haz blando $\rightarrow$ mucho contraste en tejido blando.

Interacciones

- ¿Qué da el contraste hueso / tejido? el FOTOELÉCTRICO ($\propto Z^3/E^3$; Ca = 20). Compton NO.
- ¿Por qué baja el contraste a alto kV? domina Compton , que depende de la densidad de e⁻ y casi no de Z : μ hueso / μ músculo ≈ 4.2 a 30 keV $\rightarrow 1.7$ a 100 keV.
- Fotoeléctrico : el hueco en K se llena desde L (K α) o M (K β) $\rightarrow$ radiación característica ; si E < 69.5 keV (W) , interactúa con la capa L.
- Compton : 180° = máxima pérdida ; 0° = ninguna ; E muy alta $\rightarrow E'(180^\circ) \rightarrow 255.5 \text{ keV}$ y $E'(90^\circ) \rightarrow 511 \text{ keV}$.
- Dispersión (Compton) : ruido , menos contraste , dosis al personal $\rightarrow$ rejilla. GR alto = más selectiva , pero hay que subir mAs.
- ¿El GR sube o baja si pido más E'? SUBE : ángulo permitido más chico $\rightarrow$ canal más angosto / láminas más altas.
- Pares : solo E > 1.022 MeV $\rightarrow$ no en rayos X de diagnóstico. Rayleigh : $\approx 5 \%$, sin pérdida de E.
- Hueso blanco en la placa : atenúa más $\rightarrow$ llega menos al detector $\rightarrow$ menos expuesto.

Atenuación

- ¿Por qué exponencial? sin memoria : la probabilidad por dx es constante $\rightarrow dI = -\mu I dx \rightarrow I = I_0 \exp(-\mu x)$.
- Misma FRACCIÓN por cada cm ; en el 2.º cm se pierde menos intensidad absoluta porque llega menos.
- ¿Doble espesor = mitad? NO : la transmisión se eleva al cuadrado (50 % $\rightarrow$ 25 %).
- $1/\mu$ = camino libre medio ; $TVL = (\ln 10 / \ln 2) HVL = 3.32 HVL$.
- Endurecimiento : los fotones blandos se absorben primero $\rightarrow \mu$ efectivo BAJA con $x \rightarrow 2.^\circ HVL > 1.^\circ HVL$.
- Límites : $x \rightarrow 0$, μ efectivo = promedio de los μ ; $x \rightarrow \infty$, μ efectivo = μ mínimo (solo quedan los más penetrantes).
- Energías con μ parecidos $\rightarrow$ casi no hay endurecimiento.
- El orden de las capas no importa (se suman los μx). $\mu = 0$ en un tramo $\rightarrow$ aire.
- Agua $\approx$ músculo : el músculo es $\approx$ 75 % agua , Z efectivo y densidad parecidos.

Compromisos (lo que más preguntan)

- Energía óptima : baja E = mucho contraste pero casi no llega nada (más dosis , ruido) ; alta E = llega más pero poco contraste $\rightarrow$ la E más baja que deja pasar lo suficiente.
- Subir kVp y bajar mA (misma I en detector) : se GANA menos dosis al paciente ; se PIERDE contraste.
- Doble energía : energías LEJOS $\rightarrow$ determinante grande. Cercanas o ambas altas (100 y 150 keV , ambas Compton) $\rightarrow$ ecuaciones casi iguales , cualquier error se amplifica.
- ¿Es consistente? usar el resultado para predecir I/I_0 a la 3.ª energía y comparar.
- El contraste depende de la DIFERENCIA de μ y del espesor del objeto , no del tejido que lo rodea.
- Final 25-1 Q1 (placas) : $\uparrow$ kV $\rightarrow$ imagen más GRIS , MENOS contraste ; la placa con más contraste es la de MENOS kV.
- $\uparrow$ mA $\rightarrow$ MISMO contraste pero MENOS ruido (más fotones , mejor SNR) ; la placa granulada es la de menos mA.

18 Errores comunes

- $\rightarrow$ t en SEGUNDOS ; V en VOLTIOS en $\eta = kZV$; $\eta = 0.81 \% = 0.0081$
- $\rightarrow$ “más energéticos” $\rightarrow \mu$ a $E = kVp$
- $\rightarrow$ 99 % NO son 2 HVL : son 6.64 HVL
- $\rightarrow$ capas : sumar μx , NUNCA sumar las I
- $\rightarrow$ ln , no $\log_{10}$; μ en cm^{-1} con x en cm
- $\rightarrow$ enfriar desde H : NO es el tiempo total de la curva
- $\rightarrow$ exposiciones posibles : redondear hacia abajo ; sen para $f \leq$, tan para cobertura $\geq$
- $\rightarrow$ kVp $\rightarrow$ mA : decir si incluyes kVp²