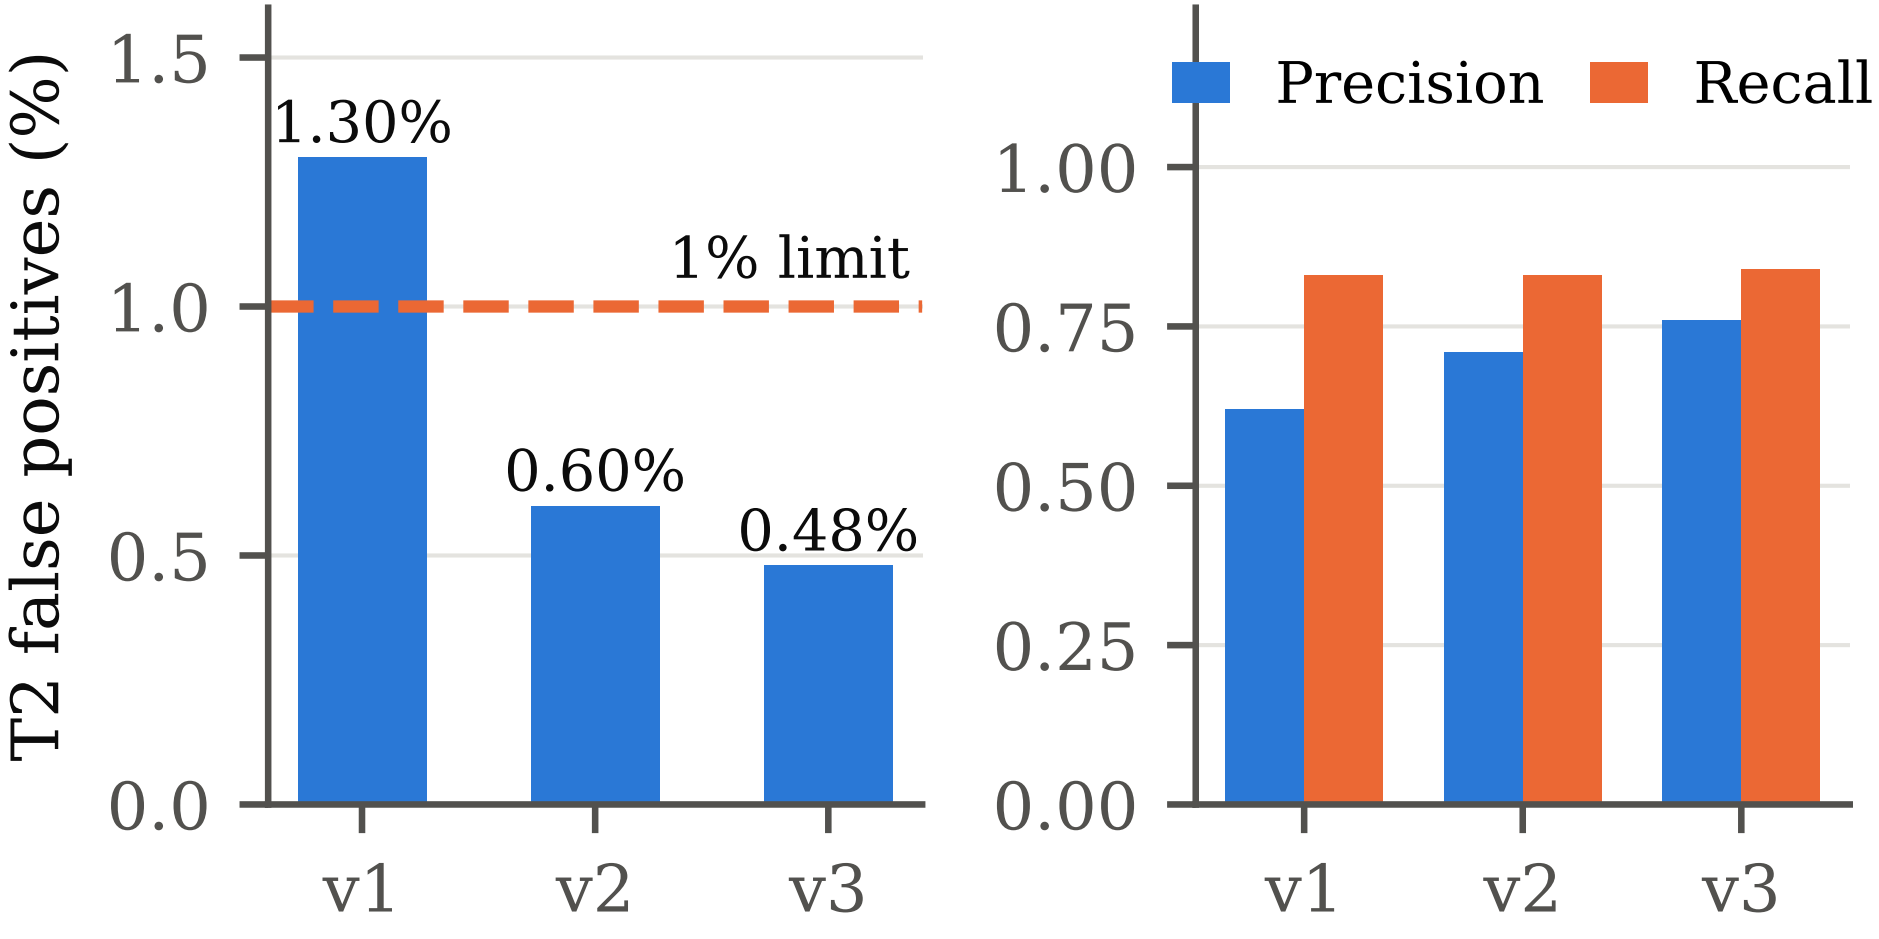
T2 false positives (%)
1.5
1.0
0.5
0.0
1.30%
1% limit
0.60%
0.48%
v1
v2
v3
Precision
Recall
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
v1
v2
v3