

Value Added Technology!

I. 중국시장은 기본, 중동·브라질 시장은 덤

- 중국시장: 주요 거점도시 유통망 확보로 전년 대비 100% 이상 매출 성장.
- 중동시장: 정부 간 협약으로 인한 사업권 우선권 확보로 2017년 167억 원 매출 예상.
- 브라질 시장: 현지 공장 설립, 점유율 회복을 위한 교두보 마련
 - > 동사 '17년 매출액 18800억 원 달성 전망
- 3D X-RAY 매출 비중 증가로 인한 OPM 개선 : '14년 11.9% -> 15년 12.4%

II. 자회사 레이언스의 독특한 효자노릇

- X-RAY 장비의 디지털화로, 교체수요 및 Retrofit Detector 수요 창출.
 - > Retrofit 시장 '17년까지 연평균 14.87% 성장
 - > '17년 매출액 583억 달성 예상
- 좌 바텍 우 GE, 양 날개로 날아오르리.
 - > '17년 바텍향 매출 540억원, GE향 매출 132억원까지 성장
 - > 내외부 매출 연평균 21.43% 성장

ISSUE & RISK

- CAPA 증설 이슈
- 자회사 레이언스 상장 이슈



Rating

BUY

목표주가: 20300 원
현재주가: 14800 원
상승여력: 37%

Trading data

시가총액	2,146 억원
52wk 주가범위	19,550 ~8,730 원
발행주식수	14854256
유통비율	43.17%

Balance sheet data

순자산	1047
PBR	2.0 배
ROE	7.2 %
ROA	6.95 %

Earning data

PER(2013 기준)	29.2 배
EPS	382 원
당기순이익	141 억원
영업이익	153 억원
영업이익률	8.93 %
EV/EBITDA	16.4 배

주요 주주

바텍이우홀딩스:	48.85%
노창준:	6.31%
기타:	44.84%
자사주:	1.35%

SMIC 3 팀

팀장	정수연
팀원	김은지
	김종민
	정진홍


1. 산업분석

1.1. 세계 치과의료 시장

소득수준과 밀접한
세계의료시장

세계 의료 시장은 소득수준과 밀접한 관련이 있다. 그림1에서 볼 수 있듯, 1인당 GDP가 높을수록 의료비 지출액도 크다.

그림 1. 국가별 1인당 GDP와 의료비 지출액 (단위: \$ PPP)

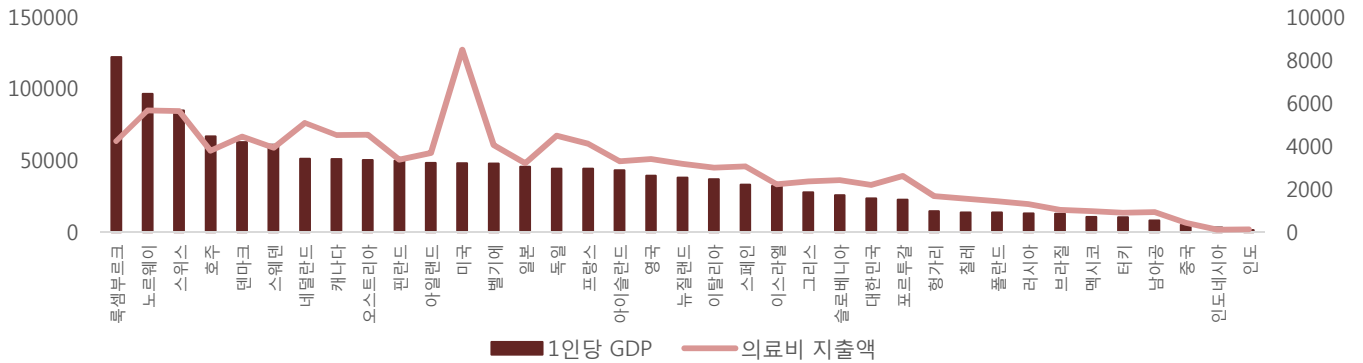

출처: OECD Health Statistics 2013, SMIC RESEARCH TEAM 3


국민소득 증가하는
개도국 중심으로 치
과의료시장 확대

치과의료 시장 역시 소득수준과 밀접한 연관이 있다. 아래 그림 2를 보면, 1인당GDP 상위 10위 국가의 경우 인구 만명 당 치과의사 수가 평균 6.55명인 반면, 하위 10위 국가들은 인구 만명 당 치과의사 수가 평균 2.21명에 그치는 것을 알 수 있다. 최근에는 국민소득이 증가하는 개발도상국을 중심으로 시장이 점차 확대되고 있다.

세계 의료기기 연평
균 8%씩 성장, 앞으
로도 6% 성장 예상


또한 의료기기산업 예측기관인 에스피콤(Espicom)에 따르면, 세계 의료 시장이 커감에 따라 세계 의료기기 시장 역시 2009년부터 2012년까지 연평균 8%씩 성장해 왔으며, 앞으로도 연평균 6%의 성장을 지속할 것으로 예상된다.

그림 2. 1인당GDP와 인구 만명 당 치과의사 수
(2012년 기준, 단위: 좌-천\$, 우-명)

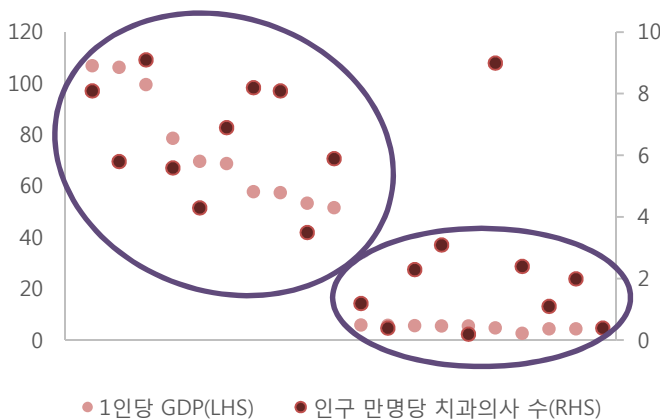

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 3. 세계 의료기기 시장 (단위: 십억\$)

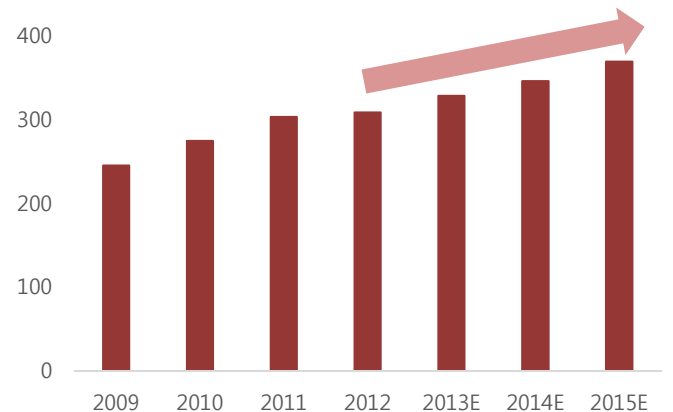

출처: Espicom(2013), SMIC RESEARCH TEAM 3

1.2. 치과용 영상진단기기 시장


임플란트시장 성장에 따라 치과용방사선촬영장치시장도 연평균 8%씩 성장 예상

치과용 영상진단기기란 치과에서 방사선을 이용해 치아, 뼈, 연조직 등의 영상을 획득하는 장치를 말한다. 일반적으로 치과용 영상진단기기 산업은 임플란트와 치아교정과 같은 고급 치아시술의 수요에 영향을 받는다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 국제 임플란트 시장은 2012년부터 2015년까지 연평균 9% 성장할 것으로 추정되며, 이에 힘입어 치과용방사선촬영장치 시장도 연평균 8%씩 성장할 것으로 전망된다.

치과용방사선촬영장치의 대륙별 시장규모


한편, 대륙별 치과용방사선촬영장치의 시장규모는 2010년 기준, 북미(37%), 아시아-태평양(34%), 유럽(22%), 중남미(5%), 중동 및 아프리카(2%)로 나타났다. 그러나 2005-2012년 시장성장률은 유럽(5.9%), 중동 및 아프리카(5%), 중남미(4.7%), 아시아-태평양(4.4%), 북미(4.1%) 순으로 나타났으며, 2012-2019년 시장성장률 전망 역시 아시아-태평양과 중동 및 아프리카가 6%, 유럽이 5.6%로 높게 나타난 반면 북미는 4.1%로 낮게 나타났다.

그림 4. 임플란트 시장과 치과용방사선촬영장치 시장
(단위: 십억\$)

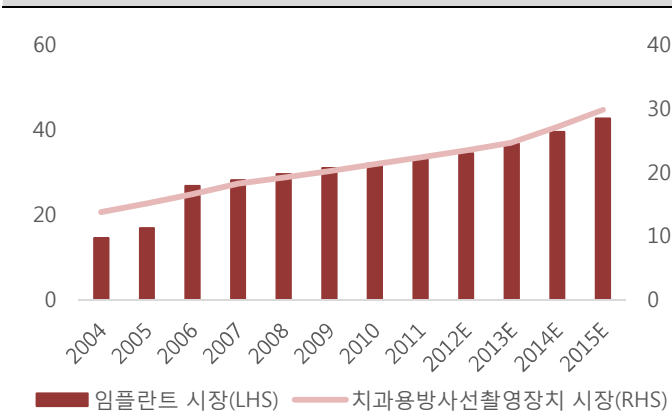

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 5. 대륙별 치과용방사선촬영장치 시장규모
(2010년 기준)

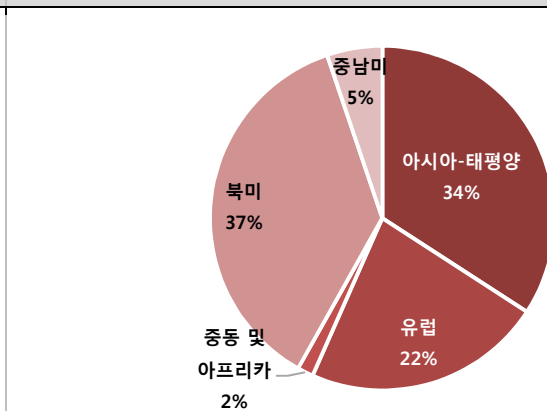

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

1.3. 디텍터 시장

디지털 X-ray 방식의 성장과 핵심부품인 디텍터의 수요 증가


X-ray 시스템은 사람 눈에 볼 수 있게 변화시키는 방식에 따라 아날로그와 디지털 방식으로 나뉜다. 아날로그 방식은 필름이나 마그네틱 테이프를 이용해 사진을 현상하듯이 이루어지는 반면, 디지털 방식은 X선을 전기신호로 바꾸며 데이터화하는 기술을 접목해 모니터로 확인 가능하다. 디지털 방식에서 X선을 전기신호로 바꾸어 영상정보로 바뀌주는 핵심 역할을 하는 부품이 바로 디텍터(X-ray Detector)이다. 디텍터는 X-ray 시스템에 장착돼 의료, 보안산업에 사용된다. 디텍터 시장은 최근 영상진단기기가 아날로그에서 디지털화됨에 따라 필수적인 핵심부품으로 거듭나면서 그 수요가 늘어나고 있다.

디지털 X-ray 시스템 중 DR이 CR을 대체하는 추세

또한 X-ray 디지털 시스템은 다시 CR(Computed Radiography)과 DR(Digital Radiography)로 구분되는데, CR은 형광물질이 도포된 이미징 플레이트로 이미지를 얻어 디지털로 변환시키는 구 방식이고 DR은 반도체 센서를 이용해 디지털로 변환시키는 신

방식이다. 최근에는 DR이 CR을 대체하는 추세다.

그림 6. X-ray 시스템 구분

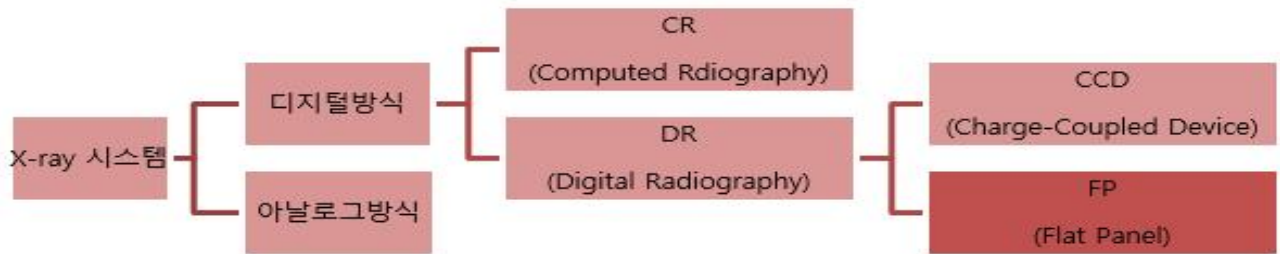

출처: 한국투자증권, SMIC RESEARCH TEAM 3

2. 기업분석

2.1 바텍

연결기준, 덴탈이미징사업과 디텍터사업영위

바텍은 1992년 4월 4일에 설립되어 2006년 9월 29일자로 코스닥 시장에서 매매가 개시되었다. 본래 계측장비 등의 제조·판매를 목적으로 설립되었으나 2002년 치과용 X-ray 시장으로 진입하며 산업용 X-ray기업에서 치과용방사선촬영장치 전문기업으로 변모하였다. 2011년 04월 디텍터 사업부문이 물적분할되어 (주)레이언스가 설립된 이래로, 동사는 연결 기준에서 보면 (주)바텍을 중심으로 하는 덴탈 이미징 사업과 연결자회사인 (주)레이언스를 중심으로 하는 디텍터 사업의 두 개의 사업부문을 영위하고 있다.

총 20개의 계열회사와 70여 개의 대리점 네트워크 보유

동사의 주요 계열회사로는 해외시장 의료기기판매 및 A/S를 담당하는 (주)바텍글로벌, 국내시장을 담당하는 (주)바텍코리아, 계열회사의 경영컨설팅을 주업으로 하는 (주)바텍이우홀딩스 등이 있으며, 이를 포함하여 국내법인 6개, 해외법인 13개의 총 20개의 계열회사를 가지고 있고 70여 개의 대리점 네트워크를 확보하고 있다.

그림 7. 동사의 연혁

연도	내용
1992.04	(주)바텍시스템 법인설립
2002.03	(주)바텍으로 상호변경
2006.09	코스닥 상장 및 거래 개시
2007.11	삼성전자와 디지털 X-ray Detector 공동개발 성공
2009.09	국내 마케팅본부 물적분할. (주)바텍코리아 설립
2011.03	글로벌 사업부문 물적분할. (주)바텍글로벌 설립
2011.04	레이언스 사업부문 물적분할. (주)레이언스 설립
2012.09	(주)레이언스의 (주)휴먼레이 흡수합병
2013.06	GE 헬스케어에 맘모그래피 자산 부분매각

출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 8. 동사의 해외 법인



출처: 동사 자료


2.2. 제품 소개

간단한 기술에는 2D, 복잡한 기술에는 3D 동사는 연결 기준에서 보면 덴탈 이미징 사업과 디텍터 사업의 두 개의 사업부문을 영위하고 있다. 먼저, 덴탈 이미징 부문은 다시 2D제품과 3D제품으로 나뉜다. **2D 이미징은 주로 충치 치료와 같은 비교적 간단한 치료에 사용되는 반면, 3D 이미징은 임플란트, 신경치료, 치아교정과 같은 복잡한 기술에 사용된다.** 이는 2차원의 영상 구현에서는 확인할 수 없는 구조를 3D에서는 확인할 수 있기 때문이다.

PaX-i 라인으로 주력 제품 3개로 단순화 이 부문에는 본래 약 13개의 제품이 있었으나 2012년에 **고부가가치 제품 라인인 PaX-i 라인을 새로 출시하며 주력 제품을 3개로 단순화**했다. 그 결과, 2D 이미징 부문에서는 주력제품으로 **PaX-i가**, 3D 이미징 부문에서는 주력제품으로 **PaX-i3D와 PaX-i3D GREEN**이 자리잡게 되었다.


PaX-i로 바뀌며 원가 40% 절감, ASP 10% 하락, 매출원가를 하락 이는 플랫폼을 통합하여 수율을 개선하고, 부품의 공유를 통해 원가가 절감되는 효과를 노린 것이다. 실제로 동사는 기존 제품인 Pax-Primo에서 Pax-i로 바뀌면서 **원가의 40% 절감에 힘입어 제품의 평균판매가격(ASP)이 10% 하락하며 가격경쟁력을 확보**하게 되었다. 이에 따라 동사의 매출원가율은 Pax-i Series의 판매가 본격화된 **2013년에 전년 대비 11%의 큰 폭으로 감소**했다. 이로써 동사는 2013년 업계 1위인 Sirona와 2위인 Danaher의 매출원가율을 빠른 속도로 따라잡고 있다.

그림 9. 동사의 매출원가율 추이

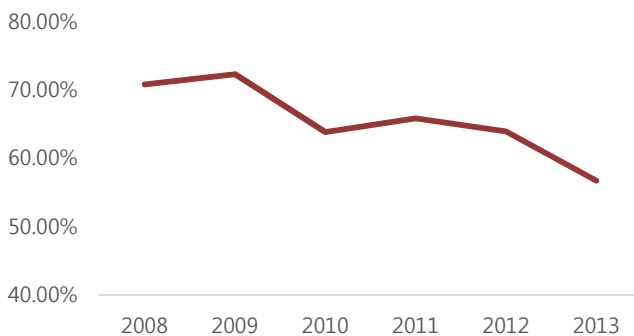

출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 10. 경쟁사와의 매출원가율 비교

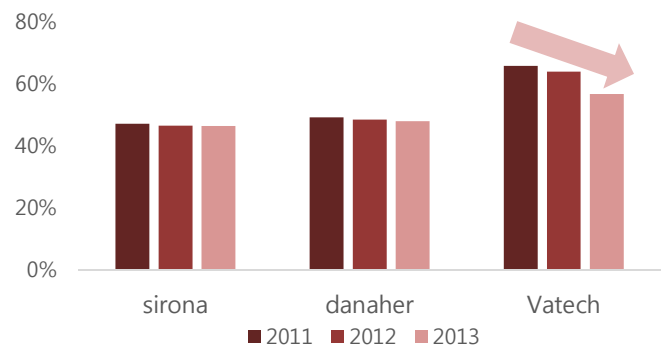

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

디텍터 부문은 TFT 디텍터와 CMOS 디텍터가 대부분 차지 한편, 동사의 **디텍터 부문은 TFT Detector와 CMOS Detector가 대부분을 차지**한다. TFT Detector는 기존의 CCD에 비해 화질이 우수하고 환자의 방사선 피폭량이 적어 선진국에서는 FTF 방식이 CCD 방식을 대체하고 있으며, CMOS Detector는 잔상 없는 고속영상이 획득 가능하고 생산성 및 경제성이 높으며 고집적, 고해상도 센서 설계가 가능해 치과용과 유방암진단용으로 주로 사용된다.

2.3. 매출 구성


덴탈이미징 77%, 디
텍터 23%

연결기준에서 볼 때, 동사의 각 사업부별 비중은 2013년 현재 매출액 기준, 덴탈이미징이 77%, 디텍터가 23%를 차지한다. 덴탈이미징은 주력제품인 Pax-i, Pax-i3D, Pax-i3D GREEN이 2012년 기준 83%를 차지했으나, 올 2014년에는 단일공급계약을 제외하면 거의 100%를 차지한다. 또한, 2D와 3D를 기준으로 보면, 3D는 50%, 2D는 30% 가량을 차지하고 있다. 한편, 디텍터부문은 TFT Detector와 CMOS Detector가 5:5의 비중으로 대부분을 차지하고 있다.

동사의 지역별 매출


한편 동사의 지역별 매출 구성을 보면, 한국과 중국이 포함된 아시아의 매출이 47%이고 유럽과 북아메리카가 각각 23%, 20%로 그 뒤를 잇고 있다. 중동은 6%로 4위이다.

그림 11. 동사의 제품별 매출 비중 (2012 매출액 기준)

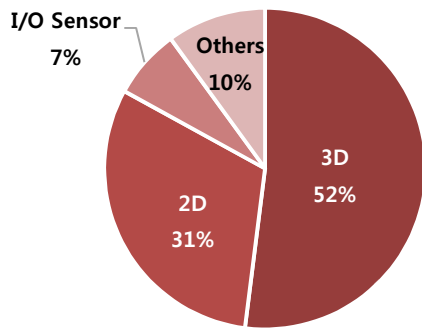

출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 12. 동사의 지역별 매출 비중 (2013 매출액 기준)

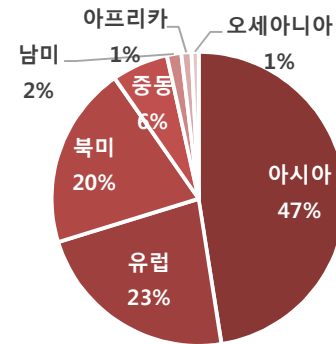


출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

2.4. 시장점유율

국내 1위, 글로벌 5
위 업체


동사의 국내 시장점유율은 2D의 경우 60%, 3D의 경우 약 90%이다. 한편, 글로벌 시장의 경우, 2012년, Sirona, Danaher, Carestream, Planmeca의 뒤를 이어 점유율 10.1%로 5위를 차지하고 있다. 이는 2011년 9.1%에서 상승한 것이다.

그림 13. 동사의 국내 시장 점유율 (2013년 기준)

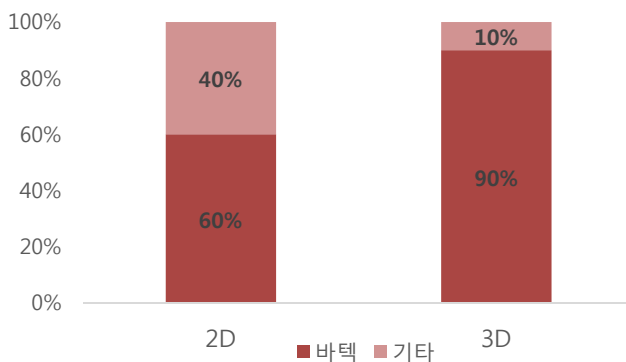

출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 14. 동사의 글로벌 시장 점유율 (2012년 기준)

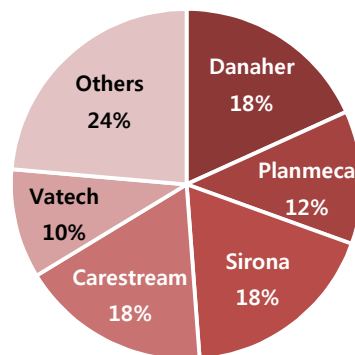

출처: 동사 자료, Dental Radiology Equipment, SMIC RESEARCH TEAM 3

3. 투자포인트1 : 중국시장은 기본, 중동·브라질 시장은 덩.

3.1. 중국 시장에서의 안정적 성장

3.1.1. 중국 치과의료기기 시장의 성장


중국 치과기기/용품
시장 연평균 28.2%
빠른 성장.

동사의 주력 제품인 치과용 진단영상기기는 의료기기 산업 분류상 치과기기/용품에 속한다. 중국 치과기기/용품 시장은 2008년 기준 1억 6천만 달러에서 2013년 5억 7천만 달러로 연 평균 28.2%의 속도로 빠르게 성장했다. 2013년 기준, 치과기기/용품 시장은 중국 전체 의료기기 시장 내에서 3.3% 비중을 차지하고 있으며, 중국 전체 의료기기 시장은 2013년 이후 연평균 18.7%씩 성장하여 2017년에는 337억 달러에 달할 것으로 예상된다.

치과용 영상진단기기
시장 2017년 2억 달
러 전망.


국민 소득이 증가함에 따라 치과 수요가 증가한다는 것을 감안하였을 때, 치과기기/용품 시장은 2017년 약 12억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 이 중 치과용 영상진단기기 시장은 약 18%으로 2017년 2억 달러 수준에 이를 것으로 예상된다.

그림 15. 중국 전체 의료기기 시장 추이 (단위: 백만\$)

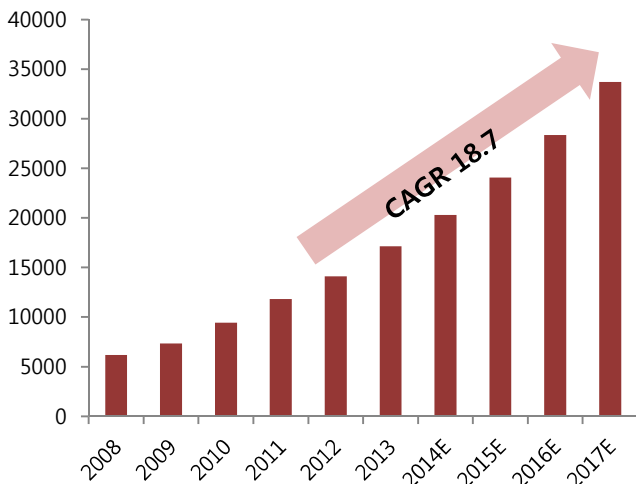

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 16. 중국 치과용 X-ray 시장 (단위: 백만\$)

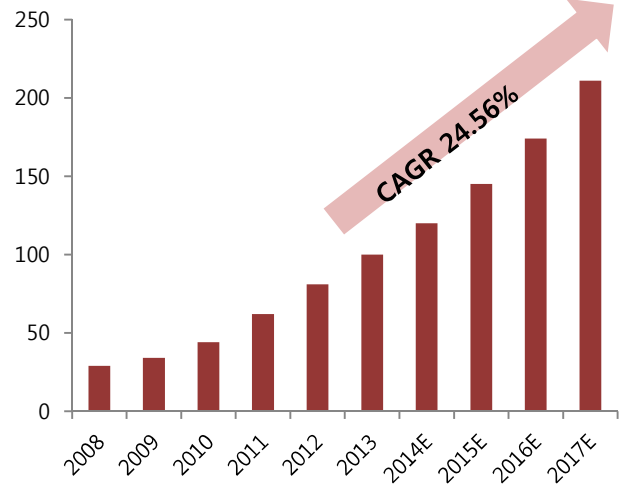

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

중국 점유율 1위, 대형 유통업체 계약으로 전년 대비 100% 이상 매출 달성.

동사의 2013년 대 중국 매출은 약 100억원에 달하며, 이는 2013년 전체 중국 치과용 X-ray 시장 규모인 1000억원의 10%로 1위이다. 동사는 올해 현지 대형 유통업체와 약 220억 원 규모의 공급 계약을 체결하여 전년 대비 100% 이상의 대중국 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 동사는 현재 중국에 현지법인을 설립하여 직접 영업을 진행하고 있지만, 이제까지 물리적으로 중국 전역을 커버하는 데 한계가 있었던 점을 고려하면, 중국 주요 거점 도시에 효과적인 유통망을 확보함으로써 시장 점유율을 높여갈 수 있을 것으로 예상된다.

그림 17. 중국 대형 유통업체 계약 내용

회사	내용
강다社	2년간 273억원 규모의 계약, 올해는 약 120억원, 내년에는 170억원 매출 예상.
화광社	PaXUni3D 1년간 50억원 공급 계약 체결. (화서, 화남, 화북 지역)
사원社	PaXUni3D 1년간 50억원 공급 계약 체결. (화동 지역)


출처: 동사 사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

3.1.2 중국 임플란트 시장의 성장

중국 임플란트 시장
연평균 16.4% 성장,
OPM 높은 3D
X-RAY 장비 비중 증
가 예상.


이처럼 동사의 중국 시장에서의 성장을 가능케 하는 또 다른 원동력으로 중국 임플란트 시장의 성장이 있다. 중국 임플란트 시장은 2013년 기준 1980억원 수준으로 전 세계 임플란트 시장의 5%를 차지하고 있으며, 향후 연평균 16.4%로 성장하여 2017년 3740억원 전 세계 임플란트 시장의 9% 수준에 도달할 것으로 예상된다. 동사가 생산하는 3D 치과용 X-RAY는 임플란트 시술에서 필수적인 장비이므로 향후 중국 임플란트 시장의 성장에 따라 치과용 X-RAY 장비 중 3D 장비의 수요는 점차 증가할 것으로 예상된다. 현재 동사가 중국에 공급하고 있는 제품의 약 50% 이상이 3D X-ray이며, 3D 제품의 비중은 2017년 약 70%에 달할 것으로 추정된다.

그림 18. 세계 임플란트 시장 중국 점유율 (단위: %)

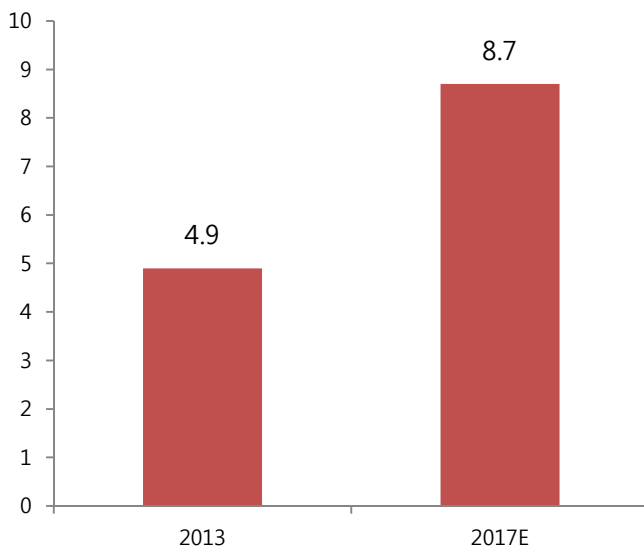

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 19. 중국 임플란트 시장 성장 추이 (단위: 백만 \$)

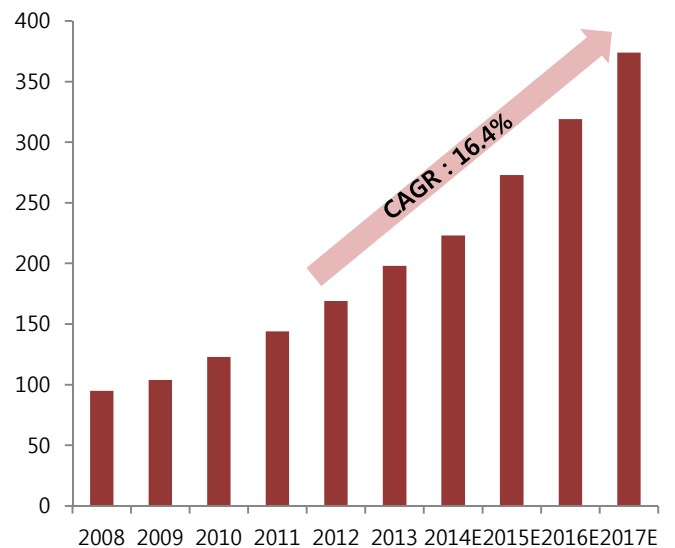

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

동사의 원가 경쟁력과 지리적 인접성 등을 고려할 때, 보수적으로 보아도 2014년 예상 M/S인 18% 수준을 유지할 수 있을 것으로 보인다. 2017년 중국 내 바텍의 X-RAY 시장의 예상 매출은 약 380억 원이다.

3.2. 숨은 보물단지, 중동

3.2.1. 중동 정부의 의료비 지출 증가

중동 지역의 정부 의료비 지출 연평균 12.2% 증가, 치과의사 11.7% 증가, 치과용 진단기기 시장 12% 성장 예상.

중동의 의료서비스 시장은 사우디아라비아와 이란 등 경제 수준이 높은 국가에 편중된 경향을 보인다. 중동지역 의료서비스의 70% 이상은 정부 주도로 공급되므로 중동 지역 의료서비스 시장 규모는 정부 의료비지출을 통해 추정할 수 있다. 사우디아라비아의 경우 정부 의료비 지출은 2008년 147억 달러에서 2013년 262억 달러 규모로 연평균 12.2%의 속도로 성장했다. 현재 중동 지역 정부가 의료 수준 향상에 힘쓰고 있는 점과 경제 수준 향상을 고려할 때, 향후 의료서비스 및 의료기기 시장 규모는 성장 여력이 크다. 이는 치과의 경우에도 마찬가지이며, 이는 치과 의사 수의 증가율과 1인당 GDP와 정부 의료비 지출 증가율에 따라 중동 치과용진단기기 시장은 연 평균 12%로 상승할 것으로 예상된다.

그림 20. 중동지역 국가별 의료비지출 (단위: 백만 \$)


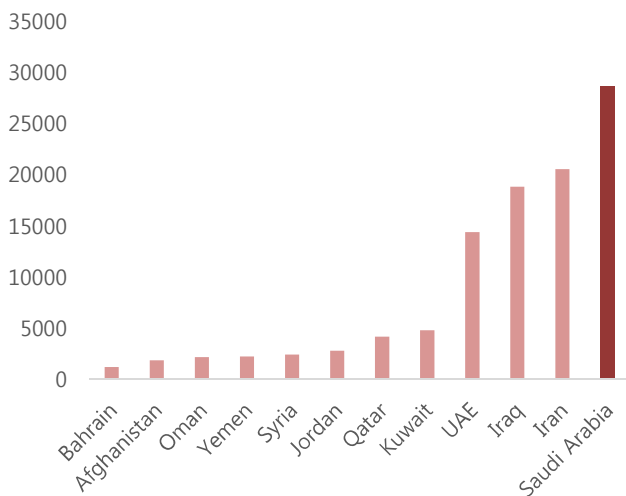


그림 21. 중동 치과의사 수 추이 (단위: 명)

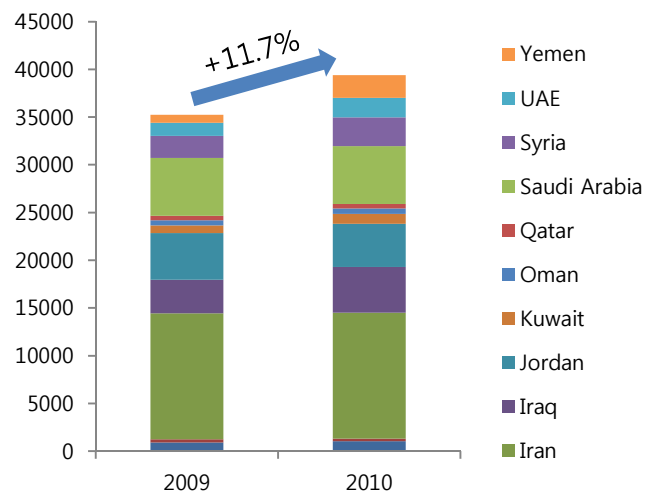

출처: WHO World Health Statistics, SMIC RESEARCH TEAM 3

출처: WHO World Health Statistics, SMIC RESEARCH TEAM 3

3.2.2. 현지 유통망 확보로 동사의 중동 시장 점유율 증가 예상


폐쇄적인 중동 시장에서 유통망 구축, 시장 점유율 29%

중동 시장은 왕정 특성상 정부의 영향력이 막대하며 외부에 폐쇄적인 특성을 가진다. 사우디아라비아의 경우, 해외 기업이 국내에서 직접 영업활동을 영위하지 못하며 반드시 국내 기업과 파트너십을 체결해야 영업 허가를 취득할 수 있다. 이에 더해 해당 국내 업체 지분의 51% 이상을 정부가 보유하고 있어야 한다. 이처럼 폐쇄적인 시장에서 동사는 현재 중동 현지 딜러와 계약을 체결하고 유통망을 구축했으며, 현재 중동 지역에서의 시장 점유율은 29%로 매우 높은 수준이다. 유통망 확보가 주요 진입장벽으로 작용한다는 점에서 신규 업체의 진입은 현재로서는 요원한 상황이며, 동사의 대 중동 매출은 2012년 64억 원에서 2013년 106억 원으로 약 1.7배 증가했다.

한-사우디 간 정책
합의, 보건의료 프로
젝트에서 우선권 확
보.


특히 2013년 9월 한국 보건복지부와 사우디아라비아 왕국은 보건 의료 3개 협력 분야에 합의했는데, 이 합의로 한국은 사우디 아라비아의 모든 보건소와 주요 공공 병원의 의료정보 시스템 구축 사업을 확보하였으며, 향후 보건의료 정보화 프로젝트에서 우선권을 가지게 되었다. 한국 의료 진료 시스템이 중동 지역에 공격적으로 보급되면서, 한국 의료기기 업체의 진출이 더욱 용이해질 것으로 예상된다. 이러한 우호적인 중동 시장 상황에서 동사의 시장 점유율은 현재 29%수준에서 크게 하락할 것이라 볼 이유가 없으므로, 동사의 중동 지역 매출은 향후 시장 성장에 따라 2017년 약 167억 원 수준까지 증가할 것으로 예상된다.

그림 22. 중동 전체 의료기기 시장 추이 (단위: 억 \$)

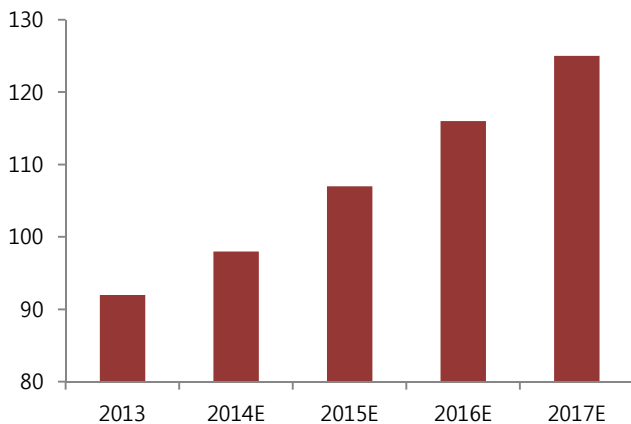

출처: 한국보건산업진흥원

그림 23. 중동 전체 치과용방사성진단기기 시장
(단위: 억 원)

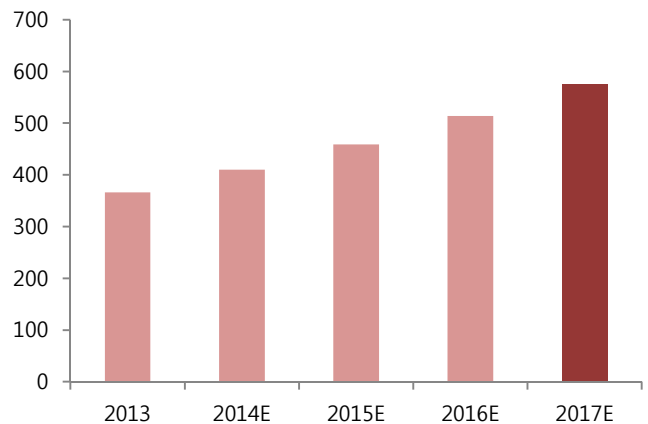

출처: SMIC Research Team 3

3.2.3. 2D에서 3D로 패러다임 변화

2D 시장 선점으로
향후, 3D 시장 안정
적 전환 예상.

현재 중동의 X-RAY 매출의 대부분은 2D X-RAY가 차지하고 있다. 중동이 경제적으로 성장하고 정부 의료비 지출이 증가한다는 것을 감안하였을 때, 향후 3D X-RAY의 비중이 증가할 것으로 예상된다. 치과용 X-RAY는 업체 별로 서로 다른 운영체제를 가지고 있다. 사람들이 익숙한 UI를 선호한다는 것을 감안한다면 향후 2D에서 3D X-RAY로 전환될 때 동사는 중동 시장에서 안정적인 매출을 올릴 것으로 예상된다.

3.3. 브라질


3.3.1. 브라질 임플란트 시장의 성장

브라질 임플란트 시
장 연평균 12.1% 성
장, 3D X-RAY 수요
증가.

브라질은 인구 1만 명 당 임플란트 판매 개수 기준, 세계 4위 국가이며 브라질 인구가 약 2억 1천만 명을 넘어선다는 점을 고려할 때 브라질 임플란트 시장은 상당한 규모이다. 현재 브라질 임플란트 시장은 1960억 원에 달하며, 연 평균 12.1%로 성장할 것으로 예상된다. 이러한 브라질의 임플란트 시장 성장에 따라 치과용 3D X-Ray 수요도 증가할 것으로 보인다.


2017년 브라질 치과용 X-RAY 시장규모 403억 원 예상. 2013년 기준 중남미 대륙의 치과용 방사선 촬영장치 시장은 1330억원 규모이며, 2017년 1610억원 규모로 성장할 것으로 예상된다. 중남미 대륙 치과용 방사선 촬영장치 시장에서 브라질 시장이 차지하는 비중은 2011년 기준 19%이다. 이를 바탕으로 추정했을 때, 브라질 치과용 방사선 촬영장치 시장은 연 평균 9% 성장하여 2017년 브라질 치과용 x-ray 시장 규모는 약 403억 원에 달할 것으로 예상된다.

그림 24. 인구 만명 당 임플란트 수 (단위: 개)

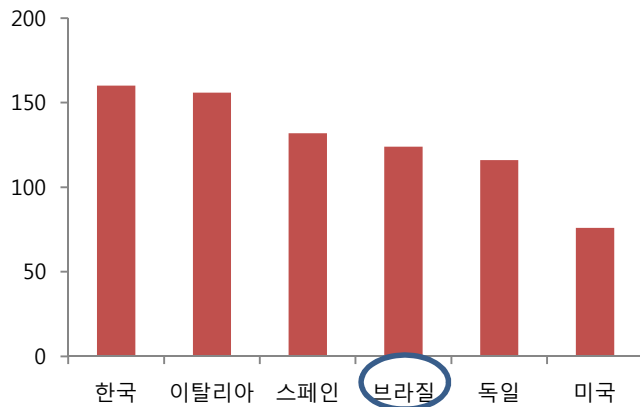

출처: Straumann 자료, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 25. 브라질 치과용방사선촬영장치시장 (단위: 백만\$)

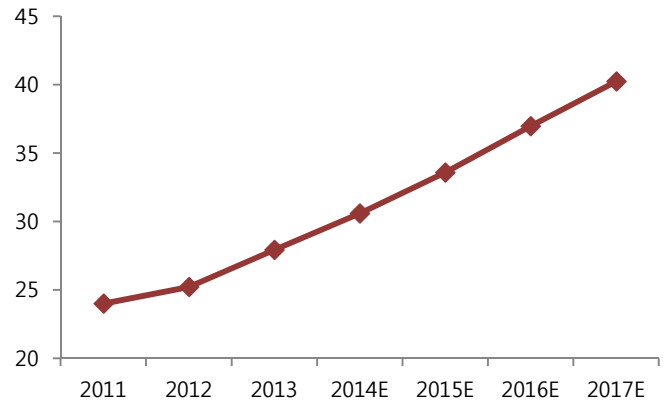

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

3.3.2. 브라질 현지 공장 설립 계획


한국보건산업진흥원의 자료에 따르면 동사 브라질 법인은 2011년 60억 원의 매출을 올렸다. 브라질 내 시장점유율은 25%였으며 현지 점유율 1위를 차지하였다. 하지만 이후 타 경쟁사가 브라질 시장에 진입하면서 2012년 동사의 브라질 매출은 47억 원으로 줄어들어 독일 시로나에 이어 현지 점유율 2위를 기록하였고 2013년 브라질 매출은 28억 원으로 현지 점유율 3위(10%)가 되었다.

이처럼 대 브라질 매출이 급격히 감소한 것은 비효율적 유통구조와 신제품 도입에 따른 인증 지연 때문이었다. 동사는 미주, 유럽의 경쟁업체에 비해 제품 운송거리가 상대적으로 길고, 브라질로 직항하는 선박이 없어 미국까지 1개월, 미국에서 브라질까지 1~2개월이 소요되면서 경쟁력을 상실했다. 또한 2012년 Pax-i 계열로 제품군이 리뉴얼되면서 현지 정부의 인허가 절차가 필요했는데, 이 과정이 지연되며 매출이 급감하였다.

브라질 현지 공장 계획, 향후 시장점유율 회복 예상.


하지만 이를 극복하기 위해 동사는 2014년 중으로 현지에 생산 시설을 건립할 계획을 가지고 있다. 현지에 생산 시설을 확보하게 되면 평균 54%에 달하는 관세 부과에서 자유로워짐에 따라 실제 판매가격이 출고가의 2배에 달하던 과거와 달리 가격경쟁력을 확보하게 될 것이다. 신규 생산 능력에 따른 매출 예상치를 고려할 때, 동사의 브라질 시장 점유율은 2017년 최소 2011년의 동사 시장점유율이던 25% 선까지는 회복될 것으로 예상된다. 따라서 2017년 동사의 브라질 매출액은 101억원 수준으로 증가할 것으로 예상된다.

그림 26. 동사의 브라질 점유율 예상 (단위: %)

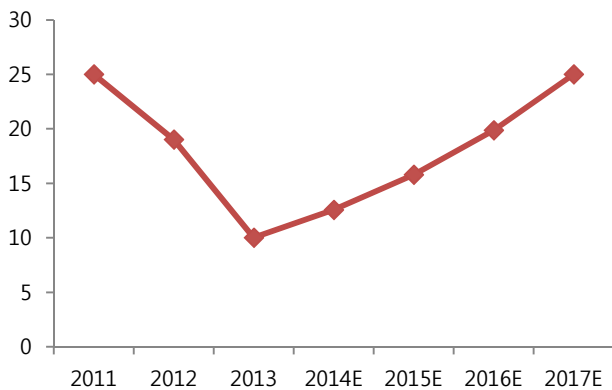

출처: 동사사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 27. 동사의 브라질 지역 매출 예상 (단위: 억 원)

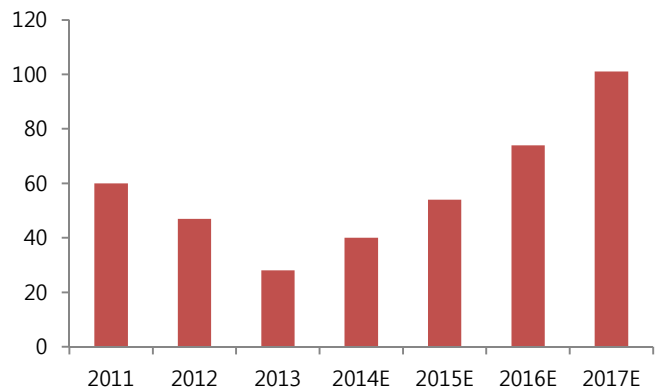


출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

3.4. 덴탈이미징 부문 매출추정

위의 내용을 바탕으로 동사의 덴탈이미징 부문의 매출을 추정해보면, **2014년 1176억원, 2015년 1355억원, 2016년 1561억원, 2017년 1799억원으로 예상된다.**

그림 28. 덴탈이미징 부문 매출추정 (단위: 억원)

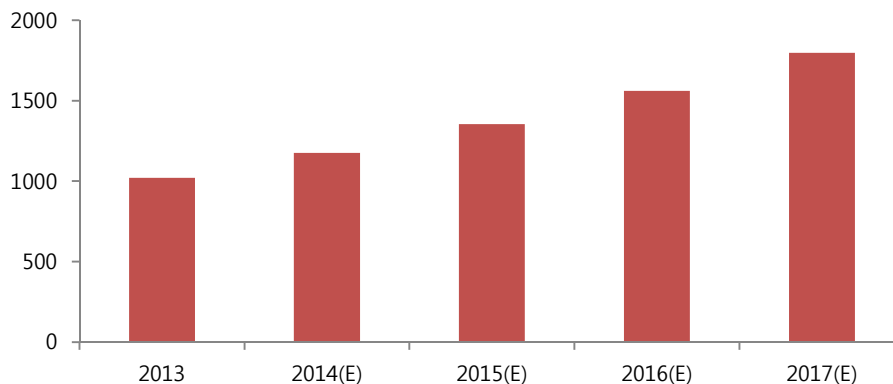


출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

3.5. 2D vs 3D mix 개선으로 OPM 향상


선진국 시장, 3D GREEN 수요 증가, 3D 매출 비중 상승 예상. 2013년 동사의 X-ray 수출액은 총 매출의 60% 수준으로 약 1021억 원에 달한다. X-ray의 지역별 매출 비중은 유럽 32%, 아시아는 30%, 북미 27%, 중동 8%, 남미 3%로 나타난다. 유럽과 북미 등 선진국 시장의 경우, 3D X-RAY의 매출 비중이 높은 반면 신흥시장의 경우 2D X-RAY 비중이 상대적으로 높은 편이나, **매출 비중이 높은 선진국 시장 수요의 대부분이 저선량 프리미엄 제품인 Pax-i 3D Green에서 발생하고, Pax-i 3D에 편중된 브라질 등 남미 시장이 성장하며 동사의 2D와 3D 매출 비중은 다음과 같이 변화할 것으로 예상된다.**

그림 29. 동사의 대륙별 매출 비중

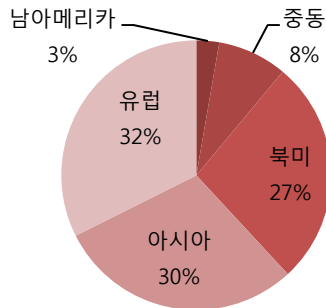

출처: 동사사업보고서, SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 30. 동사 대륙별 2D/3D 매출액비율 추정 (2013년 기준)

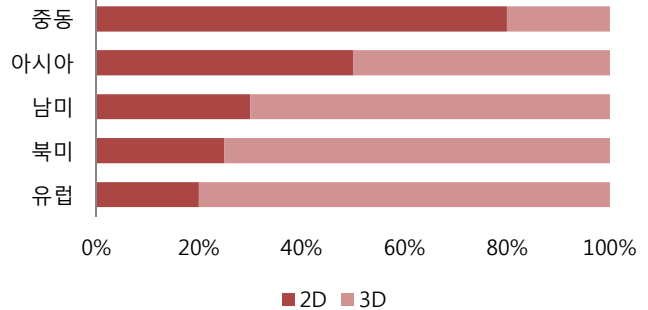

출처: 동사 자료


전세계적 3D X-RAY 매출 비중 증가.

2017년 동사의 유럽향 매출은 100% Pax-i3D GREEN으로 발생할 것이다. 아시아 시장은 아시아 임플란트 시장 규모 성장을 반영하여 추산하여 보았을 때, 2D와 3D X-RAY의 비율이 3:7로 성장할 것으로 예상된다. 남미 시장의 경우도 브라질 임플란트 시장의 급격한 성장으로 미루어 보아 보수적으로 추산하더라도 2:8 정도의 비율로 3D 매출 비중이 증가할 것으로 보인다. 중동의 경우, 최근 의료 산업 설비에 정부 지출이 증가함에 따라 첨단 의료 장비 수요가 늘어 2D와 3D의 매출 비중이 3:7이 될 것으로 예상된다. 북미의 경우, 시장이 다각화 되어있어 2D와 3D의 비중은 3:7을 유지할 것으로 보이지만 3D 매출 중, 저선량 제품인 3D GREEN의 비중이 증가할 것으로 예상된다.

2017년 동사 X-RAY 수출 1800억 원 예상.


2013년 1021억의 매출 중 362.1억 원은 2D에서 발생하였으며 658.9억 원은 3D에서 발생하였다. 2017년 예상 2D, 3D 매출 비중을 2017년 예상 매출액에 반영하여 계산하면 2017년 예상 동사의 X-RAY 수출은 약 1800억 원으로 예상되며 이중 약 350억 원은 2D에서 발생하고 약 1100억 원의 매출은 3D에서 발생할 것으로 예상된다. 이를 통해 동사의 영업이익률은 2017년 12.7%까지 개선될 것으로 예상된다.

그림 31. 동사 2D/3D/3D GREEN 매출 비중 변화

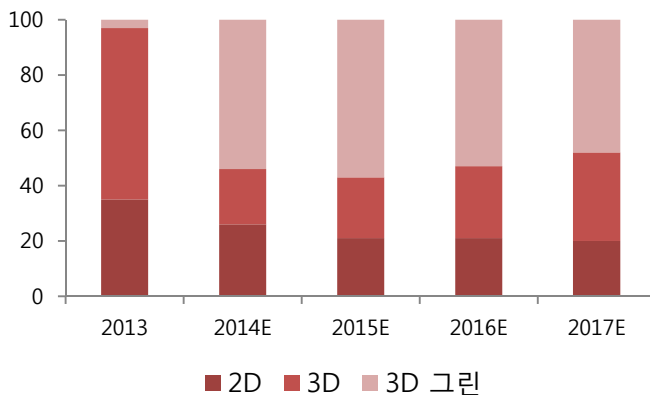

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 32. 동사 영업이익률 추이 예상

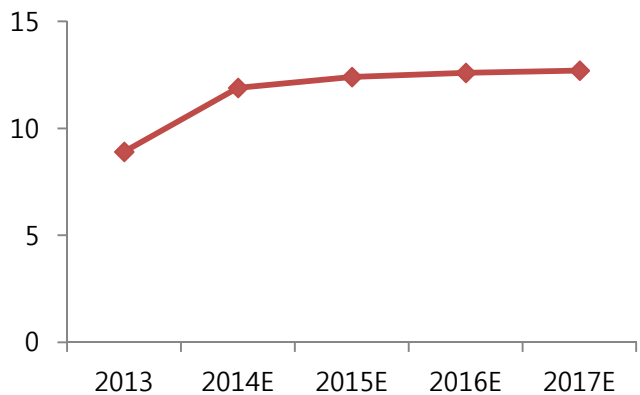

출처: 동사 자료


4. 투자포인트2. 자회사 레이언스의 독특한 효자노릇

4.1. 아날로그 장비의 디지털 전환으로 꾸준한 수요 발생

디지털 장치에 필수 부품인 Detector X-Ray 장비는 필름을 이용하는 아날로그 방식과 컴퓨터 화상 처리를 거치는 디지털 방식으로 나뉘는데, 동사의 주요 제품인 디텍터(Detector)는 아날로그 장비를 디지털화 시킬 수 있는 핵심부품이다.

Detector에 대한 꾸준한 수요 발생 환자의 방사선 피폭량이 많고 활용에 제한이 많다는 단점에도 불구하고 저렴한 가격 때문에 아날로그 방식은 여전히 전체 X-Ray 사용의 많은 부분을 차지하고 있으나 신규 생산되는 X-Ray 장치의 90%가 디지털 방식이므로 Detector에 대한 수요가 많다. 또 기존 아날로그 장치가 연 평균 10%씩 디지털로 전환되는 추세에 있고, Detector는 소모성 부품이므로 약 3~7년마다 교체 수요가 발생한다.

그림 33. 의료용 X-Ray 장치 시장규모와 기존 아날로그 방식 장치의 디지털 전환 비율 (단위: 좌-백만\$, 우-%)

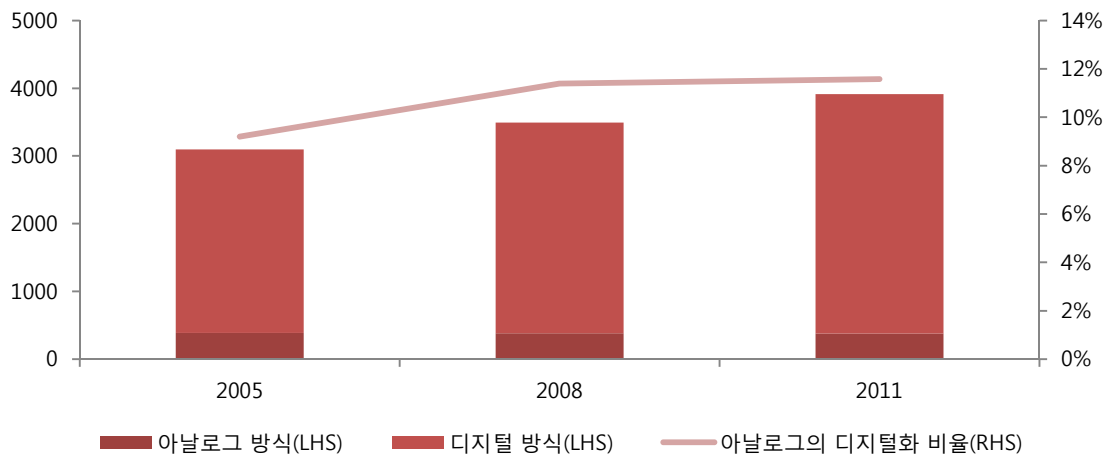

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC RESEARCH TEAM 3

Retrofit 시장이 2017년까지 연평균 14.87% 성장할 것으로 예상

또한, 디텍터부품을 새롭게 삽입함으로써 기계를 업그레이드하는 것을 의미하는 Retrofit Detector 시장은 2012년 15억 달러 규모에서 2017년 30억 달러로 성장할 것으로 예상된다. Detector와 X-Ray 장치의 호환성을 고려할 때 레이언스의 세계 Retrofit 및 Upgrade 시장 점유율은 현재 수준을 유지하면서, Retrofit 전체 시장의 성장과 함께 매출이 증가할 것이다.

그림 34. 전체 X-Ray시장과 Retrofit 시장 (단위: 억\$)


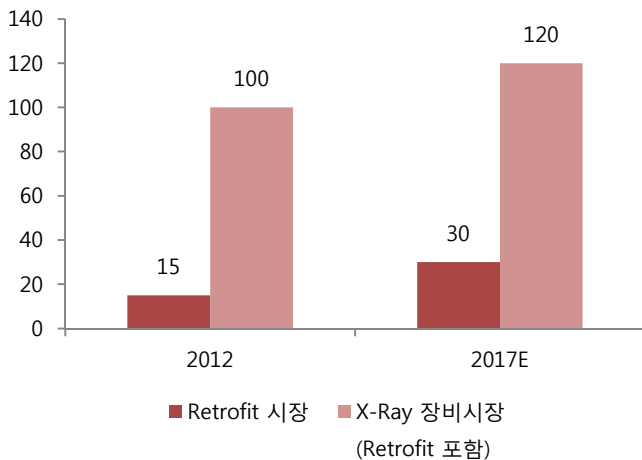


그림 35. 레이언스의 Retrofit 매출 추정 (단위: 억 원)

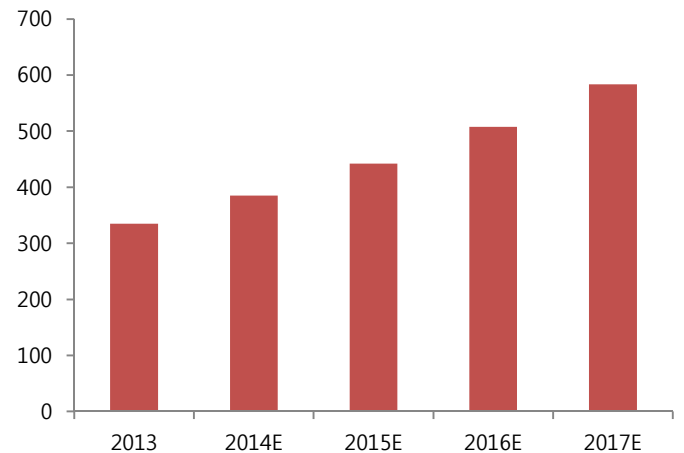

출처: IMS Research, SMIC RESEARCH TEAM 3

출처: SMIC RESEARCH TEAM3

4.2. CMOS Detector: 바텍과 GE Healthcare를 업고 성장

휴먼레이와의 합병으로 TFT, CMOS 생산

동사의 연결 자회사인 레이언스는 2011년 동사의 TFT Detector 사업부가 분리되어 설립되었다. 레이언스는 2012년 CMOS Detector 전문 생산업체인 휴먼레이와 합병하여 세계 최초로 TFT Detector와 CMOS Detector 생산 능력을 모두 갖추게 되었다. 동사의 Detector 매출 비중은 다음과 같다.

그림 36. Detector 매출비중




그림 37. TFT Detector의 매출비중


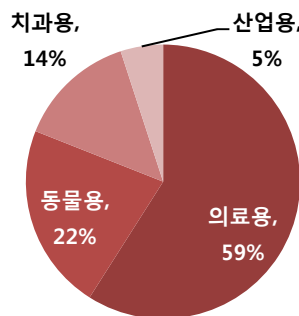



그림 38. CMOS Detector의 매출비중

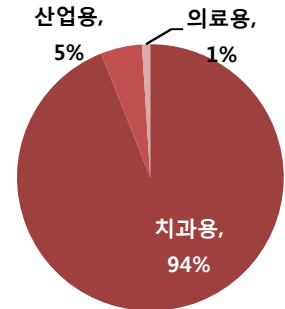

출처: 동사자료, SMIC RESEARCH TEAM 3

2013년 레이언스의 TFT Detector 매출 중 14%, CMOS Detector의 94%를 차지하는 치과용 Detector 매출은 대부분 바텍과의 내부매출에서 발생했다. 현재까지 레이언스는 동사의 치과용 X-RAY에 Detector를 독점 공급해왔으며, 향후 동사의 X-RAY 부문 성장에 따라 그 비중이 증가할 것으로 예상된다. Detector 가격이 X-RAY 장비 가격의 약 30%~40%를 차지한다는 점을 고려하여, 향후 동사로부터 발생하는 레이언스의 Detector 매출을 다음과 같이 추정하였다.

그림 39. 레이언스의 바텍 향 Detector 매출 추정 (단위: 억 원)

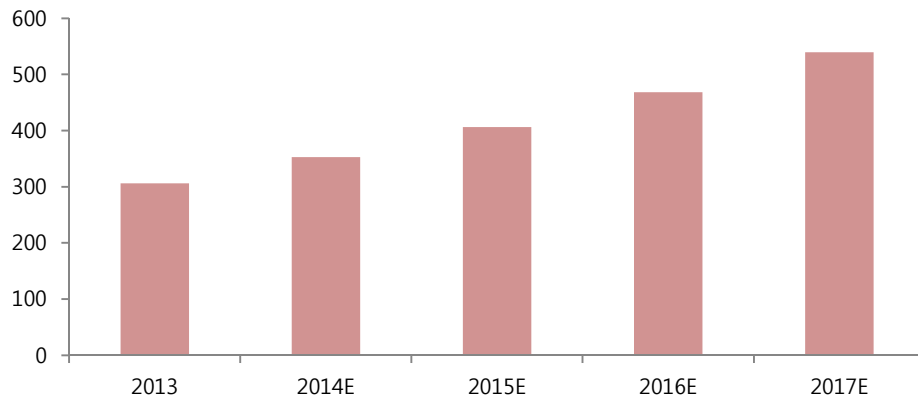


출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

한편, 레이언스는 2013년 6월 세계 X-RAY 장치시장 점유율 2위인 GE Healthcare에 유방암 진단용 X-Ray 장치 사업부를 매각하였으며, 유방암 X-Ray 진단 장치에 쓰이는 CMOS Detector를 독점 공급하는 계약을 함께 체결하였다. 이로써 향후 레이언스의 외부 매출 비중이 커질 것으로 예상되며, GE Healthcare라는 안정적인 수요처를 확보함으로써 CMOS 매출은 GE Healthcare의 유방암 진단용 X-Ray 장치 사업부 성장에 따라 함께 증가할 것으로 예상된다.

GE Healthcare 향 CMOS 디텍터 매출 2017년 378만\$ 예상

현재 GE Healthcare의 유방암 진단 X-Ray 장치 부문 시장 점유율은 21% 수준이며, 향후 진단 기기 시장의 성장에 따라 보급형 유방암 진단 X-Ray 장치 매출은 2017년 약 6천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 동사 IR에 따르면 아직까지 GE 향 매출은 본격적으로 발생하지 않았으나 현재 시제품 제작 과정에 있으며, 2014년 말부터 매출이 실현될 계획이다. 이에 따라 레이언스의 GE Healthcare 향 CMOS Detector 매출은 2017년 까지 약 378만 달러 규모에 달할 것으로 추정된다.

그림 40. 기업별 유방암 X-Ray 장치 시장점유율

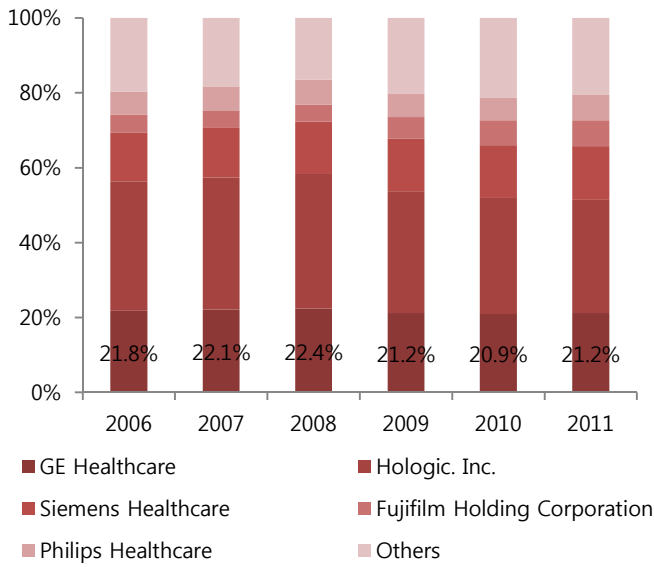

출처: Medical eTrack, Global Data, 2012, SMIC RESEARCH TEAM 3


그림 41. 세계 보급형 유방암 진단 X-Ray 장치 시장규모 (단위: 십만\$)



출처: GE Healthcare, SMIC RESEARCH TEAM 3


따라서, 위의 내용을 바탕으로 디텍터 부문의 매출을 추정해보면, 2014년 821억원, 2015년 997억원, 2016년 1131억원, 2017년 1285억원으로 예상된다.

그림 42. 레이언스의 GE Healthcare향 디텍터 매출추정 (단위: 억 원)

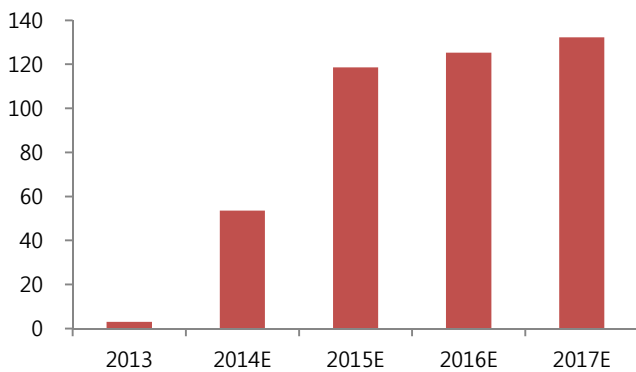

출처: SMIC RESEARCH TEAM 3

그림 43. 디텍터 부문의 매출추정 종합 (단위: 억 원)

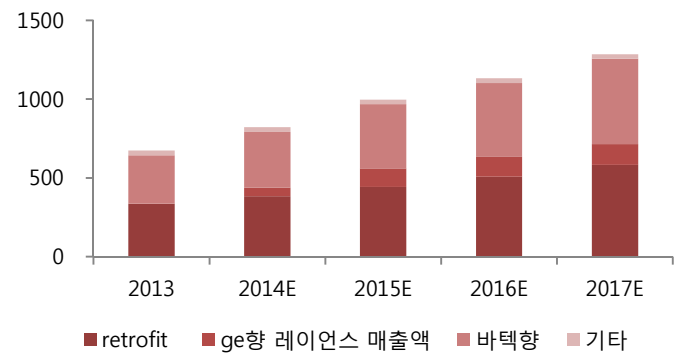


5. Issue & Risk

5.1. CAPA 증설 이슈


현재 동사의 가동률은 100%를 넘어서는 상황이다. 이에 동사 IR은 사업부 매각 등으로 발생한 현금을 디텍터와 디지털 이미징 부문 CAPA 증설에 사용할 계획을 밝혔다. 2014년 말 브라질에는 약 70억 원 규모의 CAPA 증설이 예상되며, 중국에도 현지 생산 시설을 확충 중이다. 따라서 향후 증대되는 수요에 대응할 수 있을 것으로 보인다.

그림 44. 동사의 가동률 추이

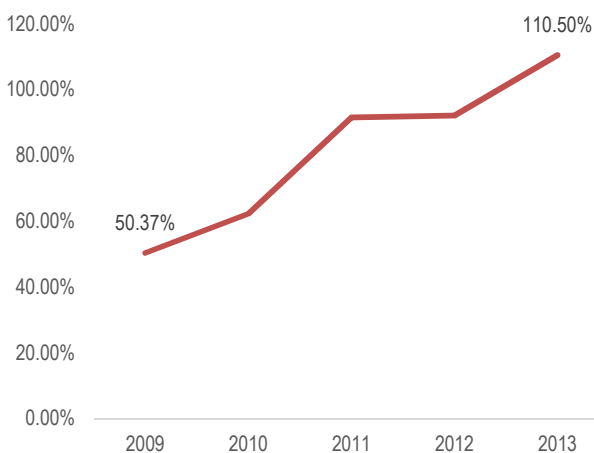

출처: 동사자료

그림 45. 현금 및 현금성 자산

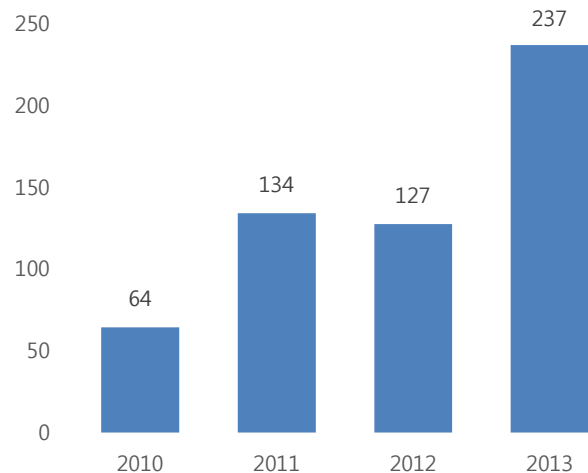

출처: 동사자료

5.2. 자회사 레이언스 상장 이슈

동사의 연결 자회사인 레이언스는 2014~2015년 중으로 IPO 계획을 가지고 있다. 현재 구체적인 상장 계획은 정해진 바 없으나, 레이언스의 성장성을 고려할 때 상장 이후 자회사에 대한 지분가치 상승이 기대된다. 본 보고서에서는 IPO의 불확실성으로 인해 밸류에이션에 반영하지 않았으나, 향후 지분가치를 반영하기 위해서는 관련 회사들의 기업가치 합산(SOTP)을 통한 적정 가치 인식이 필요할 수 있다.

6. Valuation

<PER Method>

6.1 매출액 추정

동사 덴탈 이미징 부문 매출 추정은 다음과 같다. (단위: 억 원)

	2013	2014(E)	2015(E)	2016(E)	2017(E)
매출액	1021	1176	1355	1561	1799
국내	472	491	506	521	531
중국	100	216	261	313	380
브라질	28	40	54	74	101
중동	106	119	133	149	167
기타	315	310	401	504	620
영업이익률	12.5%	14.0%	14.3%	14.7%	15.0%
영업이익	128	165	194	229	270

동사의 덴탈 이미징 부문 매출은 성장성이 높은 중국, 브라질, 중동, 기타 지역으로 나누어 추정하였다. 중국 시장의 경우 현재 수주 실적과 시장 성장성을 반영하였고, 브라질에서는 동사의 유통 경쟁력과 2014년 현지 생산 시설 설립을 통한 시장점유율 확대를 가정하고 추정하였다. 중동지역의 경우 현재의 높은 시장점유율을 유지한다고 가정하였다. 기타 지역에서는 지난 해 Derr Dental사와 체결한 2018년까지 1400억 원 규모의 공급 계약을 반영하고 경제성장률을 적용하였다.

덴탈 이미징 부문 영업 이익률은 대륙 별 2D, 3D, 3D Green 매출 비중 변화와 해외 진출 안정에 따른 판관비율 하락에 따라 상승할 것으로 예상하였다. 2014년 이후 본격적으로 매출이 발생하는 3D Green 제품은 북미와 유럽 지역에서의 3D 수요를 대체할 것이며, 동사 자료에 따르면 영업이익률이 16%에 달하여 OPM 개선을 이끌 것으로 보았다.

동사의 디텍터 부문 매출 추정은 다음과 같다. (단위: 억 원)

	2013	2014F	2015F	2016F	2017F
매출액	671	802	955	1063	1187
바텍형 CMOS	306	333	364	400	441
GE형 CMOS	3	54	119	125	132
Retrofit	335	385	442	508	583
기타	30	30	30	30	30
영업이익	71	90	113	134	154
영업이익률	10.6%	11.2%	11.8%	12.6%	13.0%

자회사 레이언스의 디텍터 매출 중 바텍 형 CMOS 비중은 약 50%에 달했으나, 2014년 하반기 GE 헬스케어와의 CMOS 공급이 시작되면 GE의 보급형 맘모그래피 매출 성장과

비례하여 외부 매출 비중이 증가할 것으로 보았다. 또한 세계 Retrofit 시장 규모가 증가하고 바텍의 시장 점유율이 상승하면서 부품 교체/ 업그레이드 부문의 매출도 같은 속도로 성장할 것으로 추정하였다.

디텍터 부문 영업이익률은 외부매출이 대부분인 경쟁사의 OPM 20%를 적용하여, 외부 매출 증가에 따라 상승할 것으로 보았다.

6.2 EPS 추정

이를 통해 추정된 동사의 연결 기준 매출은 다음과 같다.

(단위: 억 원)

	2013	2014F	2015F	2016F	2017F
매출액	1715	2001	2334	2648	3009
덴탈 이미징	1021	1176	1355	1561	1799
디텍터	671	802	955	1063	1187
기타	23	23	24	24	24
매출원가	973	1045	1210	1409	1651
매출총이익	742	956	1125	1238	1358
판매비와관리비	589	700	817	874	933
영업이익	153	256	308	365	425
영업이익률	8.9%	12.8%	13.2%	13.8%	14.1%
영업외손익	(128)	(84)	(44)	(44)	(44)
금융손익	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
기타영업외손익	(104)	(60)	(20)	(20)	(20)
법인세비용차감전순이익	25	172	264	321	381
법인세비용	6	43	66	81	96
당기순이익	141	128	197	240	285
계속영업당기순이익	18	128	197	240	285
중단영업 손익	123	0	0	0	0
비지배지분	84	42	53	59	66
지배기업소유주지분	57	86	144	181	220
지배주주 EPS	885	1,342	2,246	2,815	3,425

2013년 동사는 제품군을 대폭 정리하며 플랫폼을 통일했고, 이에 따라 대규모 재고자산폐기처분손실과 유무형 손상 차손이 발생하였다. 또한 GE헬스케어에 172억 원 규모 맘모그래피 자산을 매각하며 123억의 중단영업 손익을 기록하였다. 2014년에는 이러한 일시적 비용이 감소하며 당기순이익을 회복할 것으로 예상하였다.

매출원가율은 플랫폼 통일로 인한 원가 절감으로 향후 경쟁사 수준으로 하락할 것으로 예상하였고, 판매비율은 해외법인 운영과 해외 매출처가 안정화됨에 따라 점차 하락할 것으로 예상하였다. 현재 매출액의 10% 수준인 연구 개발비 또한 이전 수준으로 안정될 것으로 보았다. 법인세율은 25.2%를 일괄 적용하였으며, 비지배 지분은 레이언스에 대한 지분 45.7%를 적용하였다.

6.3. Peer 선정

현재 동사는 국내 시장 점유율 75%에 달하는 독점 기업이며, 국내에서 Peer를 찾기 어렵다. 이에 따라 글로벌 경쟁사인 Sirona 와 Danaher, 자회사 레이언스와 동일한 제품을 생산하는 뷰웍스 등의 2014년 예상 per multiple을 평균하여 target per을 산출하였다.

Sirona와 Danaher의 경우 현재 동사와의 시장 점유율 차이가 크지 않고, 동사가 가격 경쟁력과 유통망 선점으로 향후 중국을 중심으로 시장 점유율을 늘려갈 것으로 예상했으며, 향후 OPM도 비슷한 수준으로 개선될 것이므로 특별한 할인의 이유가 없다고 보았다. 또한 레이언스의 성장성에 따라 뷰웍스와 Varian, Perkin Elmer 등 x-ray 용 디텍터 및 관련 의료기기를 생산하는 업체들을 Peer에 포함시켰다. 동사가 디텍터 뿐 아니라 X-ray 완제품을 함께 생산한다는 점에서 이러한 Peer들을 포함시키는 것은 간접적인 할인의 효과가 있다고 판단했다. 그러나 뷰웍스를 제외한 Peer들이 모두 외국 기업이라는 점에서 국내 기업에 대한 저평가 요인을 반영하여 10%를 추가로 할인한 target per 15.15배를 산출하였다.

	PER
Sirona	18.03
Danaher	17.74
Varian	16.45
Perkin Elmer	16.03
뷰웍스	15.9
평균	16.83

2014년 예상 EPS 1342원에 PER Multiple 15.15를 적용한 결과 적정 주가는 20300원이다. 이에 SMIC RESEARCH TEAM 3는 상승여력 37%의 투자의견 BUY 를 제시한다.

발행주식수	자기주식수	유통주식수
14,854,256	8,441,674	6,412,582

14년 예상 PER	11.03
적용 PER	15.15
지배주주 EPS	1,342
적정주가	20,326
현재주가	14,800
상승여력	37%

7. Appendix

IFRS (연결)	연간					IFRS (연결)			
포괄손익계산서	201012	201112	201212	201312	현금흐름보고서	201012	201112	201212	201312
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	1,426	1,496	1,758	1,715	영업활동현금흐름	68	22	11	93
매출원가	911	985	1,123	973	당기순이익(순실)	81	16	53	141
매출총이익	516	511	635	742	비현금수익비용가감	159	105	134	92
판매비와 일반관리비	374	510	511	589	유무형감가상각비	43	44	54	71
인건비	160	185	225	227	금융자산처분손익		-49		-164
감가상각비	8	9	14	16	순이자비용	6	16	22	26
연구개발관련비용	39	41	47	81	외화손익	16	24	58	38
영업이익	142	1	124	153	관계기업투자손익				
*조정영업이익	96	1	124	153	기타	93	70	1	121
EBITDA	185	46	178	224	운전자본증감	-148	-31	-146	-90
비영업손익	-37	10	-42	-128	매출채권감소(증가)	29	79	-16	-122
금융손익	9	-17	-0	-8	재고자산감소(증가)	-47	-54	-60	-3
외환손익	-22	-2	-43	-5	매입채무증가(감소)	-54	-18	-66	63
관련기업투자등 관련손익					기타	-76	-38	-4	-29
기타손익	-25	29	1	-116	투자활동현금흐름	-121	-70	-164	-48
세전계속사업손익	104	11	82	25	유형자산취득	-97	-166	-63	-128
법인세비용	24	-5	26	6	유형자산처분	1	31	1	6
계속사업손익	81	16	56	18	무형자산증감	17	41	34	93
중단사업손익			-4	123	금융자산증감		-61	0	35
당기순이익(순손실)	81	16	53	141	기타	-42	85	-135	-53
지배주주지분	84	20	60	57	재무활동현금흐름	-0	115	147	64
비지배주주지분	-3	-4	-7	84					
포괄순이익(순손실)	80	-34	54	151	단기금융부채증감				
지배주주지분	83	-30	61	65	장기금융부채증감	19	132	157	30
대차대조표	IFRS (연결)				자본증감	-13	-9	-0	8
	201012	201112	201212	201312	배당금지급	-5	-15	-11	-15
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	기타	-0	7	1	40
비유동자산	539	600	683	796	기타현금흐름				
장기금융자산	96	20	34	55					
유형자산	310	278	423	480	순현금흐름	-53	70	-6	109
무형자산	77	94	111	149	기초현금	117	64	134	127
기타비유동자산	56	199	115	112	기말현금	64	134	127	237
유동자산	1,118	1,111	1,317	1,481	재무비율(%)	IFRS (연결)			
현금 및 현금성자산	64	134	127	237		201012	201112	201212	201312
단기금융자산	125	112	118	140	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출채권 및 기타채권	680	553	667	760	안정성				
재고자산	234	270	359	296	유동비율	147.92	142.39	142.26	149.06
기타유동자산	15	42	45	48	부채비율	105.83	129.06	130.60	117.42
자산총계	1,658	1,711	2,000	2,277	순차입금비율	17.95	32.01	48.15	30.15
비유동부채	96	184	207	236	이자보상배율	12.31	0.07	4.40	4.90
장기금융부채	44	126	116	150	자기자본비율	48.58	43.66	43.36	45.99
퇴직급여부채	35	48	67	59	성장성				
기타비유동부채	17	10	24	26	매출액증가율	N/A(IFRS)	4.90	17.50	-2.44
유동부채	756	781	925	993	판관비증가율	N/A(IFRS)	36.25	0.28	15.22
매입채무 및 기타채무	385	372	315	372	EBIT증가율	N/A(IFRS)	-98.95	8,210.44	23.41
단기금융부채	290	359	546	542	EBITDA증가율	N/A(IFRS)	-75.38	290.16	26.36
기타유동부채	81	49	64	79	지배주주EPS증가율	N/A(IFRS)	-81.41	193.44	-5.46
부채총계	852	964	1,133	1,230	수익성				
지배주주지분	810	755	758	829	매출총이익율	36.16	34.17	36.14	43.27
자본금	74	74	74	74	세전계속사업이익률	7.32	0.76	4.67	1.44
자본잉여금	273	273	232	247	EBIT마진율	9.93	0.10	7.06	8.93
기타포괄손익누계액	49	-0	1	2	EBITDA마진율	12.96	3.04	10.10	13.08
기타자본구성요소	-13	-22	-28	-22	ROA	N/A(IFRS)	0.98	2.85	6.59
자기주식	-13	-22	-28	-22	지배주주ROE	N/A(IFRS)	2.62	7.94	7.16
이익잉여금	426	430	478	528	ROIC	N/A(IFRS)	0.26	8.31	9.06
비지배주주지분	-4	-8	110	218	활동성				
자본총계	805	747	867	1,047	총자산회전율	N/A(IFRS)	0.89	0.95	0.80
순운전자본	463	444	692	653	타인자본회전율	N/A(IFRS)	1.65	1.68	1.45
순차입금	145	239	418	316	자기자본회전율	N/A(IFRS)	1.93	2.18	1.79
투자자본	853	826	1,228	1,279	순운전자본회전율	N/A(IFRS)	3.30	3.09	2.55

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.