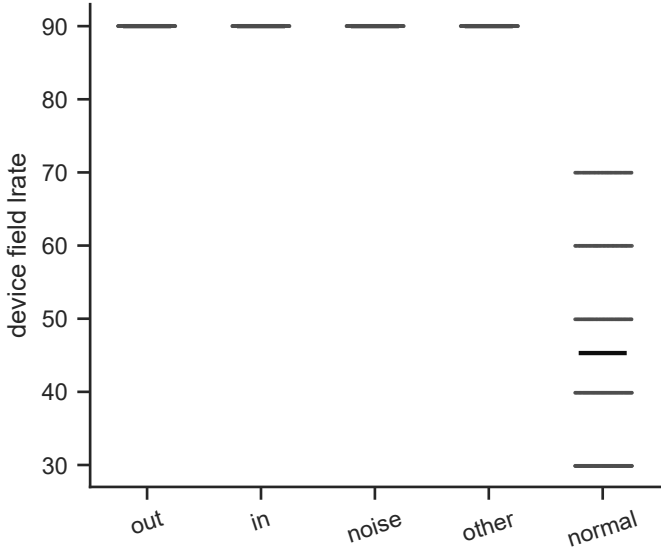
device field Irate
90
80
70
60
50
40
30
out
in
noise
other
normal

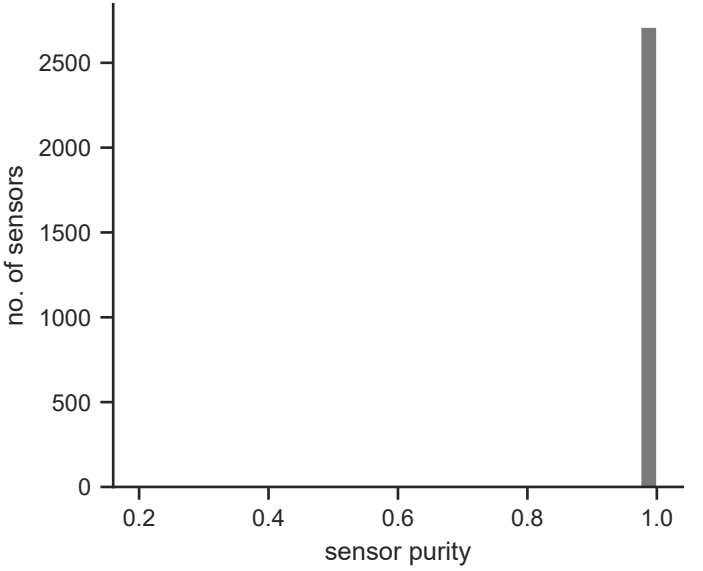
no. of sensors
2500
2000
1500
1000
500
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
sensor purity

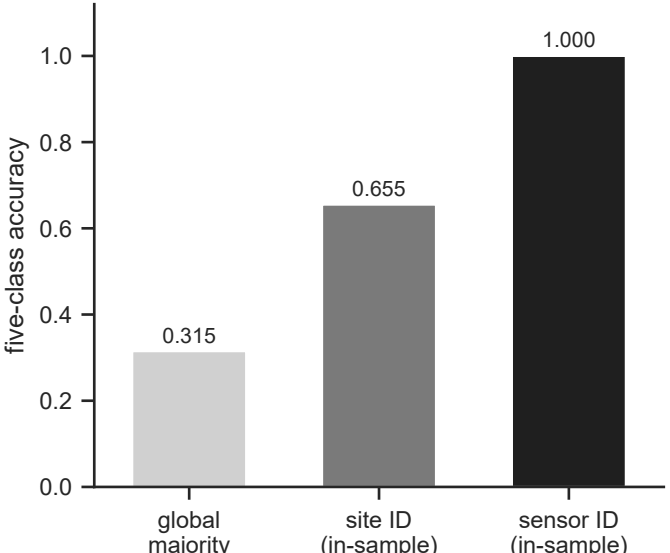
five-class accuracy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.315
0.655
1.000
global majority
site ID (in-sample)
sensor ID (in-sample)