


Percentiele vergelijking

25-75% 5-95%

Gemiddeld (A)

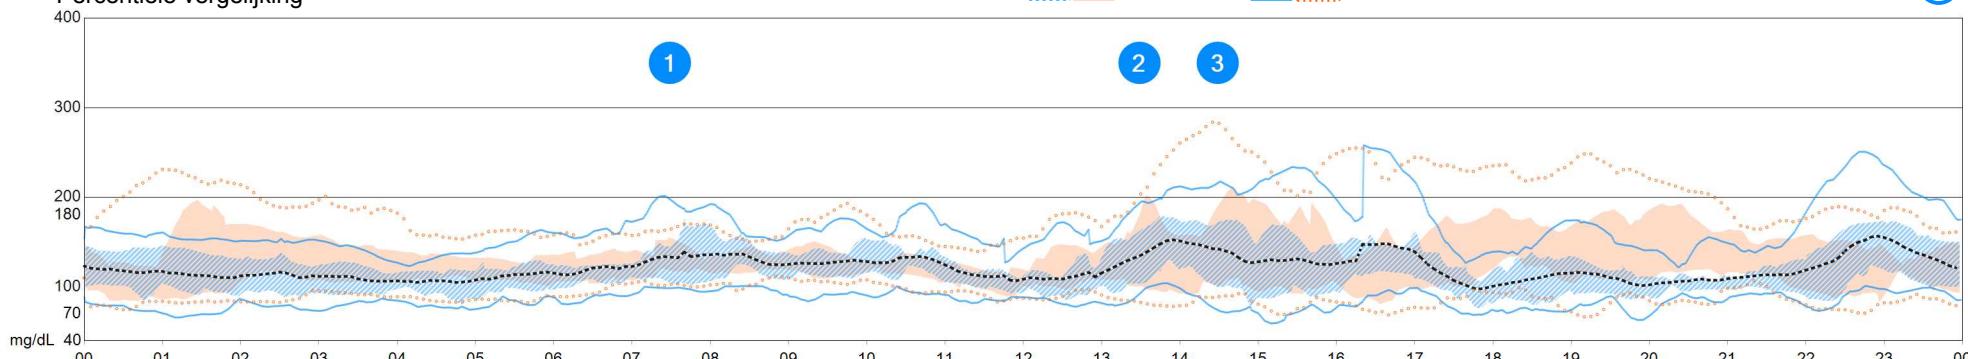

KH-ratio (g/U) ¹	(A) 10,0	9,5	9,5	8,5
(B)	10,0	9,5	9,5	8,5

Hypoglykemiepatronen (0)	Aantal episodes (per dag): 0,1	Hyperglykemiepatronen (5) ²	Aantal episodes (per dag): 1,2
Geen		1 07:00 - 07:59 (3 voorvalen) 2 13:00 - 13:59 (3 voorvalen) 3 14:00 - 14:59 (2 voorvalen)	

Tijd binnen bereik	SmartGuard verlaten	Statistieken
1% 5%	(A) Geen kalibratie 0 0	(A) SmartGuard (per week) 89% (6d 06h)
93% 87%	(B) SmartGuard Max toediening 0 0	(B) Manuele modus (per week) 5% (08h)
1% 1%	(A) SmartGuard Min toediening 0 0	(A) Gebruiksduur sensor (per week) 90% (6d 07h)
40 54 70 180 250 400 mg/dL	(B) BG vereist voor SmartGuard 0 0	(B) Gemiddelde SG ± STD 121 ± 35 mg/dL
	(A) Te lage waarde sensoralgortime 0 0	(A) GMI ³ 6,2%
	(B) Update sensor bezig 0 0	(B) Variatiecoëfficiënt (%) 29,1%
	(A) Geen SG-waarden 0 0	(A) Lage/hoge SG-alarmen (per dag) 0,6 / 2,0
	(B) Sensor uitgewerkt 0 0	(B) BG-gemiddelde 118 ± 59 mg/dL
	(A) SmartGuard uitgezet door gebruiker 4 8	(A) BG / Kalibratie (per dag) 1,3 / 0,9
	(B) Langdurige stop 0 0	(B) Totale dagdosis (per dag) 28,1 eenheden
	(A) SmartGuard opwarmen 0 0	(B) Bolusdosis (per dag) 18,1E (64%)
	(B) Ongedefinieerd 0 0	(A) Autocorrectiehoeveelheid (per dag) 2,3E (13%)

¹ Meest recente pominstellingen worden weergegeven² Alleen hoogste prioriteit wordt weergegeven.³ Indicator voor glucoseregulering⁴ Geprogrammeerd 24-uurs totaal in Manuele modus voor actief basaal patroon