

A

Hypoglykemiepatronen (0)

Aantal episodes (per dag): 0,1

A

Geen

A

Hyperglykemiepatronen (5)<sup>2</sup>

Aantal episodes (per dag): 1,5

1

14:00 - 14:59  
(3 voorvallen)

2

15:00 - 15:59  
(3 voorvallen)

3

13:00 - 13:59  
(2 voorvallen)

Tijd binnen bereik

A

2%  
9%

B

5%  
16%

88%

78%

1%

1%

40 54 70 180 250 400 mg/dL

SmartGuard verlaten

A

B

Geen kalibratie

0

0

SmartGuard Max toediening

0

0

SmartGuard Min toediening

0

0

BG vereist voor SmartGuard

0

0

Te lage waarde sensoralgoritme

0

0

Update sensor bezig

0

0

Geen SG-waarden

0

0

Sensor uitgewerkt

0

1 •

SmartGuard uitgezet door gebruiker

• • • • • 5

11 • • • • • +

Langdurige stop

0

0

SmartGuard opwarmen

0

0

Ongedefinieerd

0

0

Statistieken

A

B

SmartGuard (per week)

93% (6d 12h)

88% (6d 04h)

Manuele modus (per week)

2% (04h)

12% (20h)

Gebruiksduur sensor (per week)

90% (6d 07h)

94% (6d 14h)

Gemiddelde SG ± STD

132 ± 40 mg/dL

144 ± 52 mg/dL

GMI<sup>3</sup>

6,5%

6,8%

Variatiecoëfficiënt (%)

30,2%

35,8%

Lage/hoge SG-alarmen (per dag)

0,1 / 2,5

0,8 / 4,9

BG-gemiddelde

131 ± 72 mg/dL

158 ± 65 mg/dL

BG / Kalibratie (per dag)

1,6 / 1,1

2,1 / 0,9

Totale dagdosis (per dag)

32,6 eenheden

33,0 eenheden

Bolusdosis (per dag)

22,7E (70%)

21,0E (64%)

Autocorrectiehoeveelheid (per dag)

3,7E (16%)

6,0E (29%)

Autobasaal / Basale dosis (per dag)

9,9E (30%)

12,0E (36%)

Infusieset/reservoir vervangen

3,0 / 3,0 dgn

3,7 / 3,7 dgn

KH-invoer/maaltijden (per dag)

162 ± 73 g / 6,0

128 ± 28 g / 5,6

Actieve-insulinetijd

2:00 uur

2:00 uur

Geprogrammeerd 24-uurs basaal handmatig<sup>4</sup>

18,100E

18,100E

SmartGuard-streefwaarde

100 mg/dL


100 mg/dL

1 Meest recente pompinstellingen worden weergegeven

2 Alleen hoogste prioriteit wordt weergegeven.


3 Indicator voor glucoseregulering

4 Geprogrammeerd 24-uurs totaal in Manuele modus voor actief basaal patroon

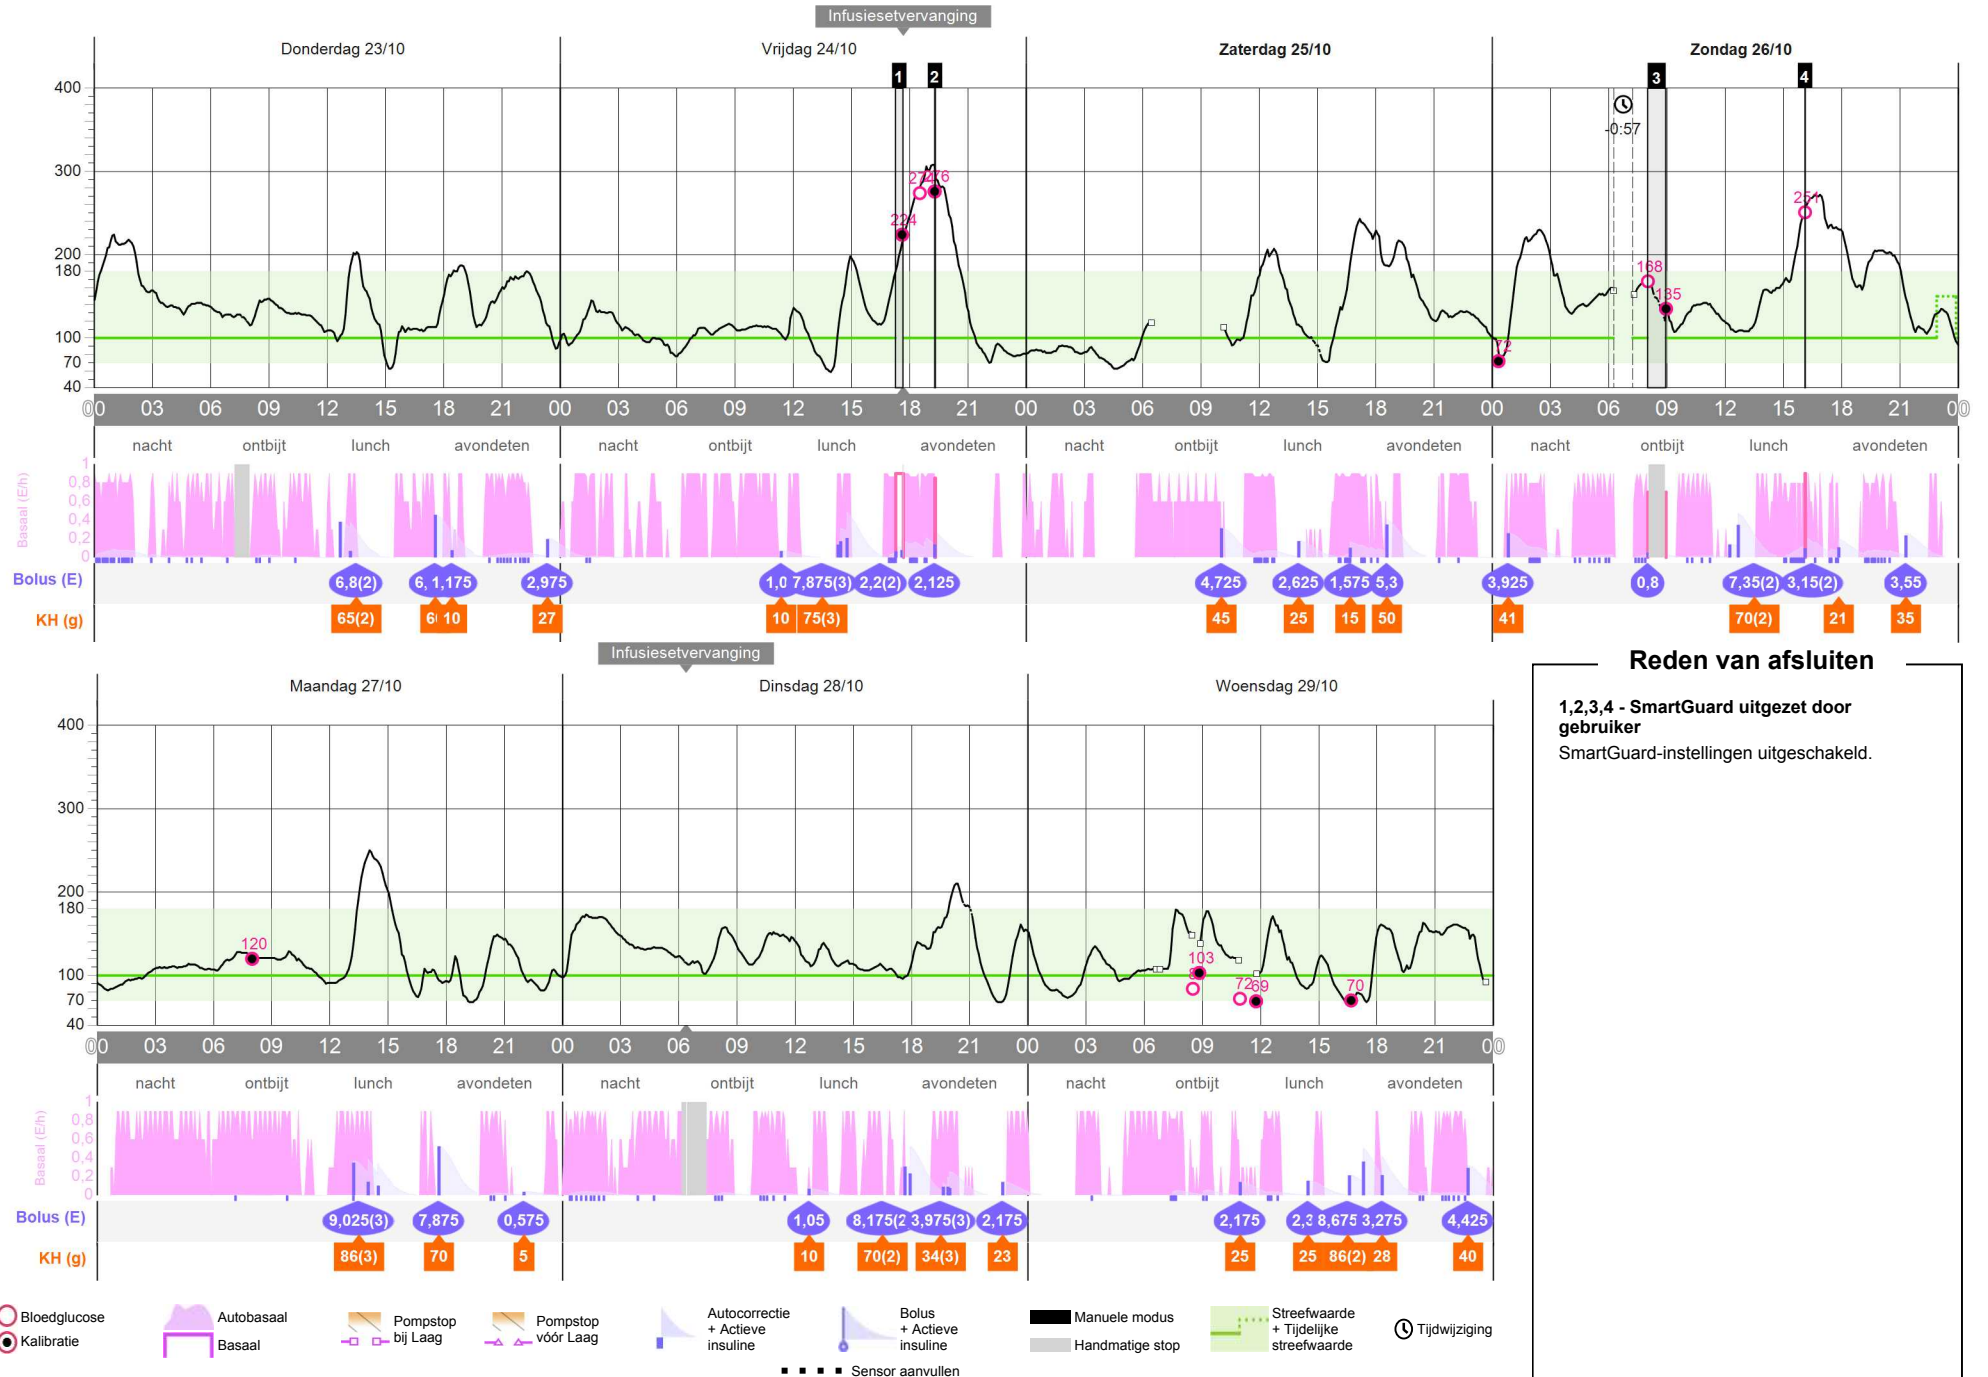

### Reden van afsluiten

1,2,3,4 - SmartGuard uitgezet door gebruiker  
SmartGuard-instellingen uitgeschakeld.

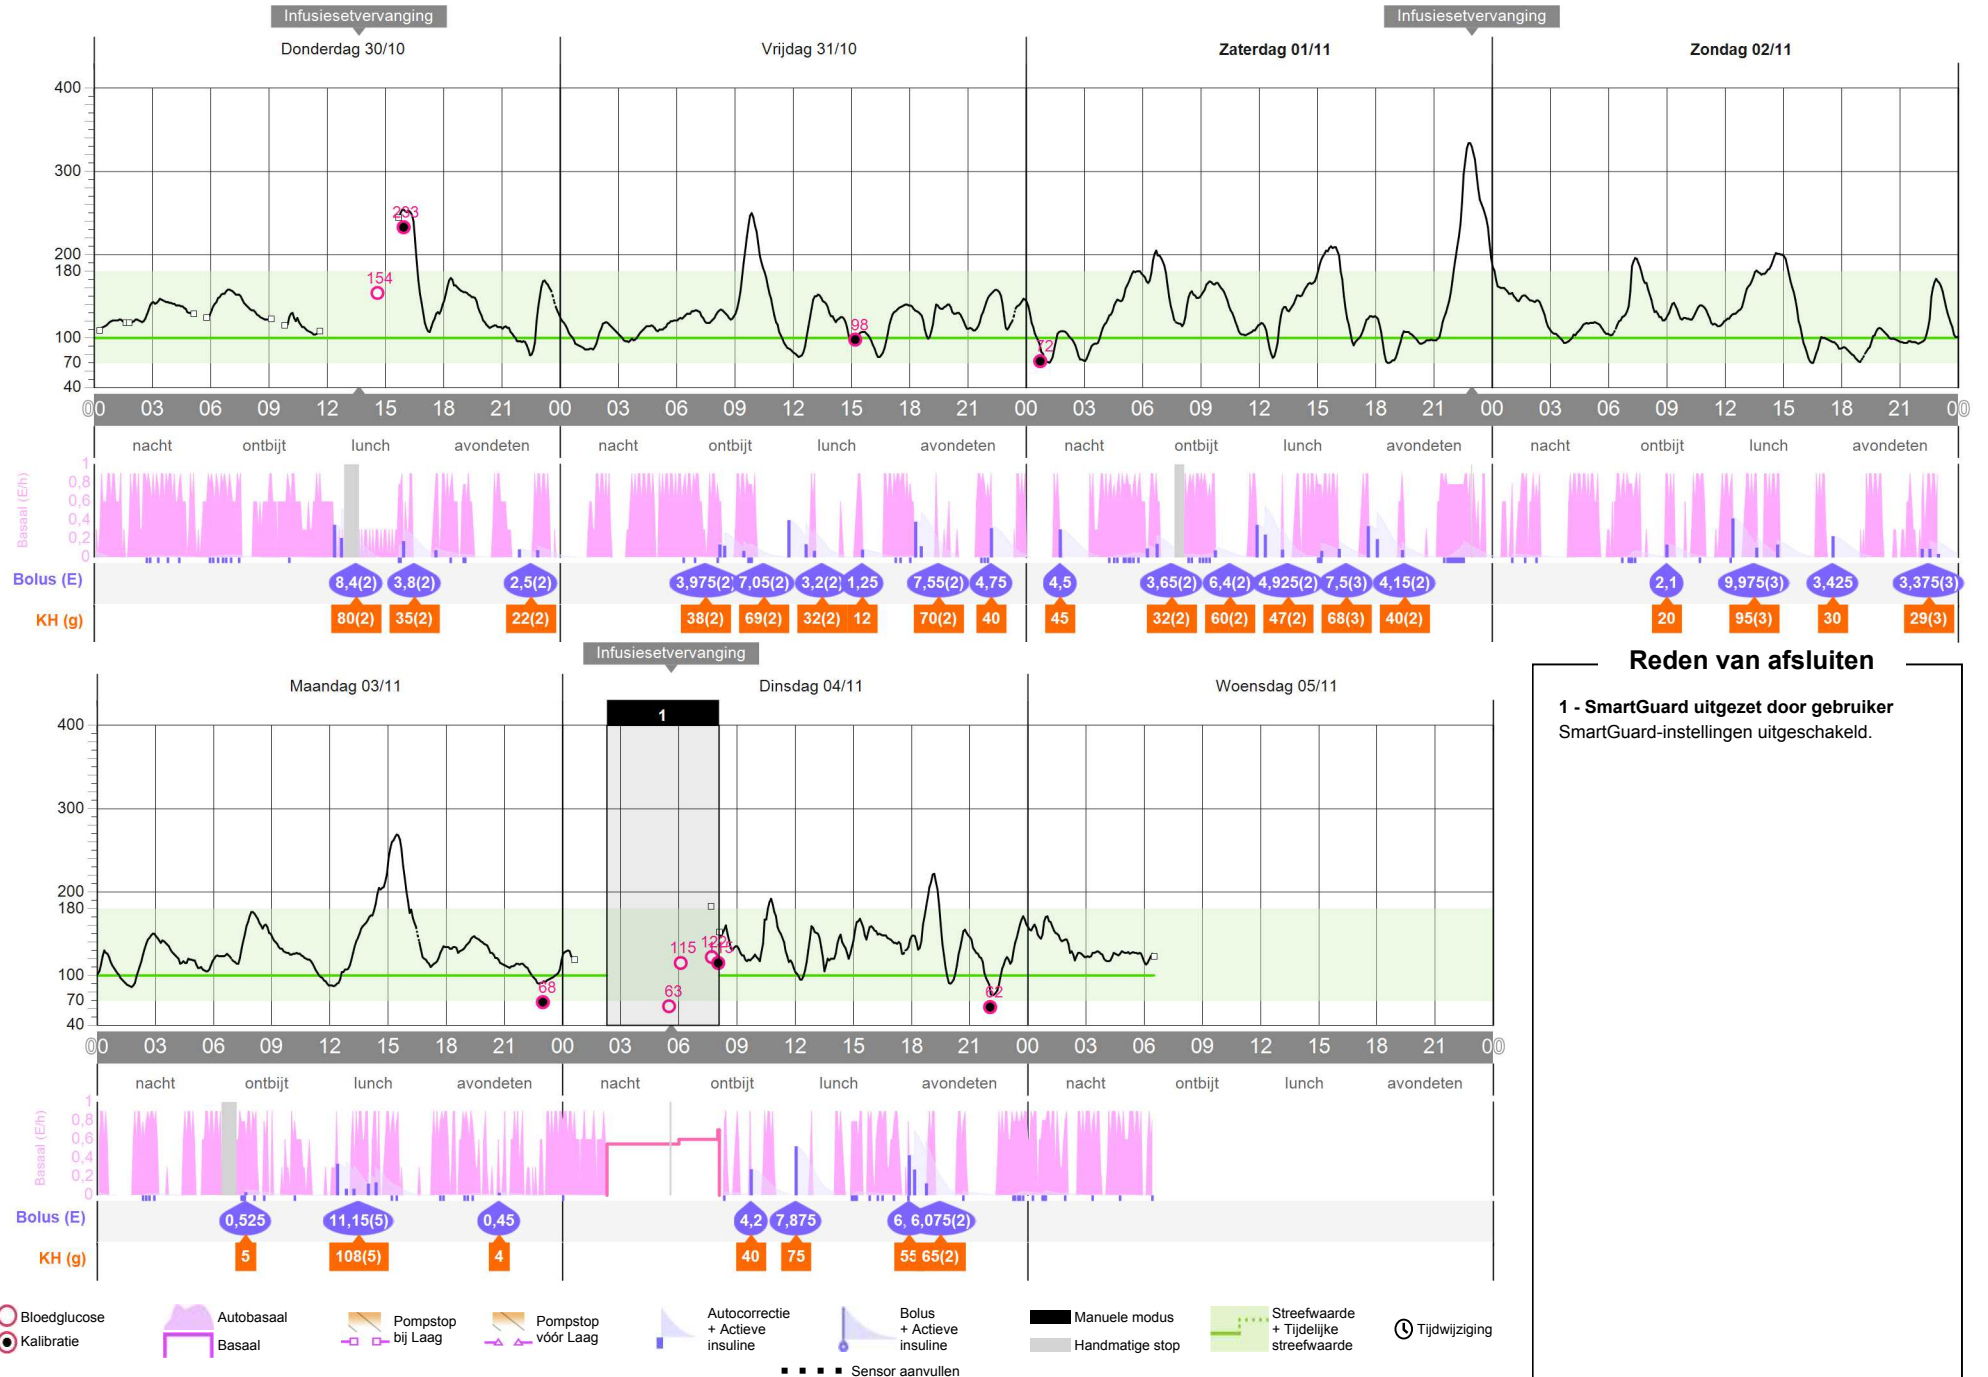

### Reden van afsluiten

- 1 - SmartGuard uitgezet door gebruiker  
SmartGuard-instellingen uitgeschakeld.

## Donderdag 23/10


TDD 34,2E

Totaal basaal 32% | 11,0E

Totaal bolus 68% | 23,2E

{ Bolus 77% | 17,8E + Autocorrectie 23% | 5,4E }

Tijd binnen bereik

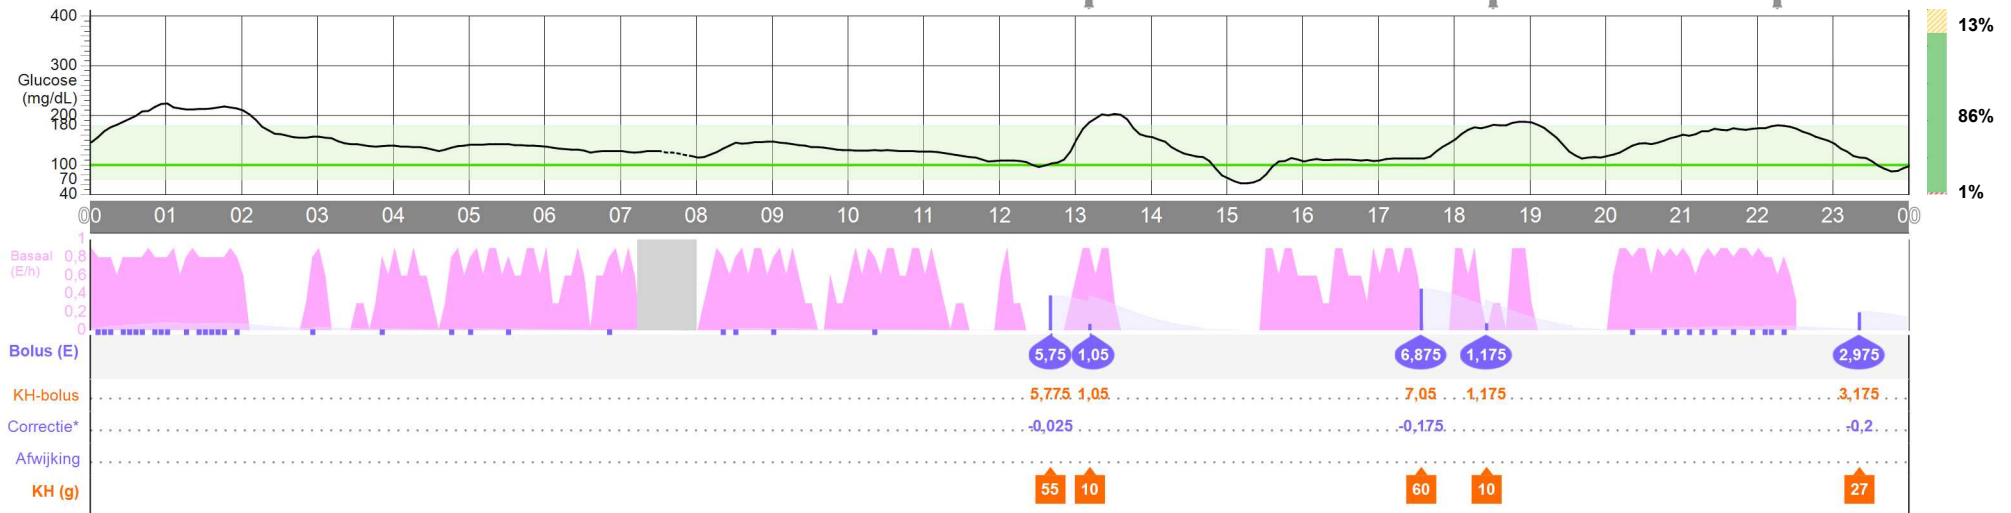

## Vrijdag 24/10


TDD 27,6E

Totaal basaal 38% | 10,4E

Totaal bolus 62% | 17,2E

{ Bolus 77% | 13,2E + Autocorrectie 23% | 4,0E }

Tijd binnen bereik

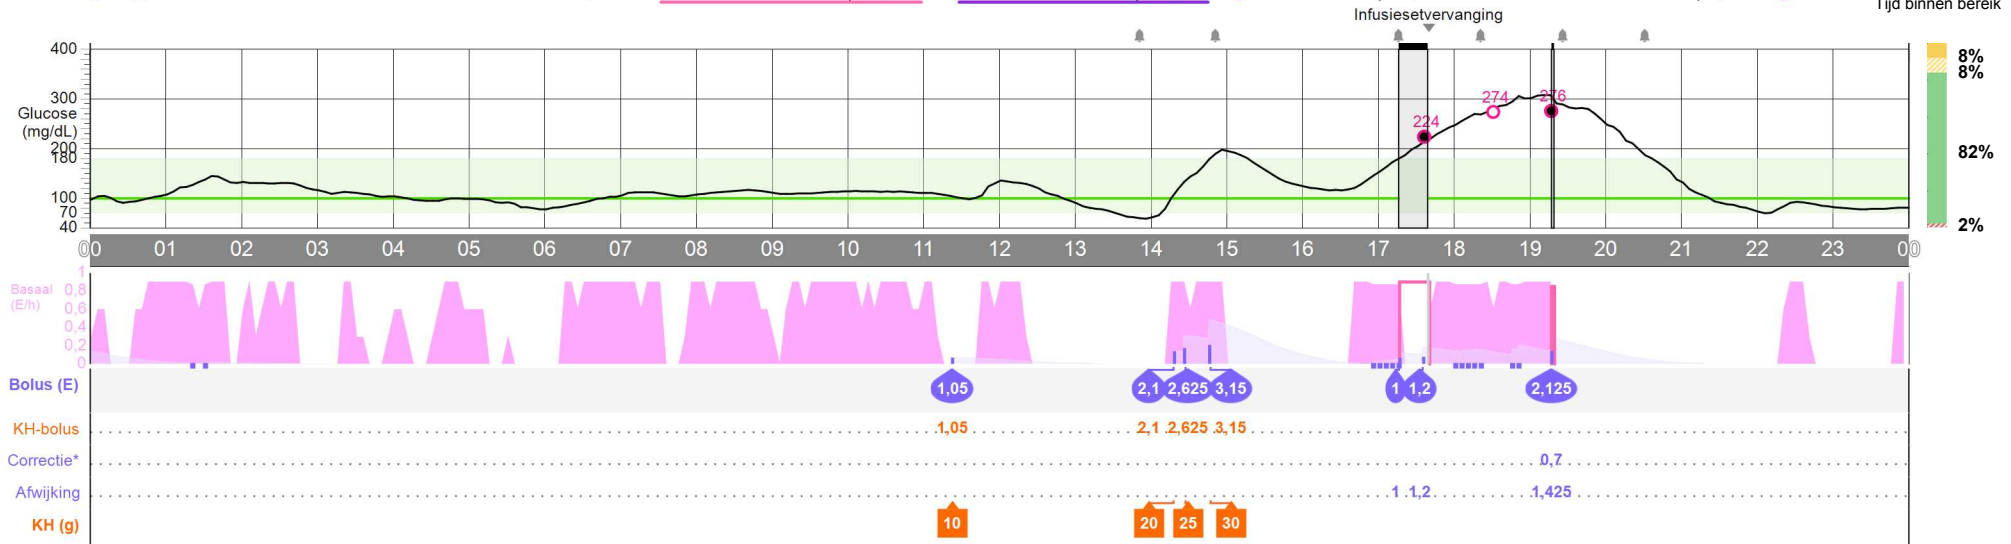

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



**Zaterdag 25/10**


TDD 28,4E

Totaal basaal 36% | 10,2E

Totaal bolus 64% | 18,2E

{ Bolus 78% | 14,2E + Autocorrectie 22% | 4,0E }

Tijd binnen bereik

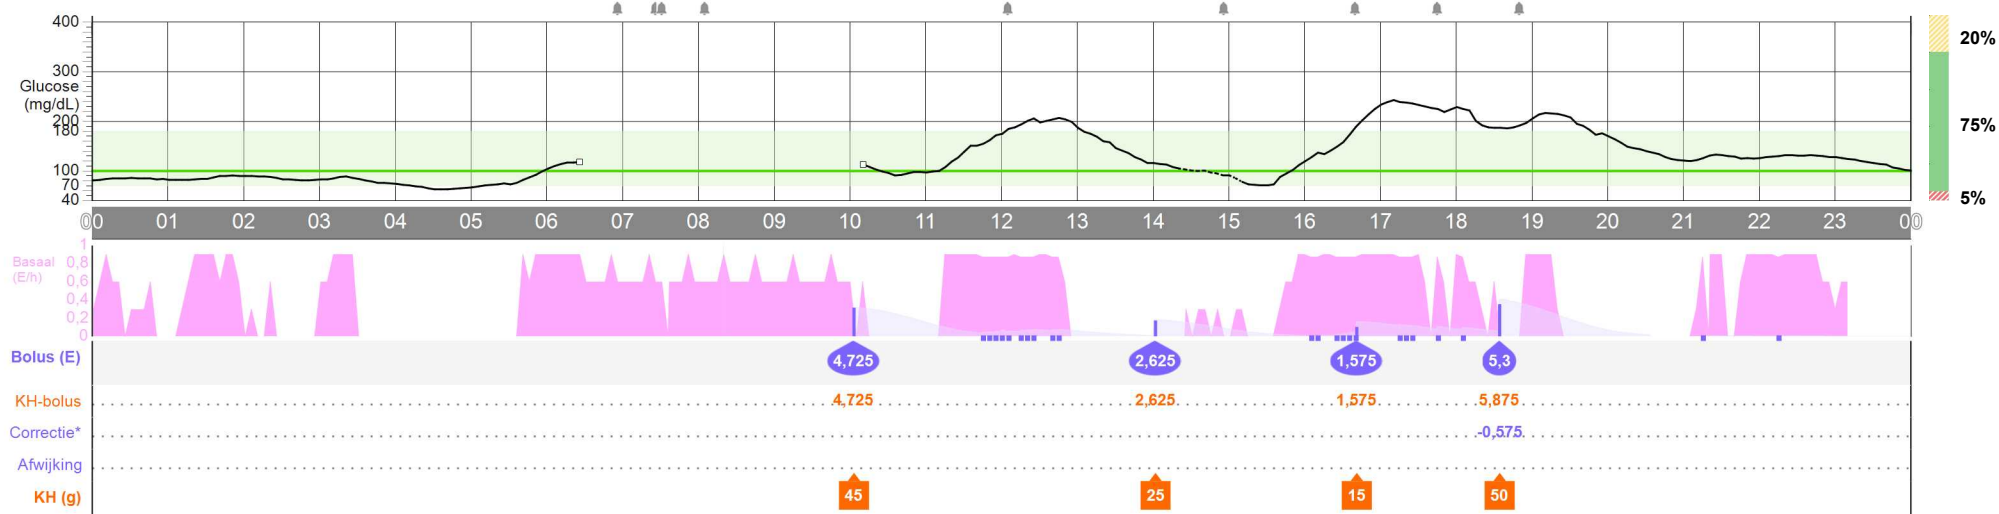

**Zondag 26/10**


TDD 39,3E

Totaal basaal 29% | 11,3E

Totaal bolus 71% | 28,0E

{ Bolus 67% | 18,8E + Autocorrectie 33% | 9,2E }

Tijd binnen bereik

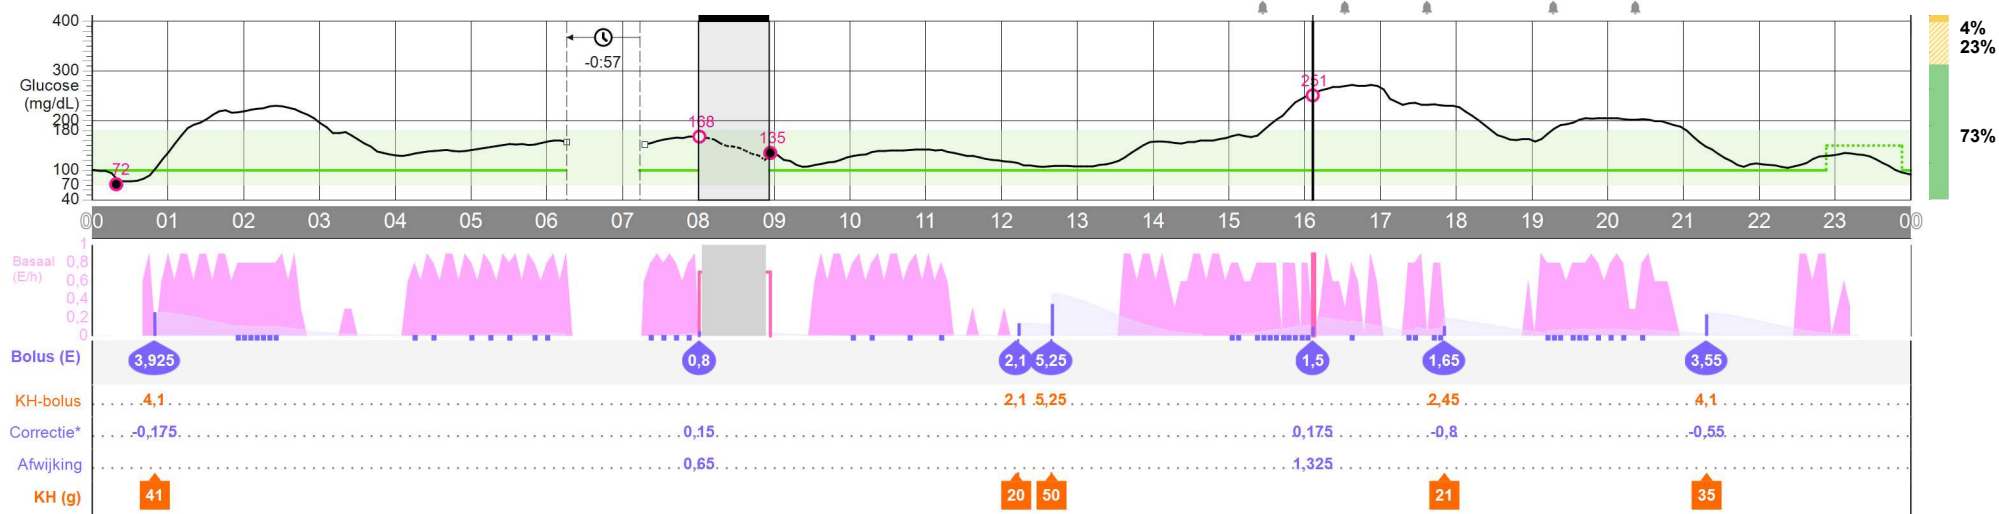

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



## Maandag 27/10


TDD 29,4E

Totaal basaal 37% | 11,0E

Totaal bolus 63% | 18,4E

{ Bolus 95% | 17,5E + Autocorrectie 5% | 0,9E }

Tijd binnen bereik

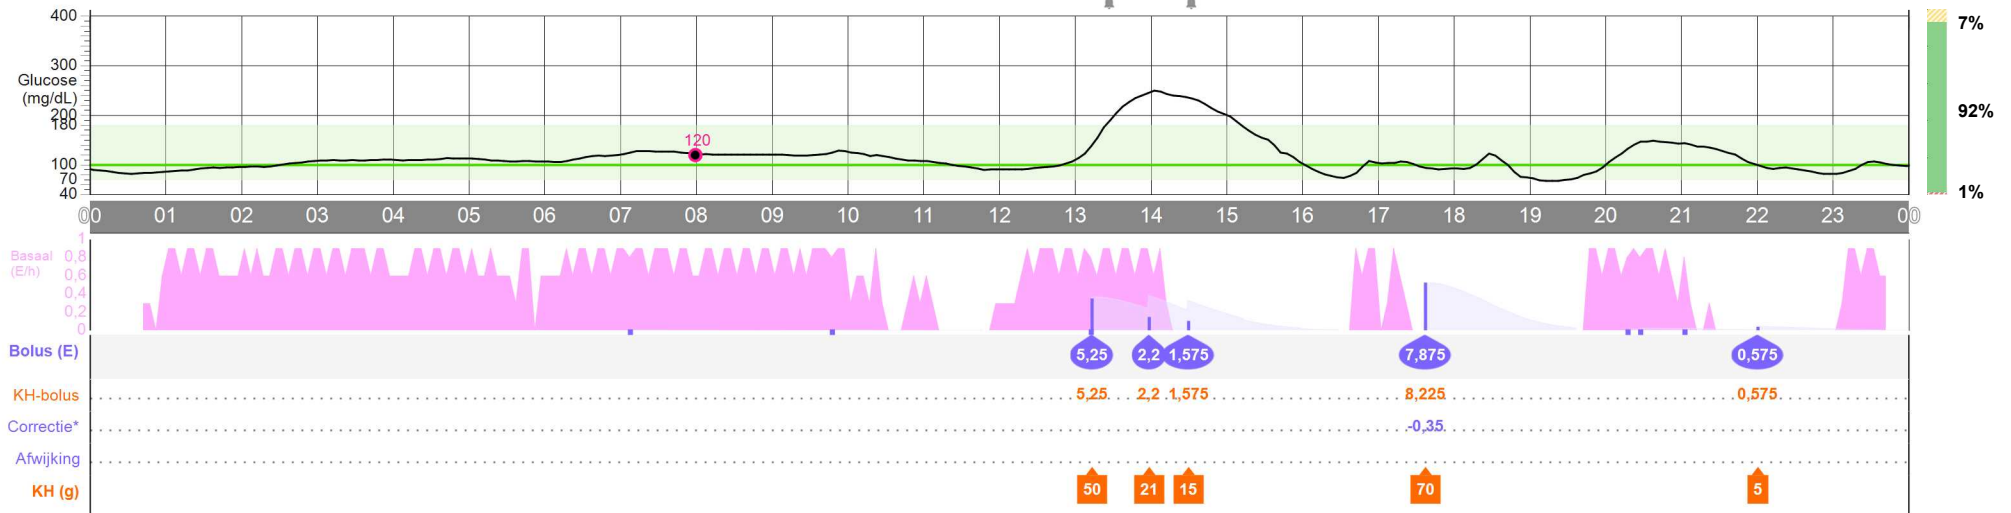

## Dinsdag 28/10


TDD 29,1E  
Infusiesetvervanging

Totaal basaal 38% | 11,2E

Totaal bolus 62% | 17,9E

{ Bolus 85% | 15,3E + Autocorrectie 15% | 2,6E }

Tijd binnen bereik

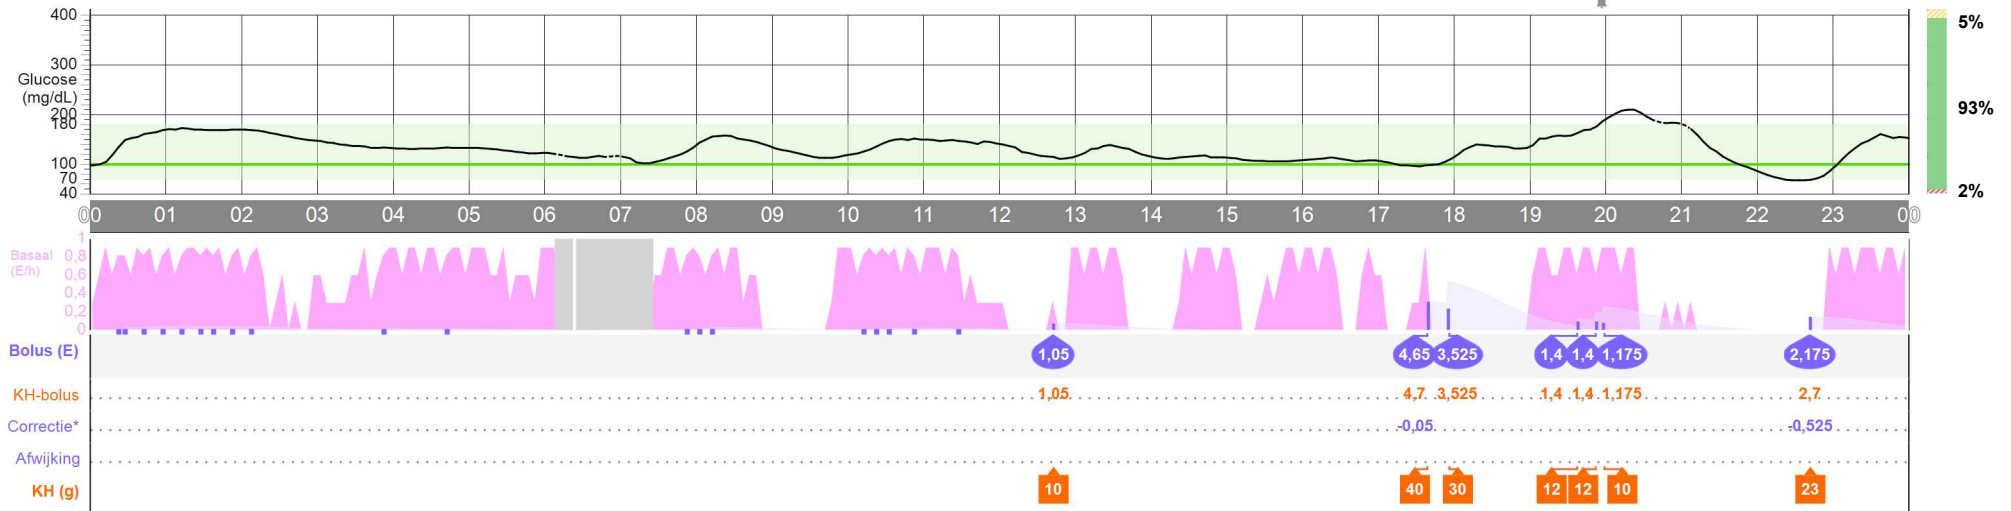

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



## Woensdag 29/10


TDD 32,8E

Totaal basaal 25% | 8,3E

Totaal bolus 75% | 24,5E

{ Bolus 85% | 20,9E + Autocorrectie 15% | 3,6E }

Tijd binnen bereik

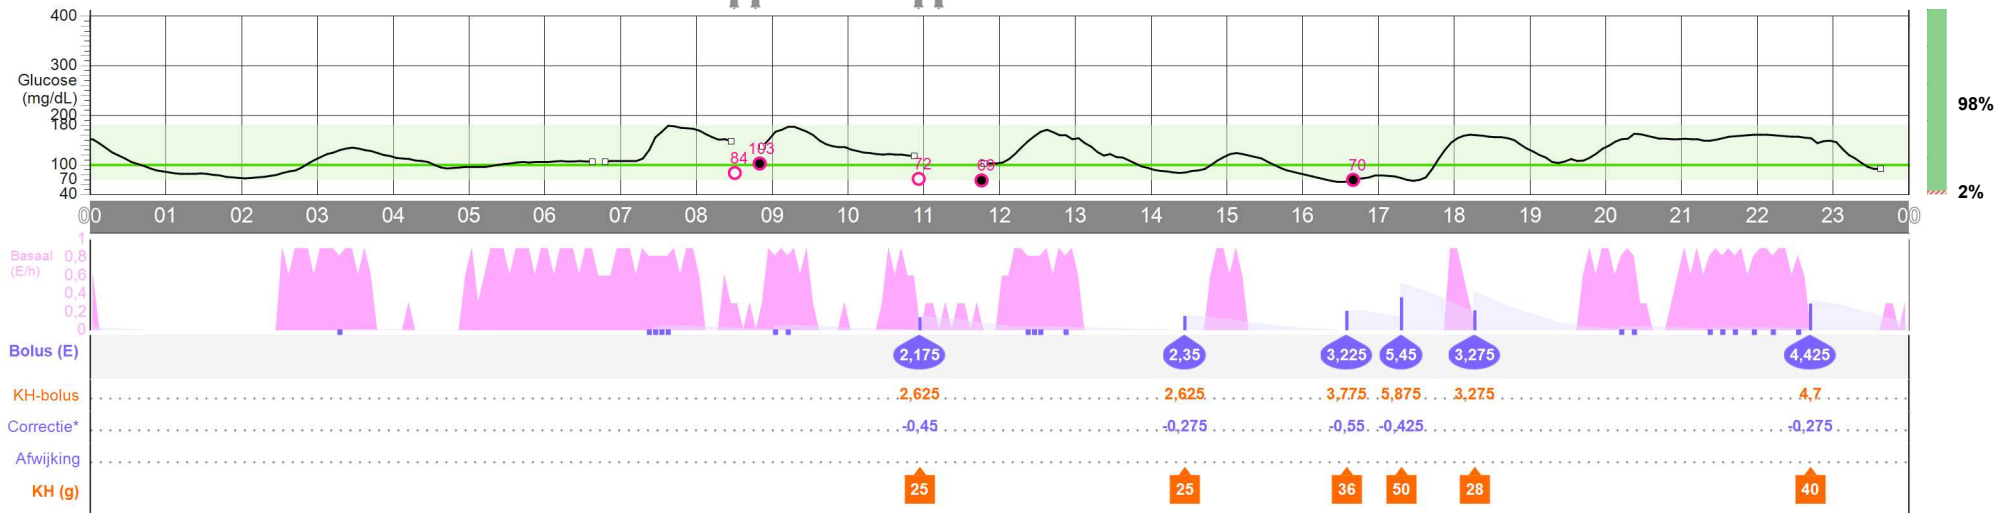

## Donderdag 30/10


TDD 29,3E

Totaal basaal 37% | 10,9E

Totaal bolus 63% | 18,4E

{ Bolus 80% | 14,7E + Autocorrectie 20% | 3,7E }

Tijd binnen bereik

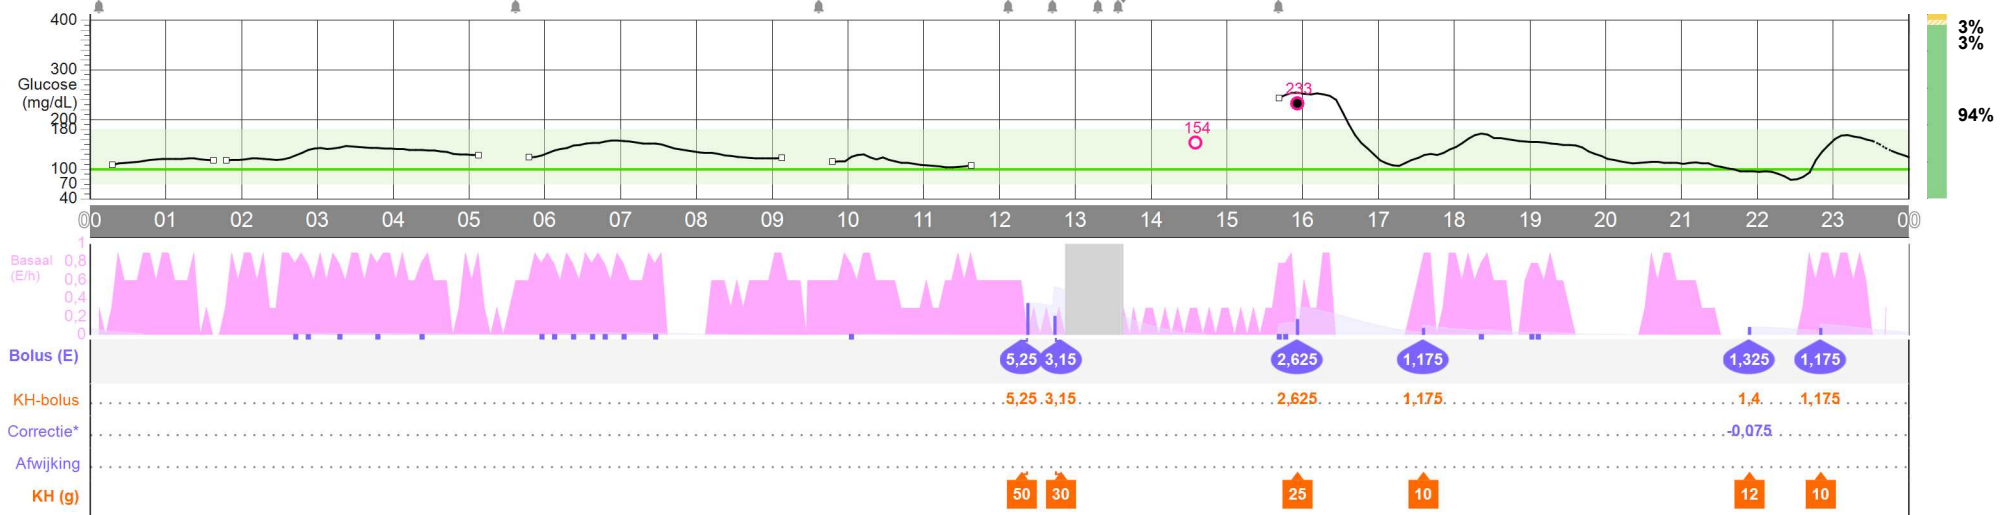

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



## Vrijdag 31/10

TDD 37,4E

Totaal basaal 22% | 8,1E

Totaal bolus 78% | 29,3E

{ Bolus 95% | 27,8E + Autocorrectie 5% | 1,5E }

Tijd binnen bereik



## Zaterdag 01/11

TDD 45,7E

Totaal basaal 19% | 8,5E

Totaal bolus 81% | 37,2E

{ Bolus 84% | 31,2E + Autocorrectie 16% | 6,0E }

Tijd binnen bereik



\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.





## Zondag 02/11

TDD 29,6E

Totaal basaal 29% | 8,6E

Totaal bolus 71% | 21,0E

{ Bolus 90% | 18,9E + Autocorrectie 10% | 2,1E }

Tijd binnen bereik



## Maandag 03/11


TDD 23,6E

Totaal basaal 41% | 9,6E

Totaal bolus 59% | 14,0E

{ Bolus 86% | 12,1E + Autocorrectie 14% | 1,9E }

Tijd binnen bereik

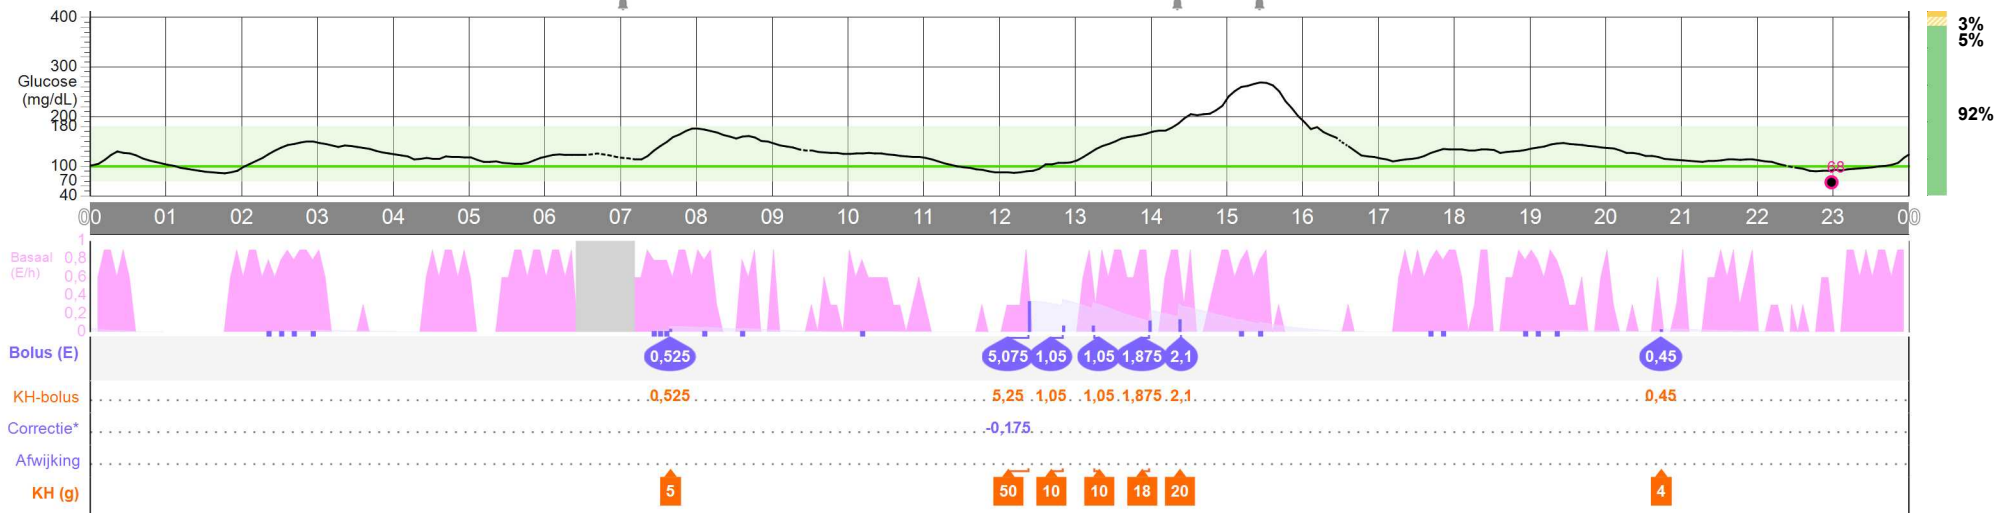

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



## Dinsdag 04/11


TDD 37,4E

Totaal basaal 26% | 9,8E

Totaal bolus 74% | 27,6E

{ Bolus 89% | 24,6E + Autocorrectie 11% | 3,0E }

Tijd binnen bereik

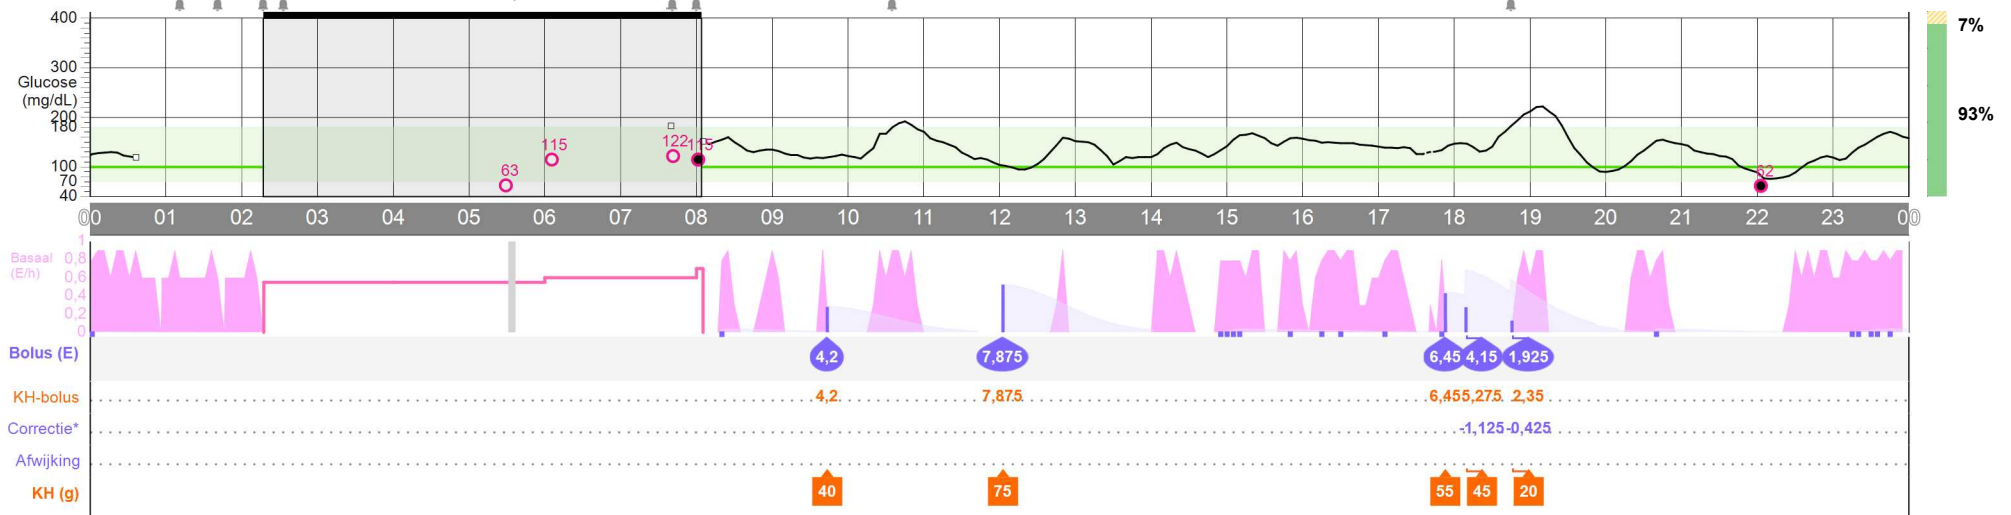

## Woensdag 05/11


TDD --

Totaal basaal -- | --

Totaal bolus -- | 1,0E

{ Bolus -- | -- + Autocorrectie -- | 1,0E }

Tijd binnen bereik

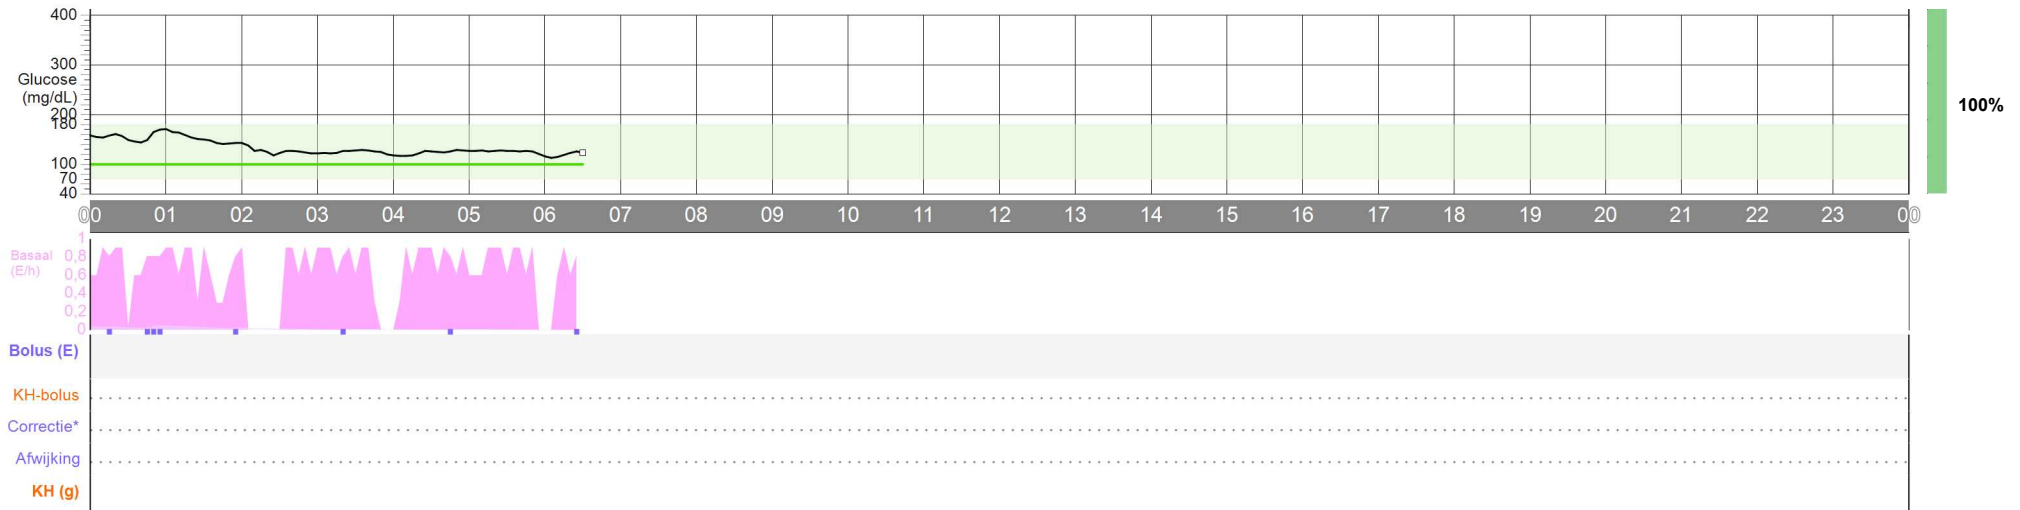

\*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.