


Percentiele vergelijking

25-75% 5-95%

Gemiddeld (A)

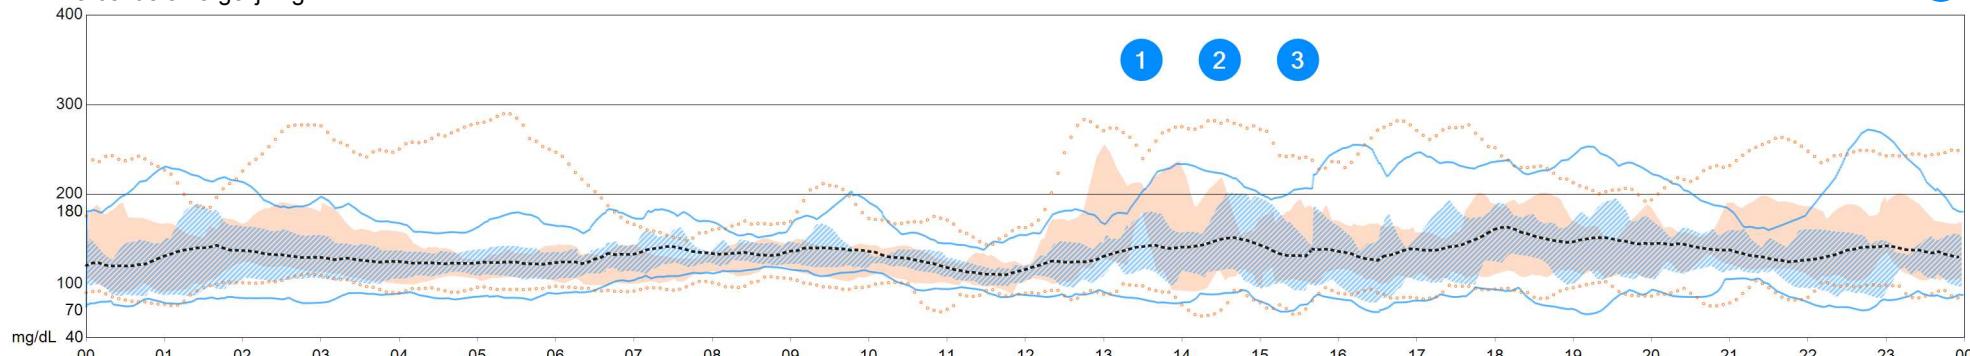

| | | | | |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|
| KH-ratio (g/U) ¹ | (A) 10,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| (B) | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Hypoglykemiepatronen (0) | Aantal episodes (per dag): 0,1 | Hyperglykemiepatronen (8) ² | Aantal episodes (per dag): 1,9 |
| Geen | | 1 13:00 - 13:59 (3 voorvallen) 2 14:00 - 14:59 (3 voorvallen) 3 15:00 - 15:59 (3 voorvallen) | |

| Tijd binnen bereik | SmartGuard verlaten | Statistieken |
|----------------------------|--|--|
| 2% 11% | (A) Geen kalibratie 0 0 | (A) SmartGuard (per week) 97% (6d 18h) |
| 15% | (B) SmartGuard Max toediening 0 0 | (B) Manuele modus (per week) 1% (01h) |
| 6% | (A) SmartGuard Min toediening 0 0 | (A) Gebruiksduur sensor (per week) 95% (6d 15h) |
| 86% | (B) BG vereist voor SmartGuard 0 0 | (B) Gemiddelde SG ± STD 134 ± 41 mg/dL |
| 78% | (A) Te lage waarde sensoralgortime 0 0 | (A) GMI ³ 6,5% |
| 1% | (B) Update sensor bezig 0 0 | (B) Variatiecoëfficiënt (%) 30,9% |
| 1% | (A) Geen SG-waarden 0 0 | (A) Lage/hoge SG-alarmen (per dag) 0,1 / 2,9 |
| 40 54 70 180 250 400 mg/dL | (B) Sensor uitgewerkt 0 1 • | (B) BG-gemiddelde 149 ± 70 mg/dL |
| | (A) SmartGuard uitgezet door gebruiker + · · · · 6 9 · · · · + | (B) BG / Kalibratie (per dag) 1,5 / 1,0 |
| | (B) Langdurige stop 0 0 | (A) Totale dagdosis (per dag) 32,7 eenheden |
| | (A) SmartGuard opwarmen 0 0 | (B) Bolusdosis (per dag) 22,4E (69%) |
| | (B) Ongedefinieerd 0 0 | (A) Autocorrectiehoeveelheid (per dag) 4,5E (20%) |
| | | (B) Autobasaal / Basale dosis (per dag) 10,3E (31%) |
| | | (A) Infusieset/reservoir vervangen 3,0 / 3,0 dgn |
| | | (B) KH-invoer/maaltijden (per dag) 159 ± 58 g / 6,0 |
| | | (A) Actieve-insulinetijd 2:00 uur |
| | | (B) Geprogrammeerd 24-uurs basaal handmatig ⁴ 18,100E |
| | | (A) SmartGuard-streefwaarde 100 mg/dL |
| | | (B) SmartGuard-streefwaarde 100 mg/dL |

¹ Meest recente pominstellingen worden weergegeven² Alleen hoogte prioriteit wordt weergegeven.³ Indicator voor glucoseregulering⁴ Geprogrammeerd 24-uurs totaal in Manuele modus voor actief basaal patroon